

Nom MA	Adresse
Prénom XINFANG	Exposition
Né le 23/03/1986	Profession CHEF COOK
Age 39 Ans	Entreprise CR18
Genre Masculin	Service
ID 6931	Fumeur Non fumeur
Taille 158 cm	Groupe ethnique Chinois de Hong Kong
Poids 57 kg	Prescripteur:
Valeurs prédites Ecgs/Zapletal	Smoking Pack Years : 0
Opérateur BAH OUMOU SALAMATA	



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 23,9 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 81 %

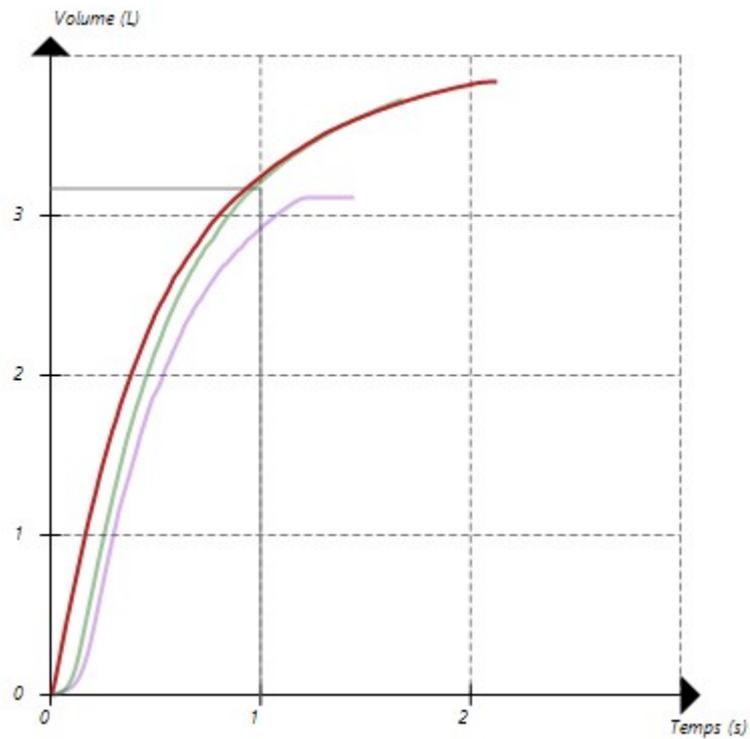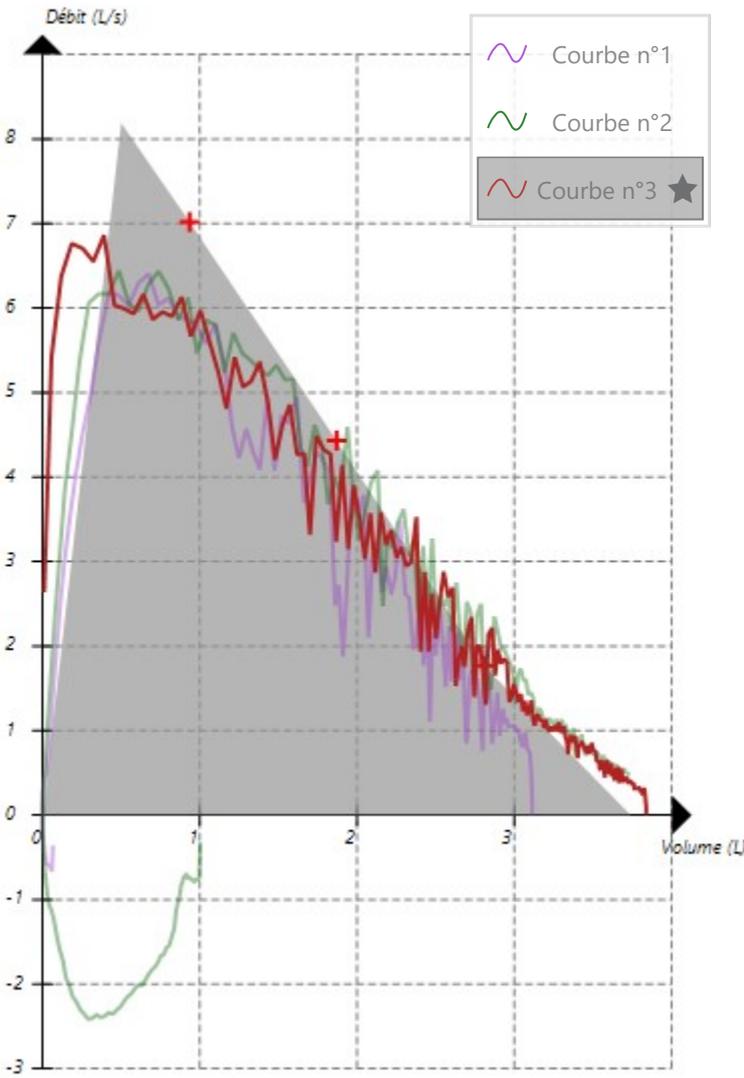

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,11 L	3,73 L	3,84 L	3,74 L	102,67 %
VEMS	3,06 L	3,31 L	3,25 L	3,17 L	102,52 %
DEP	6,55 L/s	6,70 L/s	7,20 L/s	8,19 L/s	87,91 %
VEMS/CVF	98,39 %	88,74 %	84,64 %	80,23 %	105,50 %
Durée d'expiration	1,23 s	1,69 s	2,09 s	-	
DEMM	4,05 L/s	3,78 L/s	3,38 L/s	4,09 L/s	82,64 %
DEMM/CVF	1,30 s-1	1,01 s-1	0,88 s-1	1,09 s-1	80,73 %
DE75	6,28 L/s	6,27 L/s	6,02 L/s	7,02 L/s	85,75 %
DE50	4,75 L/s	3,94 L/s	4,29 L/s	4,43 L/s	96,84 %
DE25	2,85 L/s	2,49 L/s	1,63 L/s	1,77 L/s	92,09 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: