

<b>Nom</b> SONG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> HONGBO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/02/1987	<b>Profession</b> EXCAVATOR DRIVER
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 7271	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 82 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,9 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 57 %

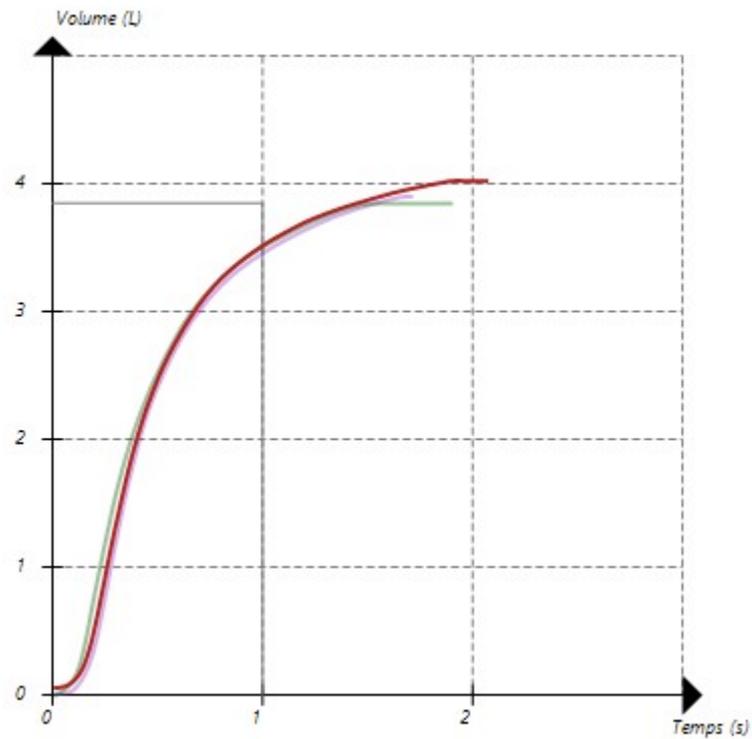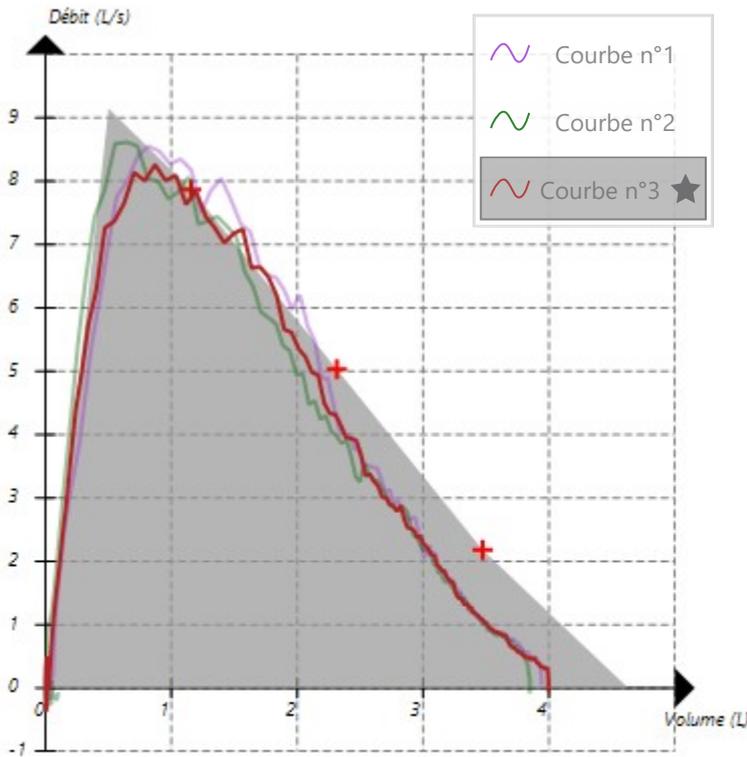

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,90 L	3,85 L	4,00 L	4,63 L	86,39 %
VEMS	3,60 L	3,59 L	3,62 L	3,85 L	94,03 %
DEP	8,63 L/s	8,98 L/s	8,59 L/s	9,15 L/s	93,88 %
VEMS/CVF	92,31 %	93,25 %	90,50 %	80,41 %	112,55 %
Durée d'expiration	1,72 s	1,55 s	2,02 s	-	
DEMM	5,02 L/s	4,86 L/s	4,74 L/s	4,43 L/s	107,00 %
DEMM/CVF	1,29 s-1	1,26 s-1	1,18 s-1	0,96 s-1	122,92 %
DE75	8,35 L/s	7,79 L/s	8,10 L/s	7,87 L/s	102,92 %
DE50	6,17 L/s	5,31 L/s	5,41 L/s	5,03 L/s	107,55 %
DE25	2,30 L/s	2,69 L/s	2,21 L/s	2,18 L/s	101,38 %