



<b>Nom CISSE</b> <b>Prénom MOUSSA</b> <b>Né le</b> 01/01/1990 <b>Age</b> 35 Ans <b>Genre</b> Masculin <b>ID</b> 4387 <b>Taille</b> 178 cm <b>Poids</b> 70 kg <b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal <b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	<b>Adresse</b> <b>Exposition</b> <b>Profession</b> MANOEUVRE <b>Entreprise</b> CR18 <b>Service</b> <b>Fumeur</b> Non fumeur <b>Groupe ethnique</b> Origine africaine <b>Prescripteur:</b> <b>Smoking Pack Years</b> : 0
---	---



**Fim medical**  
51 rue Primat  
+33 (0)4 72 34 89 89  
+33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024  
 Température ambiante : 30 °C  
 Pression atmosphérique : 95,5 kPa  
 Humidité : 45 %

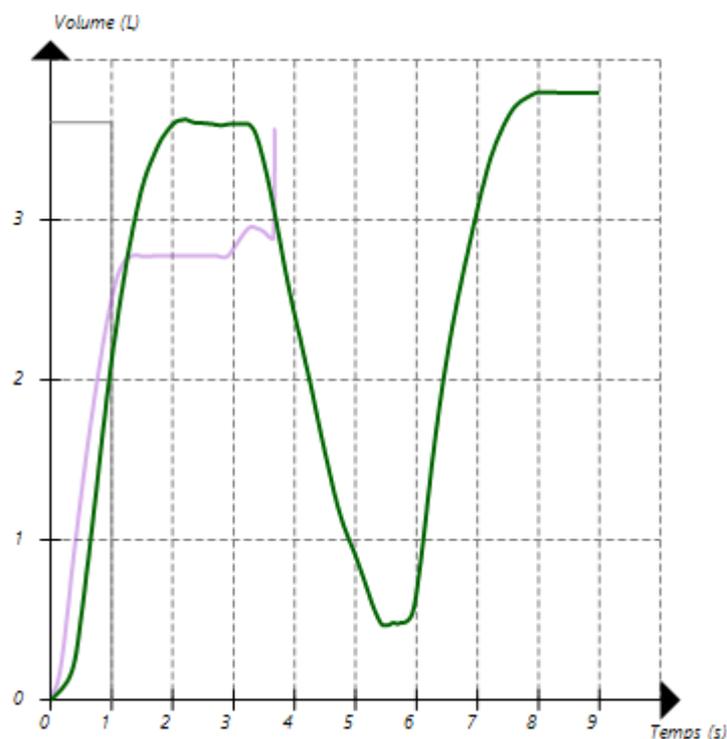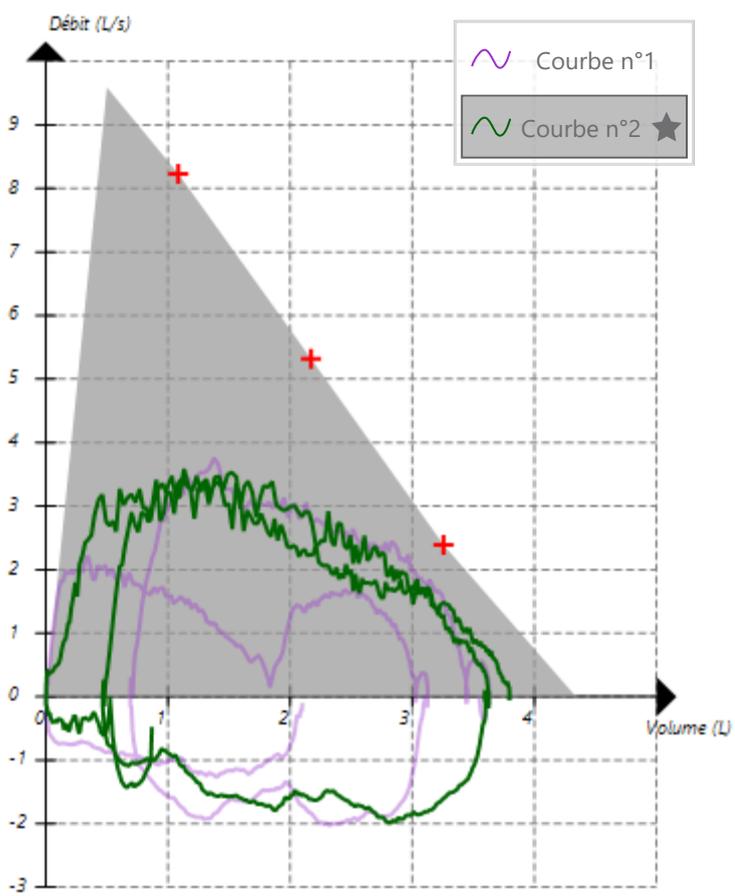

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,76 L	3,63 L	4,34 L	83,64 %
VEMS	2,67 L	2,94 L	3,61 L	81,44 %
DÉP	3,85 L/s	3,89 L/s	9,59 L/s	40,56 %
VEMS/CVF	96,74 %	80,99 %	80,94 %	100,06 %
Durée d'expiration	1,63 s	2,27 s	-	
DEMM	2,87 L/s	2,96 L/s	4,65 L/s	63,66 %
DEMM/CVF	1,04 s <sup>-1</sup>	0,82 s <sup>-1</sup>	0,93 s <sup>-1</sup>	88,17 %
DE75	3,85 L/s	3,11 L/s	8,23 L/s	37,79 %
DE50	2,77 L/s	3,24 L/s	5,32 L/s	60,90 %
DE25	2,28 L/s	2,23 L/s	2,39 L/s	93,31 %