



<b>Nom</b> DOUMBOUYA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> TALIBY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/03/2000	<b>Profession</b> BUS DRIVER
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 7289	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 187 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 93 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,3 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 59 %

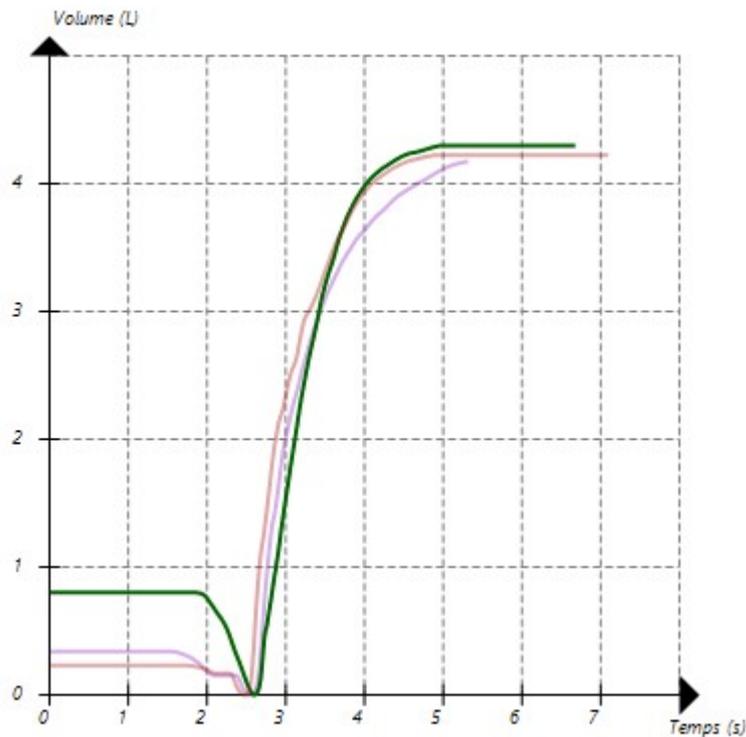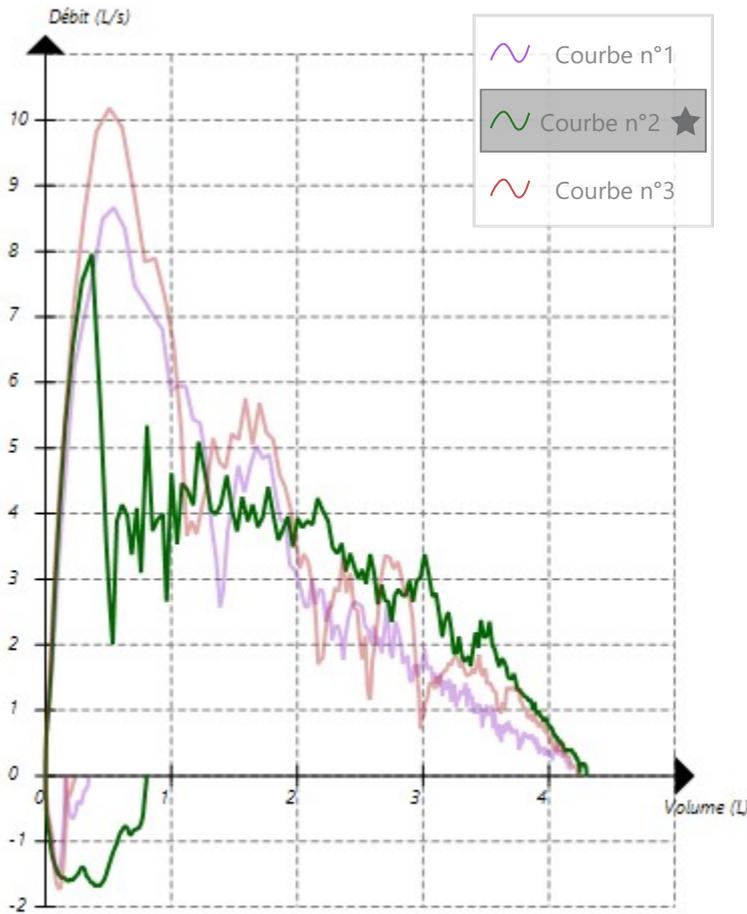

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	4,18 L	4,30 L	4,23 L	5,21 L	82,53 %
VEMS	3,28 L	3,54 L	3,39 L	4,38 L	80,82 %
DEP	8,81 L/s	8,46 L/s	10,60 L/s	10,76 L/s	78,62 %
VEMS/CVF	78,47 %	82,33 %	80,14 %	84,67 %	97,24 %
Durée d'expiration	2,77 s	2,38 s	2,44 s	-	
DEMM	2,80 L/s	3,51 L/s	2,84 L/s	4,75 L/s	73,89 %
DEMM/CVF	0,67 s-1	0,82 s-1	0,67 s-1	0,91 s-1	90,11 %
DE75	6,31 L/s	5,11 L/s	5,63 L/s	-	
DE50	2,58 L/s	4,11 L/s	3,01 L/s	-	
DE25	1,74 L/s	2,20 L/s	1,58 L/s	-	