

<b>Nom BAH</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom MAMADOU</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/2003</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 21 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 1011</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 174 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 66 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 23,8 °C  
 Pression atmosphérique : 94,5 kPa  
 Humidité : 69 %

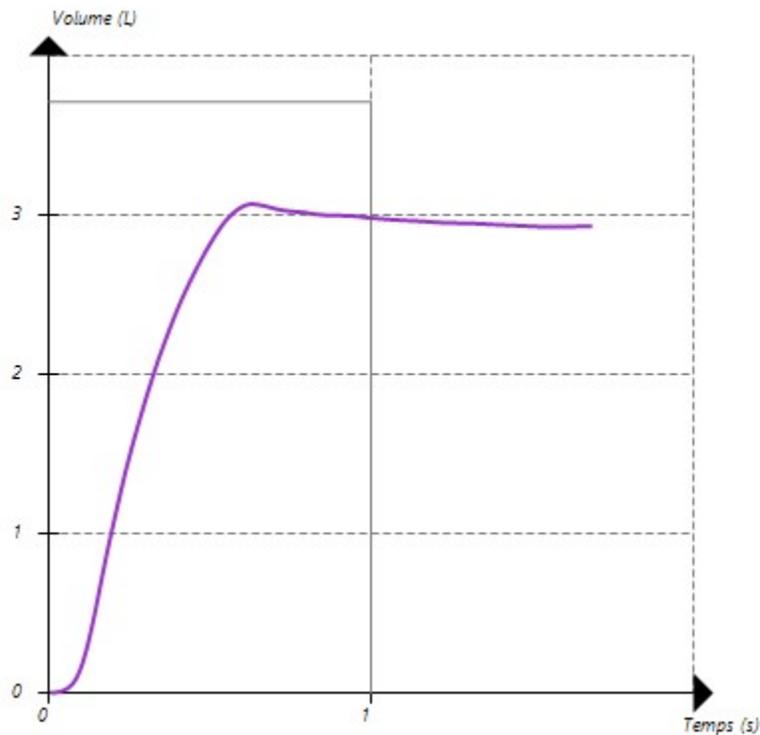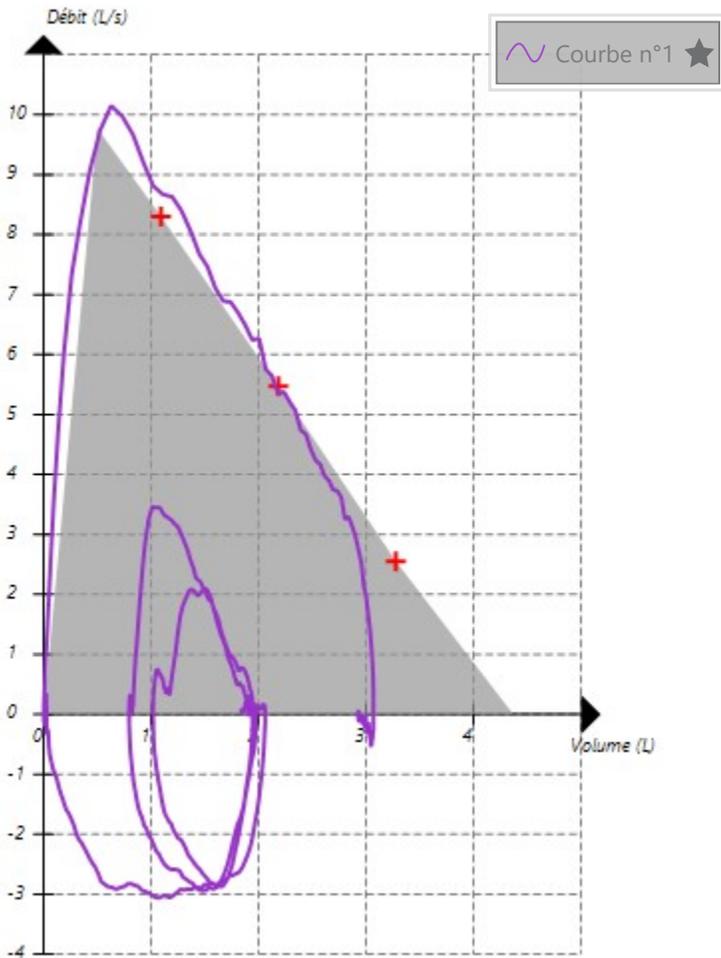

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,07 L	4,37 L	70,25 %
VEMS	3,07 L	3,71 L	82,75 %
DEP	10,26 L/s	9,77 L/s	105,02 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,64 s	-	
DEMM	7,34 L/s	5,01 L/s	146,51 %
DEMM/ CVF	2,39 s-1	1,00 s-1	239,00 %
DE75	9,97 L/s	8,30 L/s	120,12 %
DE50	7,47 L/s	5,47 L/s	136,56 %
DE25	5,14 L/s	2,55 L/s	201,57 %