

| | |
|--|--|
| Nom CAMARA | Adresse |
| Prénom BANGALY | Exposition |
| Né le 06/03/1983 | Profession MANOEUVRE |
| Age 41 Ans | Entreprise CR18 |
| Genre Masculin | Service |
| ID 347 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 176 cm | Groupe ethnique Origine africaine |
| Poids 63 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites NHANES III | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO | |





MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:

Version du logiciel embarqué : V01.02.00
 Numéro de série : 232697
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 29,7 °C
 Pression atmosphérique : 696,8 mmHg
 Humidité : 48 %

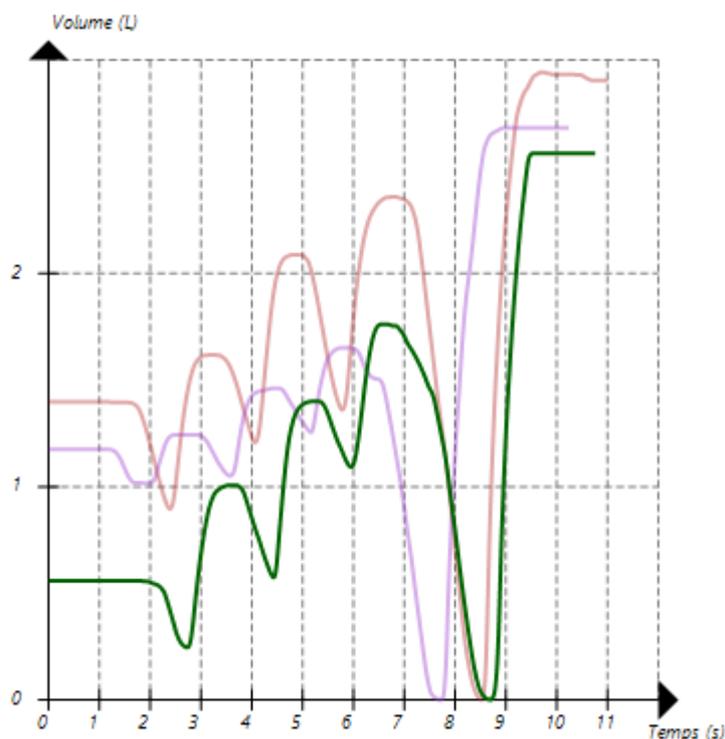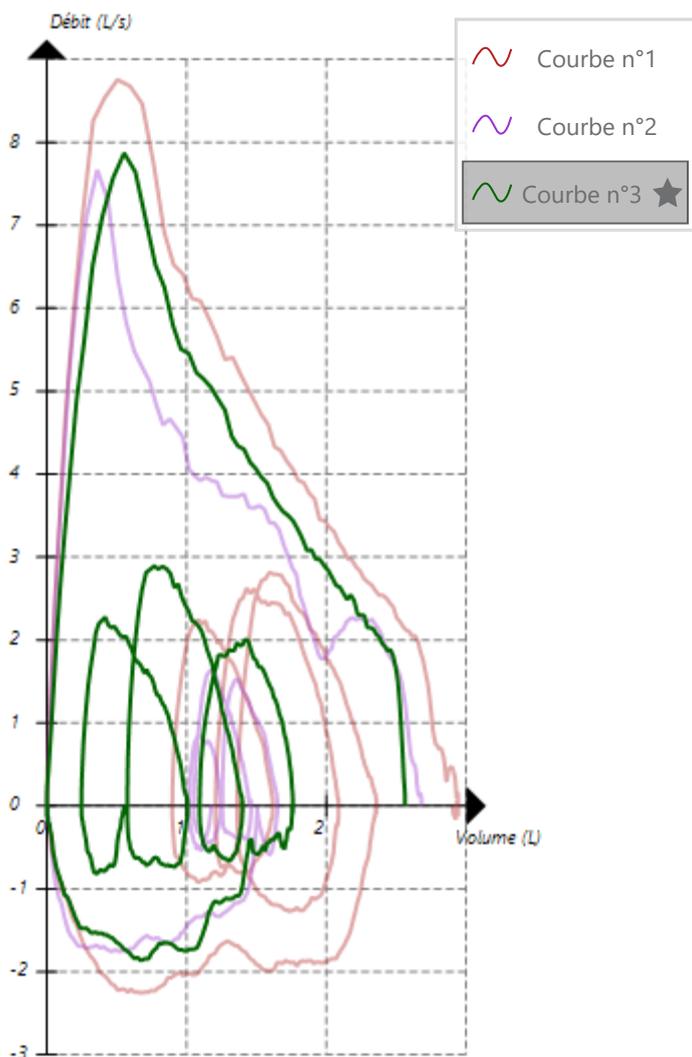

| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 | Courbe n°3 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| CVF | 2,94 L | 2,68 L | 2,56 L | 4,26 L | 60,09 % |
| VEMS | 2,93 L | 2,66 L | 2,56 L | 3,48 L | 73,56 % |
| DÉP | 9,00 L/s | 7,75 L/s | 7,93 L/s | 9,02 L/s | 87,92 % |
| VEMS/ CVF | 99,66 % | 99,25 % | 100,00 % | 81,74 % | 122,34 % |
| Durée d'expiration | 1,17 s | 1,24 s | 0,83 s | - | |
| DEMM | 4,70 L/s | 3,45 L/s | 4,59 L/s | 3,65 L/s | 125,75 % |
| DEMM/ CVF | 1,60 s ⁻¹ | 1,29 s ⁻¹ | 1,79 s ⁻¹ | 0,86 s ⁻¹ | 208,14 % |
| DE75 | 7,64 L/s | 5,39 L/s | 7,46 L/s | - | |
| DE50 | 4,93 L/s | 3,69 L/s | 4,81 L/s | - | |
| DE25 | 2,89 L/s | 1,86 L/s | 2,97 L/s | - | |