



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ISMAEL	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2006	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 18 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1073	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31,8 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 59 %

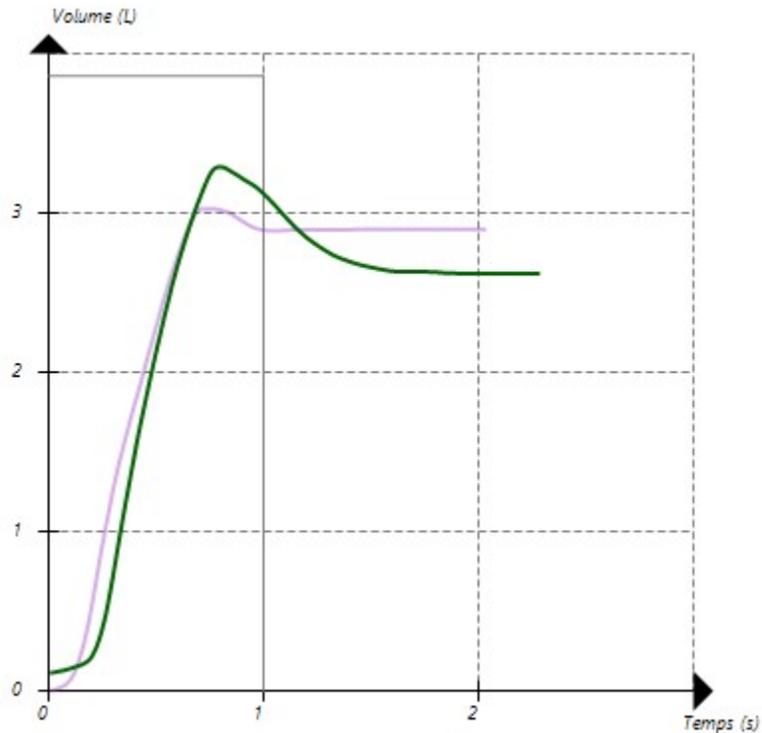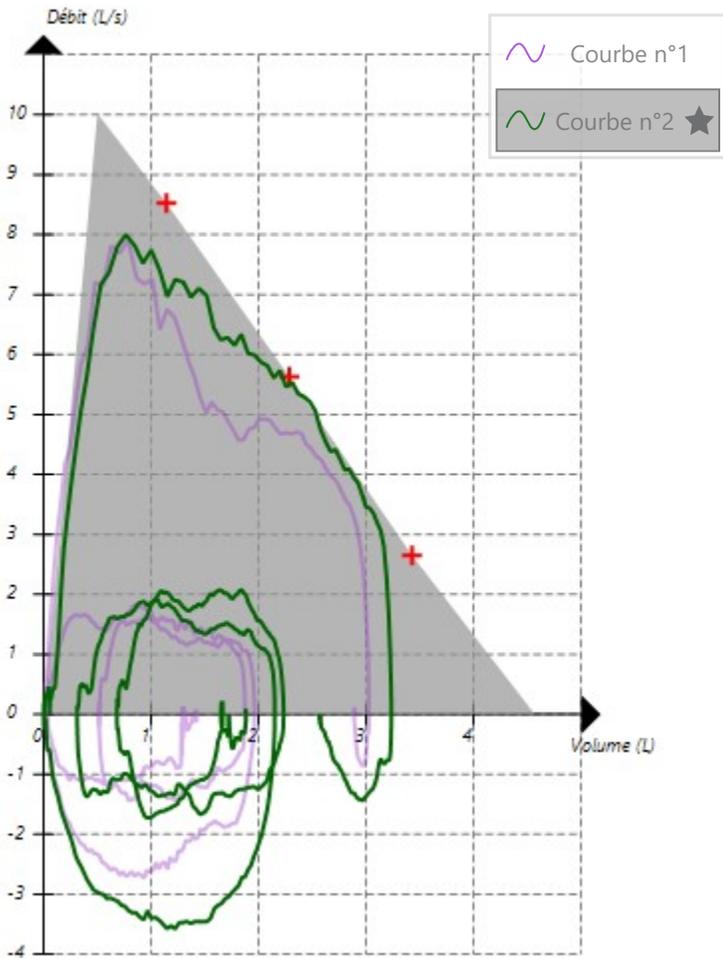

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,03 L	3,23 L	4,57 L	70,68 %
VEMS	3,03 L	3,23 L	3,86 L	83,68 %
DEP	8,21 L/s	8,06 L/s	10,02 L/s	80,44 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,75 s	1,15 s	-	
DEMM	5,65 L/s	6,57 L/s	5,08 L/s	129,33 %
DEMM/CVF	1,86 s-1	2,03 s-1	0,97 s-1	209,28 %
DE75	7,71 L/s	7,96 L/s	8,52 L/s	93,43 %
DE50	5,51 L/s	6,38 L/s	5,63 L/s	113,32 %
DE25	4,59 L/s	5,26 L/s	2,65 L/s	198,49 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: