



<b>Nom</b> DOUMBOUYA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABOUBACAR	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 06/04/1985	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1487	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,7 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 55 %

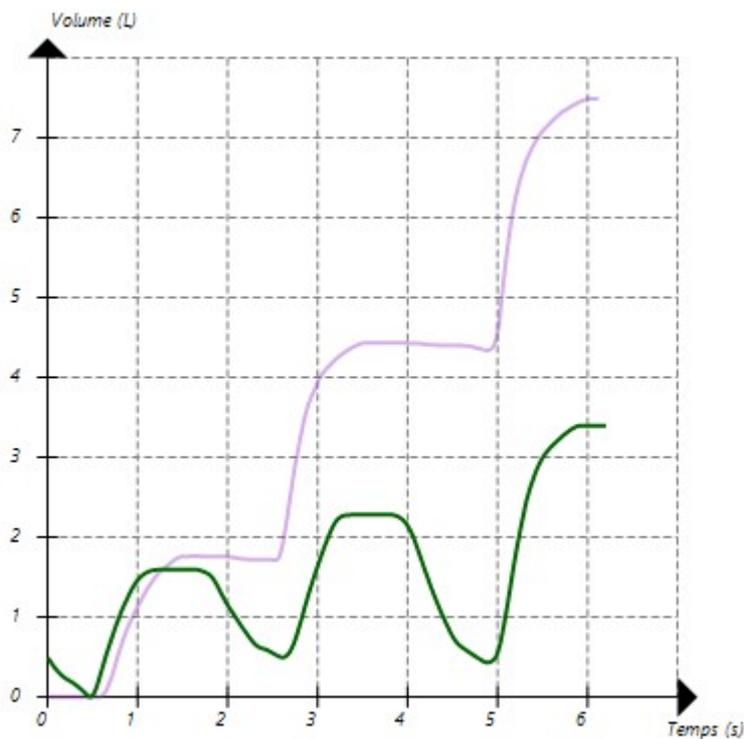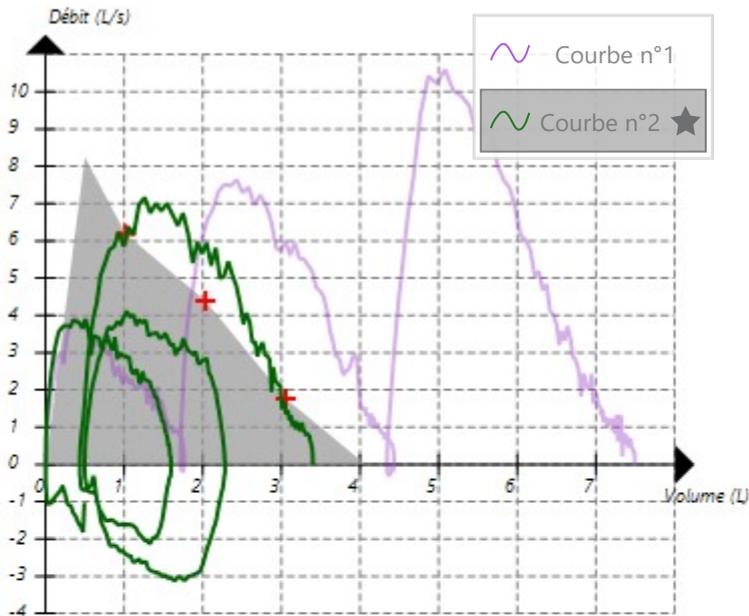

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,15 L	2,96 L	4,07 L	72,73 %
VEMS	3,13 L	2,96 L	3,39 L	87,32 %
DEP	10,80 L/s	7,52 L/s	8,25 L/s	91,15 %
VEMS/CVF	99,37 %	100,00 %	82,60 %	121,07 %
Durée d'expiration	1,14 s	1,08 s	-	
DEMM	6,20 L/s	5,70 L/s	3,68 L/s	154,89 %
DEMM/CVF	1,97 s-1	1,93 s-1	0,90 s-1	214,44 %
DE75	10,54 L/s	7,08 L/s	6,19 L/s	114,38 %
DE50	7,69 L/s	6,41 L/s	4,39 L/s	146,01 %
DE25	2,91 L/s	3,53 L/s	1,77 L/s	199,44 %