

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1998	<b>Profession</b> BUS DRIVER
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 5707	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 32,3 °C  
 Pression atmosphérique : 95,1 kPa  
 Humidité : 56 %

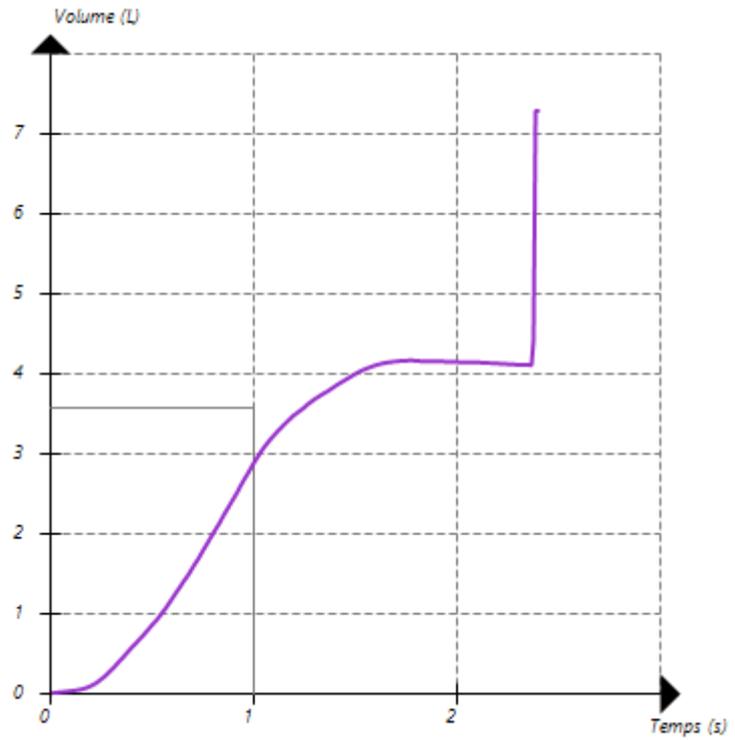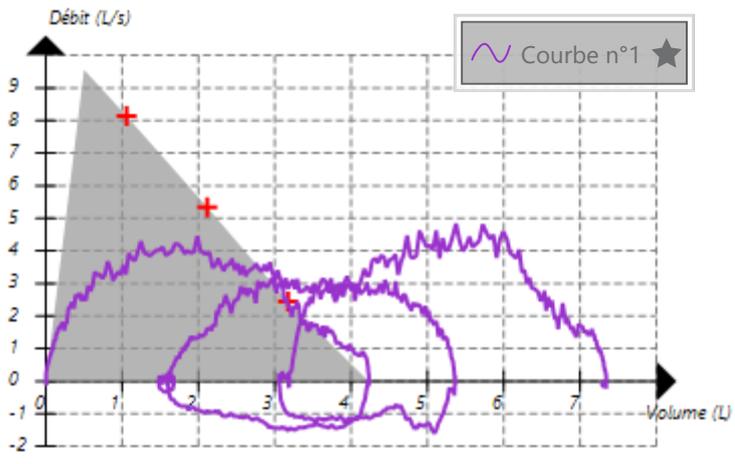

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,16 L	4,23 L	98,35 %
VEMS	3,70 L	3,58 L	103,35 %
DÉP	5,11 L/s	9,56 L/s	53,45 %
VEMS/CVF	88,94 %	82,38 %	107,96 %
Durée d'expiration	1,82 s	-	
DEMM	4,12 L/s	4,88 L/s	84,43 %
DEMM/CVF	0,99 s <sup>-1</sup>	1,00 s <sup>-1</sup>	99,00 %
DE75	2,74 L/s	8,14 L/s	33,66 %
DE50	3,86 L/s	5,34 L/s	72,28 %
DE25	3,02 L/s	2,44 L/s	123,77 %