

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUSMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1989	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 01244	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 28,8 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 63 %

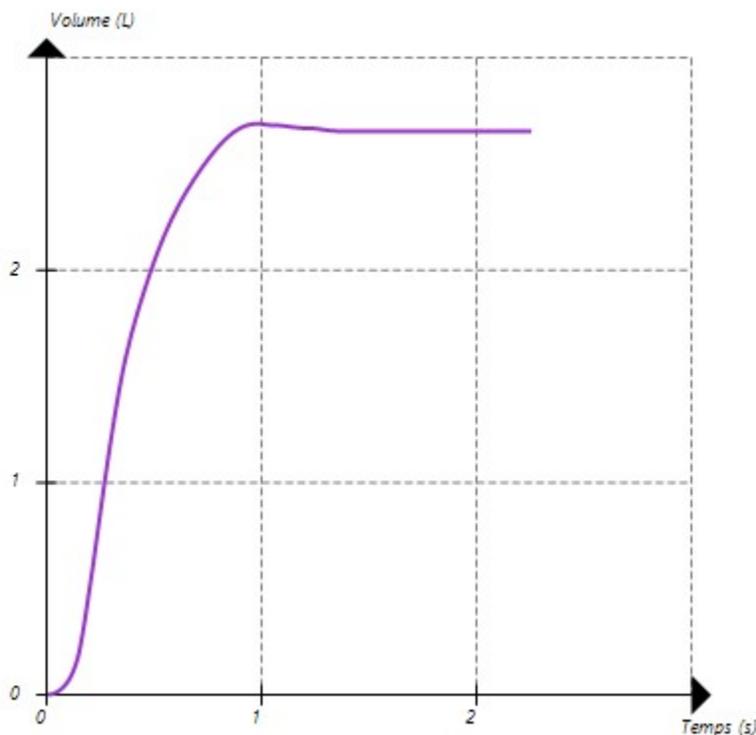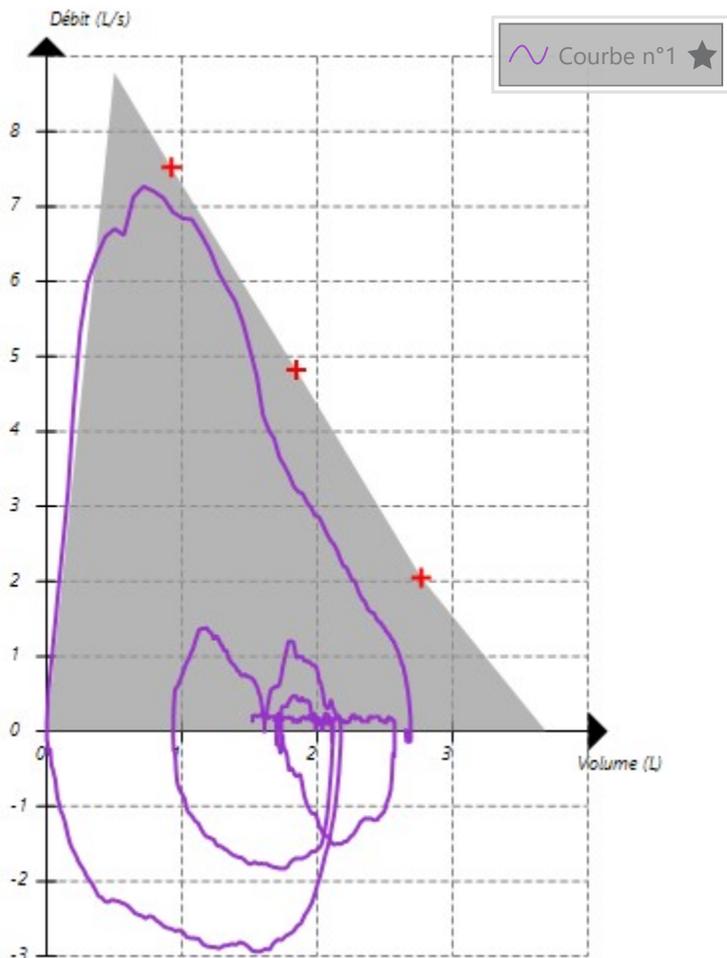

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,69 L	3,69 L	72,90 %
VEMS	2,69 L	3,12 L	86,22 %
DEP	7,34 L/s	8,79 L/s	83,50 %
VEMS/ CVF	100,00 %	80,94 %	123,55 %
Durée d'expiration	0,99 s	-	
DEMM	5,02 L/s	4,40 L/s	114,09 %
DEMM/ CVF	1,87 s-1	1,04 s-1	179,81 %
DE75	7,34 L/s	7,52 L/s	97,61 %
DE50	5,91 L/s	4,82 L/s	122,61 %
DE25	2,87 L/s	2,05 L/s	140,00 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: