



<b>Nom</b> DRAME	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1993	<b>Profession</b> DAILY WORKER
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 265	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 192 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 112 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,1 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 54 %

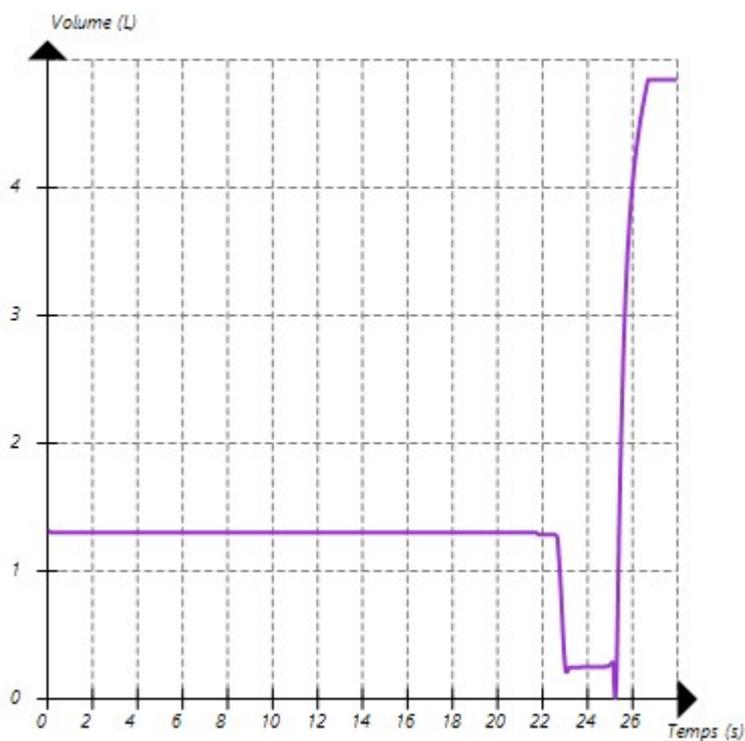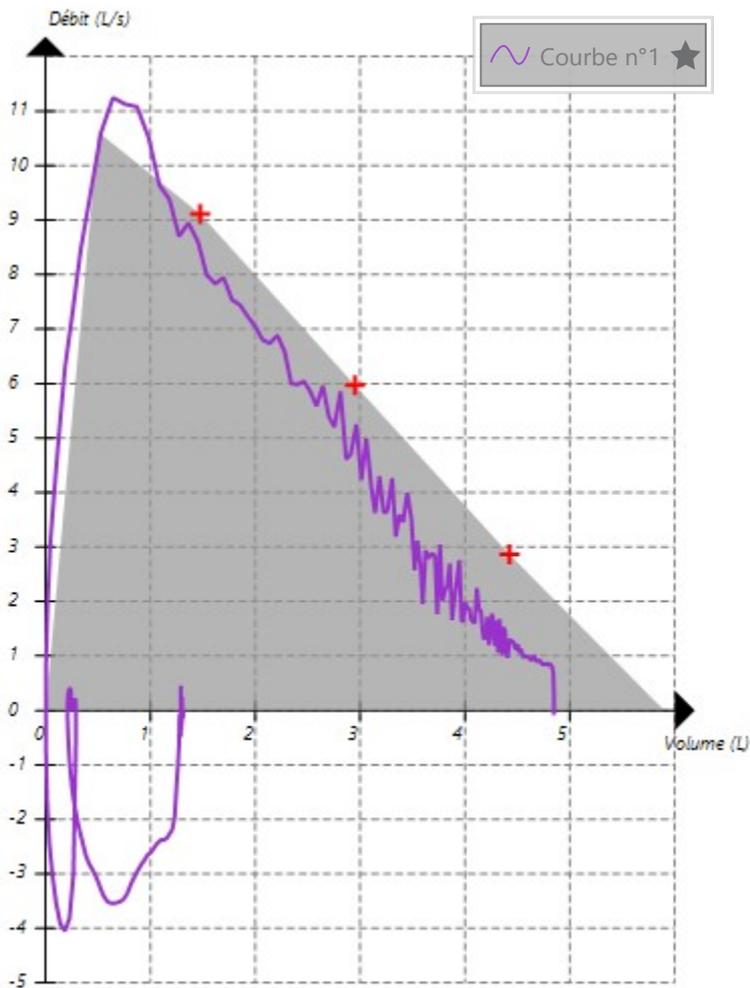

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,85 L	5,90 L	82,20 %
VEMS	4,44 L	4,87 L	91,17 %
DEP	11,46 L/s	10,62 L/s	107,91 %
VEMS/ CVF	91,55 %	81,66 %	112,11 %
Durée d'expiration	1,48 s	-	
DEMM	5,50 L/s	5,10 L/s	107,84 %
DEMM/ CVF	1,13 s-1	0,86 s-1	131,40 %
DE75	9,10 L/s	9,11 L/s	99,89 %
DE50	5,78 L/s	5,97 L/s	96,82 %
DE25	3,40 L/s	2,86 L/s	118,88 %