

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KOMI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1992	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 754	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,2 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 59 %

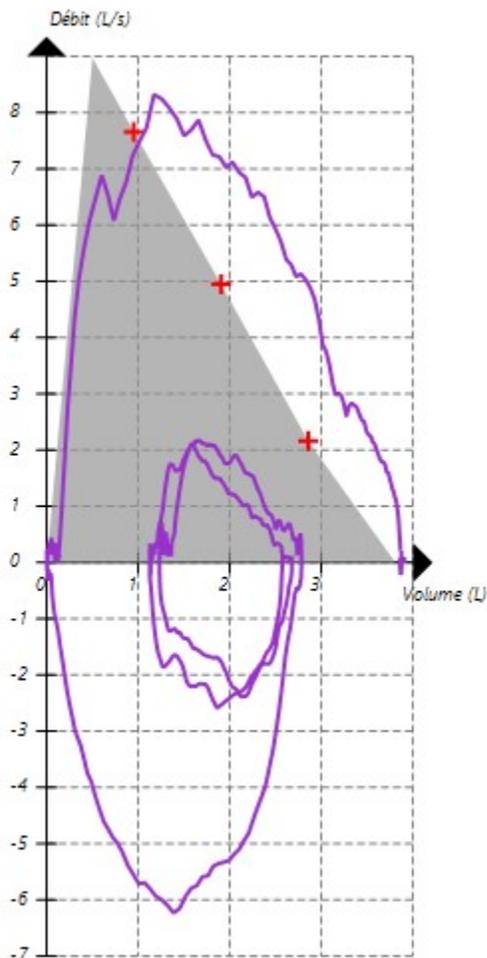

Courbe n°1 ★

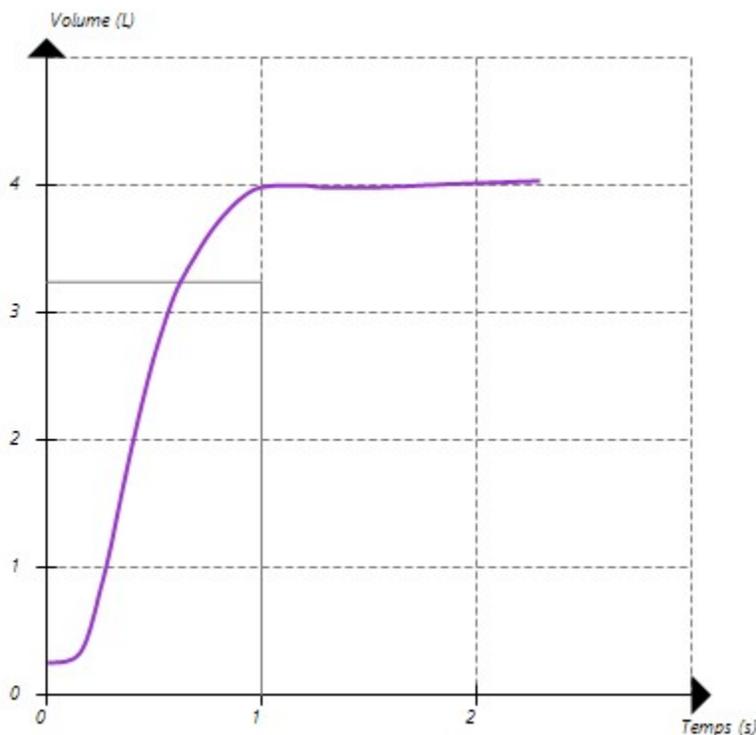

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,87 L	3,81 L	101,57 %
VEMS	3,87 L	3,24 L	119,44 %
DEP	8,55 L/s	8,98 L/s	95,21 %
VEMS/CVF	100,00 %	81,48 %	122,73 %
Durée d'expiration	1,74 s	-	
DEMM	6,87 L/s	4,55 L/s	150,99 %
DEMM/CVF	1,78 s-1	1,04 s-1	171,15 %
DE75	7,33 L/s	7,66 L/s	95,69 %
DE50	7,12 L/s	4,95 L/s	143,84 %
DE25	4,83 L/s	2,16 L/s	223,61 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: