



<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1985	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 323	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Autre
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 696,8 mmHg  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 50 %

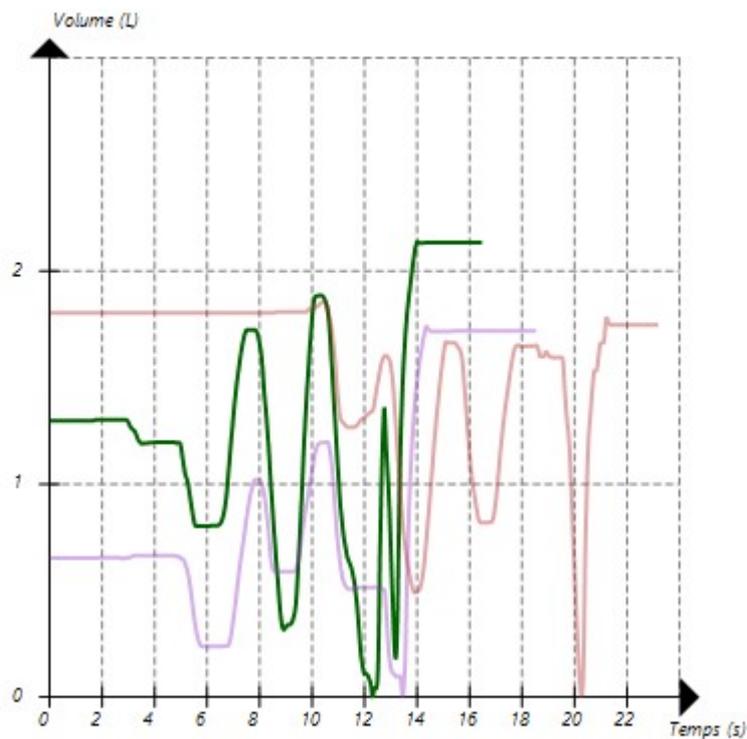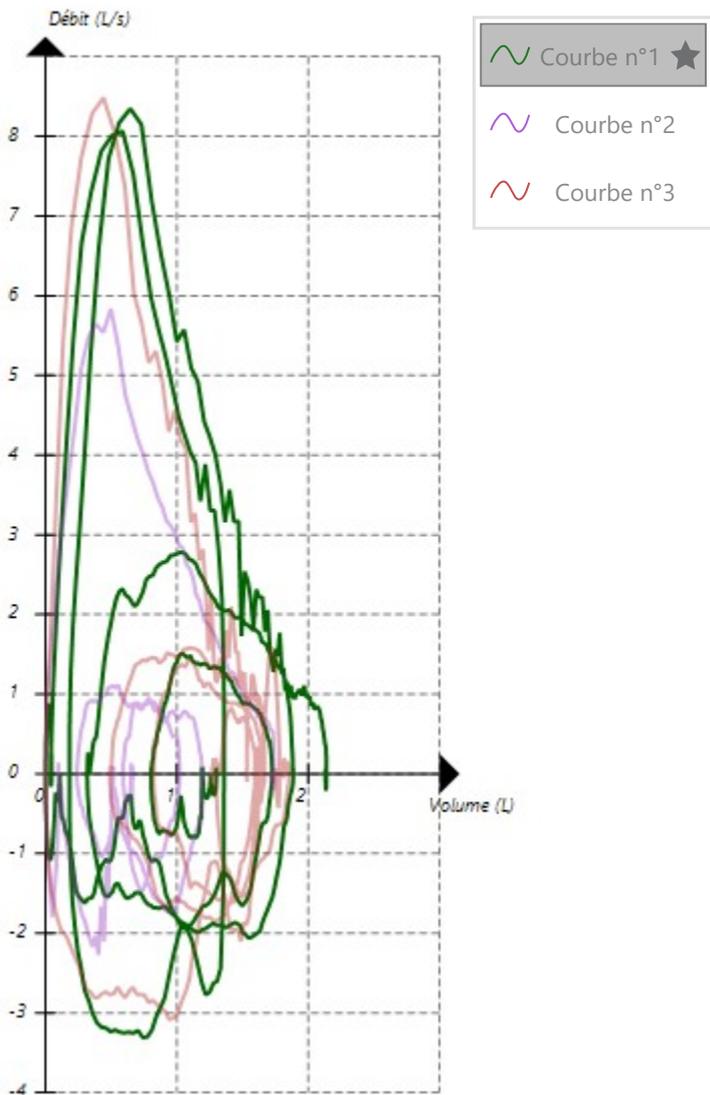

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	1,96 L	1,74 L	1,78 L	5,13 L	38,21 %
VEMS	1,96 L	1,74 L	1,78 L	4,10 L	47,80 %
DEP	8,43 L/s	6,01 L/s	8,58 L/s	9,94 L/s	84,81 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,01 %	124,98 %
Durée d'expiration	0,84 s	0,90 s	0,96 s	-	
DEMM	4,15 L/s	3,21 L/s	3,84 L/s	3,92 L/s	105,87 %
DEMM/ CVF	2,12 s-1	1,84 s-1	2,16 s-1	0,76 s-1	278,95 %
DE75	8,25 L/s	5,54 L/s	8,56 L/s	-	
DE50	5,02 L/s	3,44 L/s	5,03 L/s	-	
DE25	2,33 L/s	1,67 L/s	1,69 L/s	-	