

<b>Nom</b> CHERIF	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1993	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1470	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 85 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> ITS (Crapo)	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> LY MAMOUDOU	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Les prédicts sélectionnés ne permettent pas de réaliser ce type d'interprétation.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,5 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,6 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 50 %

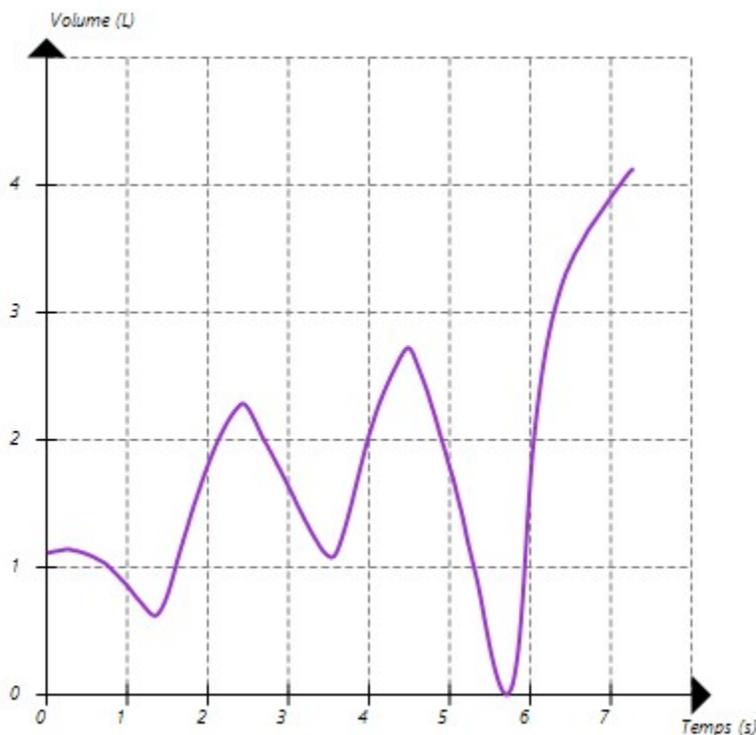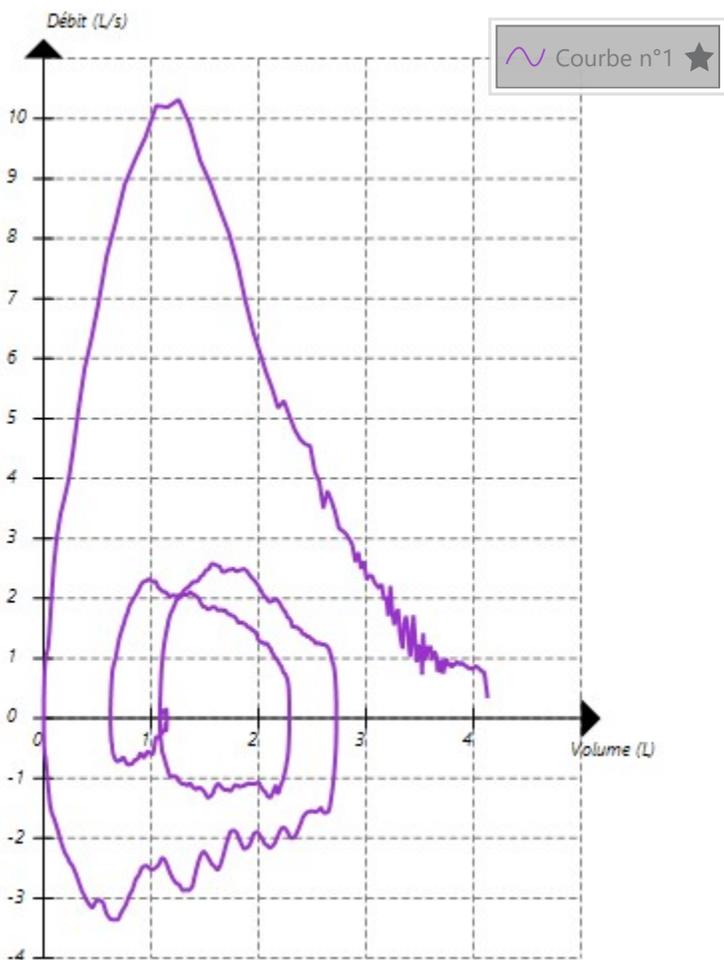

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,14 L	4,77 L	86,79 %
VEMS	3,75 L	4,01 L	93,52 %
DEP	10,38 L/s	-	-
VEMS/CVF	90,58 %	83,94 %	107,91 %
Durée d'expiration	1,59 s	-	-
DEMM	5,14 L/s	4,38 L/s	117,35 %
DEMM/CVF	1,24 s-1	0,92 s-1	134,78 %
DE75	10,18 L/s	-	-
DE50	5,85 L/s	-	-
DE25	2,09 L/s	-	-

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: