

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom LANCINE</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/2000</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 24 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 962</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 175 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 61 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29,1 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 56 %

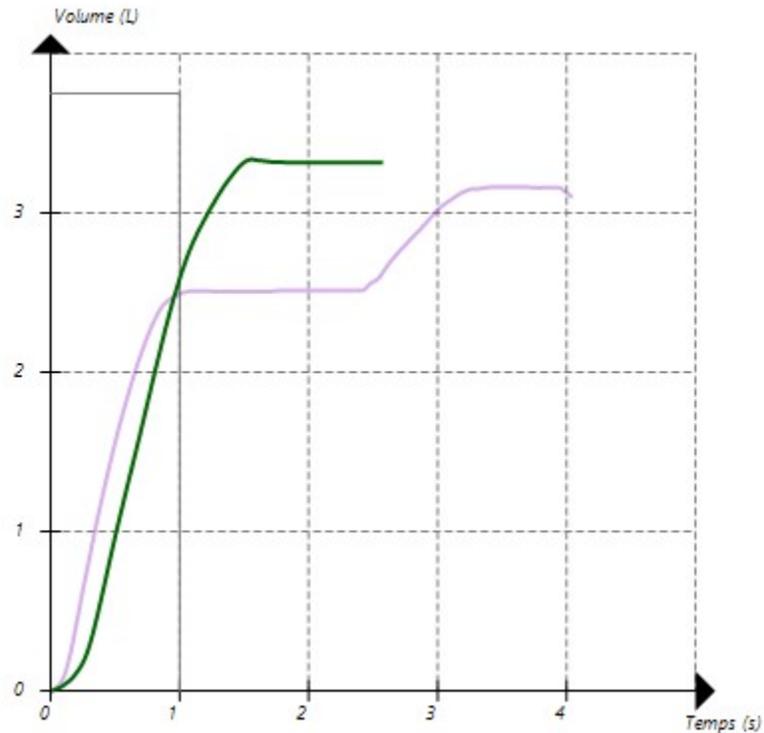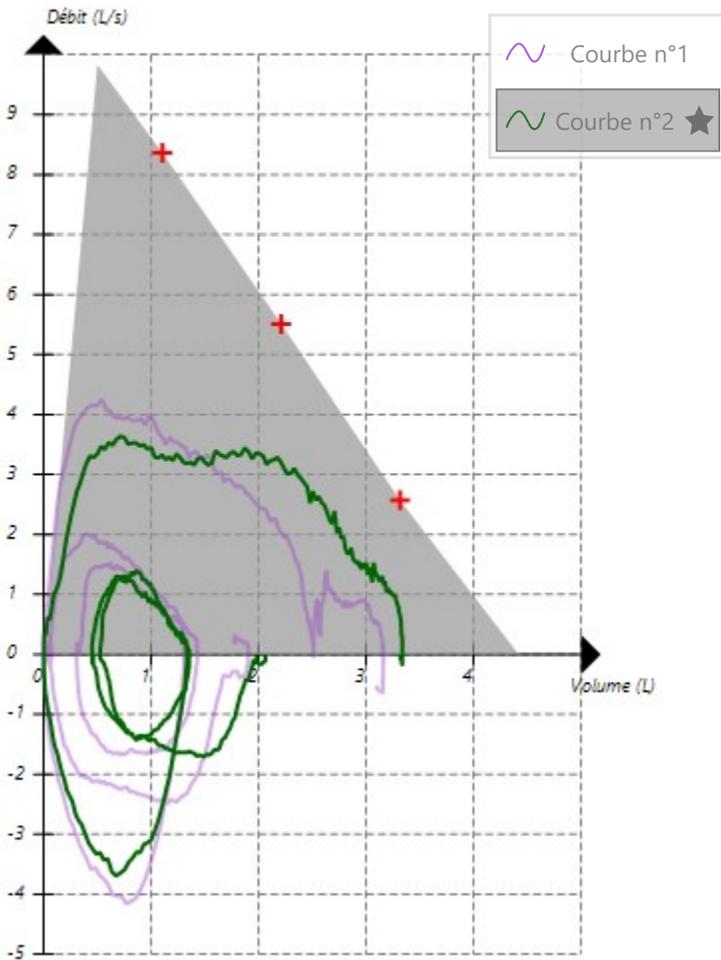

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,16 L	3,34 L	4,42 L	75,57 %
VEMS	2,51 L	3,02 L	3,75 L	80,53 %
DEP	4,30 L/s	3,71 L/s	9,83 L/s	37,74 %
VEMS/CVF	79,43 %	90,42 %	82,74 %	109,28 %
Durée d'expiration	3,43 s	1,56 s	-	
DEMM	2,91 L/s	3,30 L/s	5,03 L/s	65,61 %
DEMM/CVF	0,92 s-1	0,99 s-1	0,99 s-1	100,00 %
DE75	3,94 L/s	3,48 L/s	8,36 L/s	41,63 %
DE50	3,15 L/s	3,35 L/s	5,51 L/s	60,80 %
DE25	1,44 L/s	2,80 L/s	2,57 L/s	108,95 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: