

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom MORY</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1996</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 29 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 4352</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 172 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 72 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Eccs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BAH OUMOU SALAMATA</b>	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 34,4 °C  
 Pression atmosphérique : 94,9 kPa  
 Humidité : 50 %

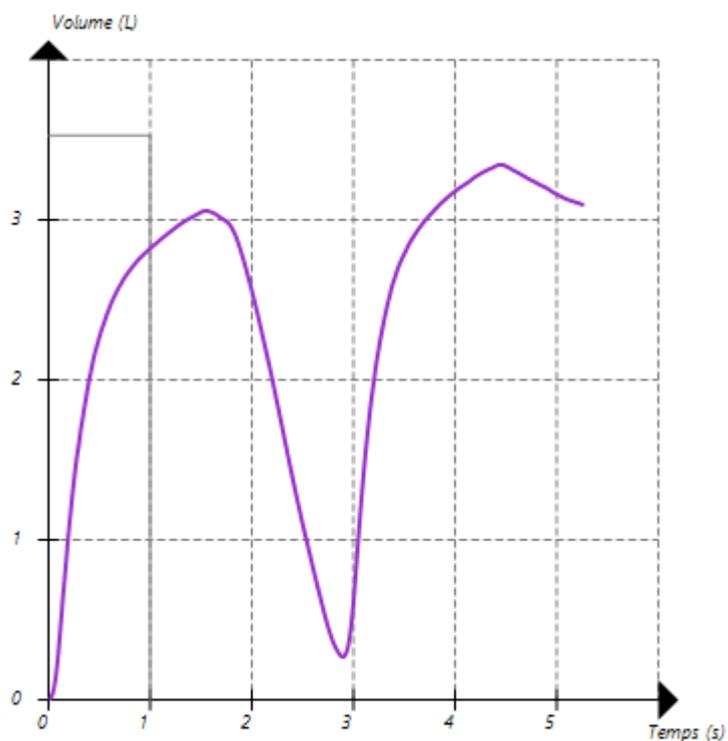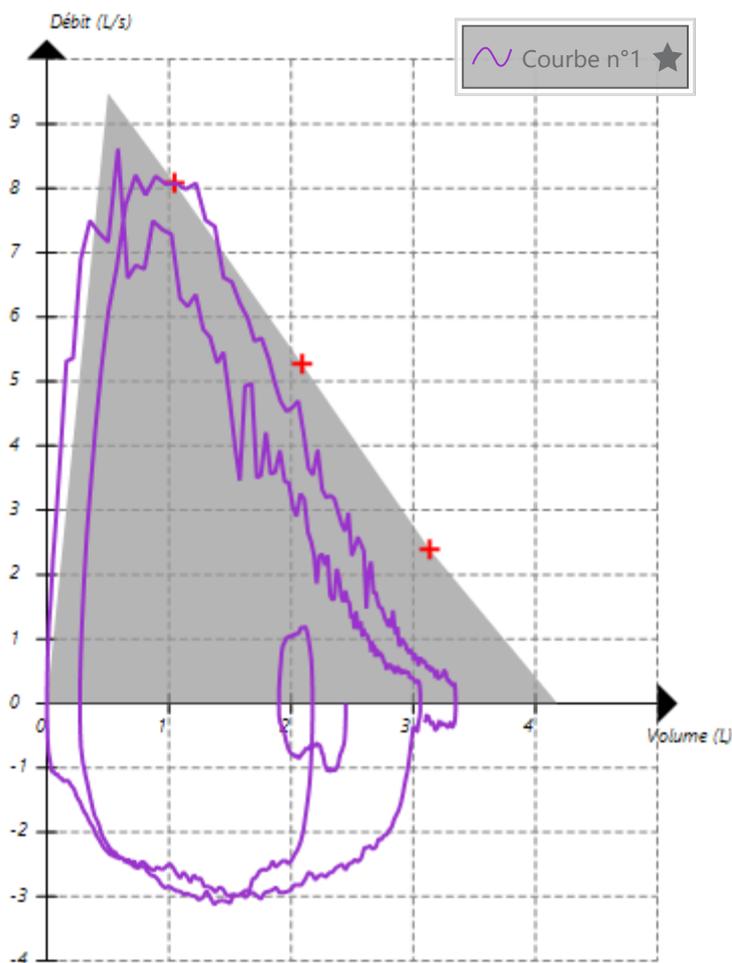

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,06 L	4,18 L	73,21 %
VEMS	2,85 L	3,53 L	80,74 %
DÉP	8,96 L/s	9,48 L/s	94,51 %
VEMS/CVF	93,14 %	82,02 %	113,56 %
Durée d'expiration	1,54 s	-	
DEMM	4,33 L/s	4,80 L/s	90,21 %
DEMM/CVF	1,42 s <sup>-1</sup>	1,00 s <sup>-1</sup>	142,00 %
DE75	7,61 L/s	8,08 L/s	94,18 %
DE50	3,42 L/s	5,27 L/s	64,90 %
DE25	2,59 L/s	2,39 L/s	108,37 %