

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 06/07/1999	<b>Profession</b> CHAUFFEUR PL
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3725	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 179 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 99 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,9 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 40 %

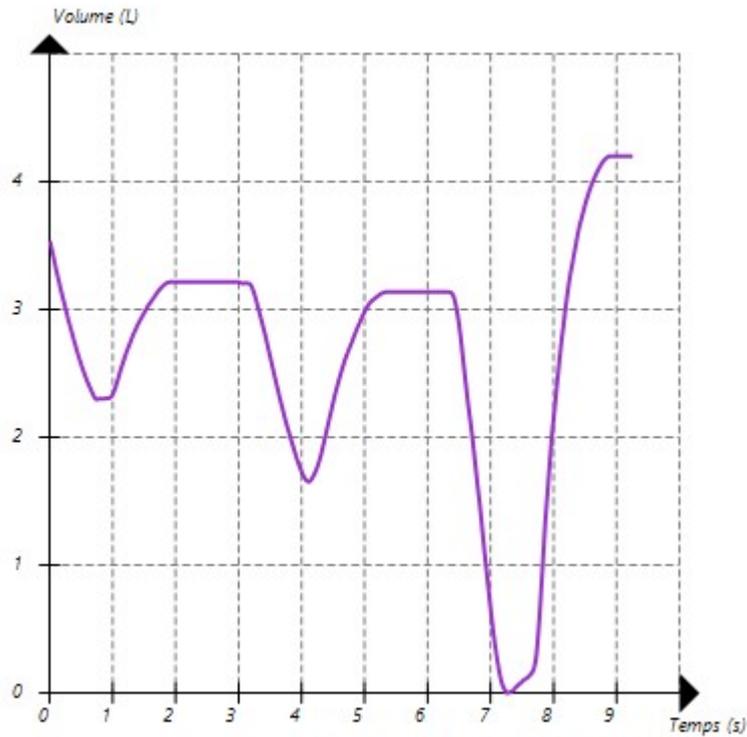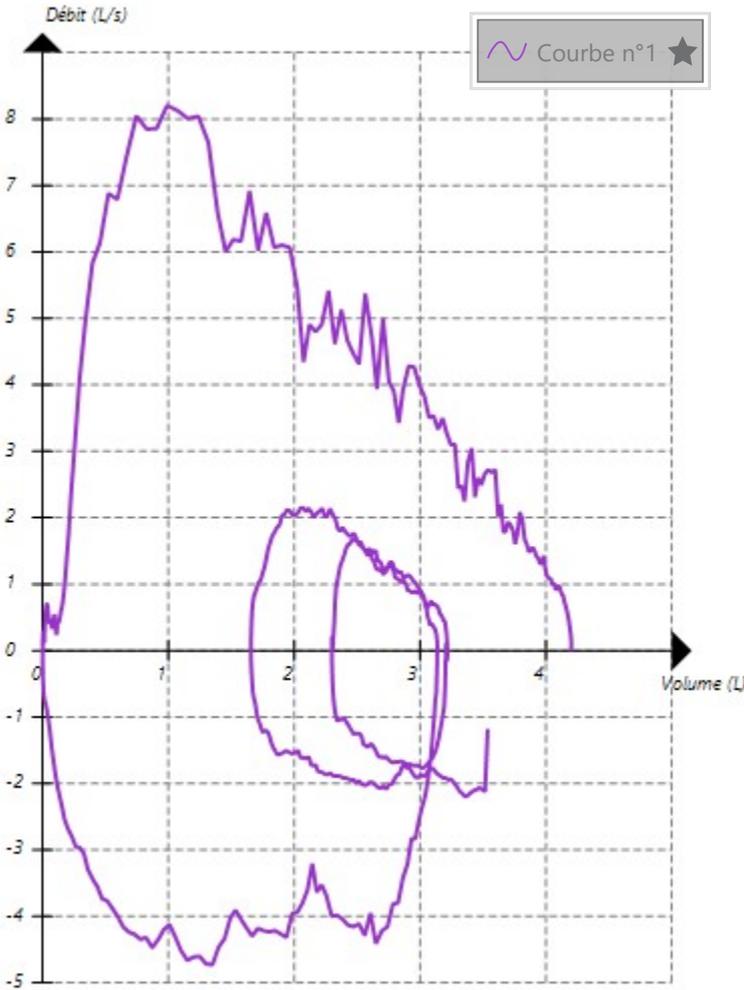

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,20 L	4,73 L	88,79 %
VEMS	4,09 L	3,99 L	102,51 %
DEP	8,39 L/s	9,96 L/s	84,24 %
VEMS/ CVF	97,38 %	84,67 %	115,01 %
Durée d'expiration	1,64 s	-	
DEMM	5,31 L/s	4,44 L/s	119,59 %
DEMM/ CVF	1,26 s-1	0,94 s-1	134,04 %
DE75	8,01 L/s	-	
DE50	5,10 L/s	-	
DE25	3,21 L/s	-	