

**Nom** KOMARA  
**Prénom** ANSOUMANE  
**Né le** 01/01/1999  
**Age** 25 Ans  
**Genre** Masculin  
**ID** 1491  
**Taille** 172 cm  
**Poids** 68 kg  
**Valeurs prédites** Knudson  
**Opérateur** admin admin

**Adresse**  
**Exposition**  
**Profession**  
**Entreprise** CR18  
**Service** MANOEUVRE  
**Fumeur** Non fumeur  
**Groupe ethnique** Origine africaine  
**Prescripteur:**  
**Smoking Pack Years** : 0



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,6 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 56 %

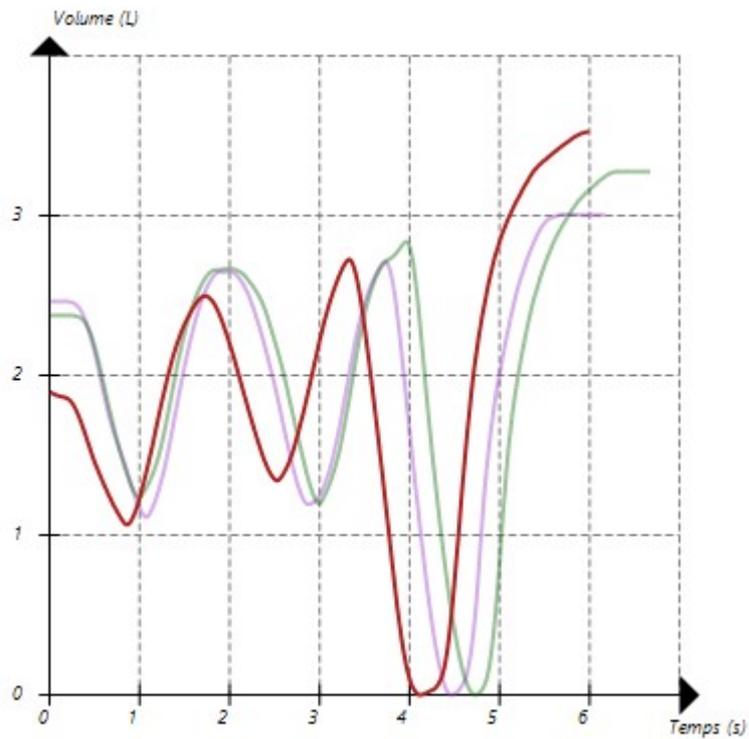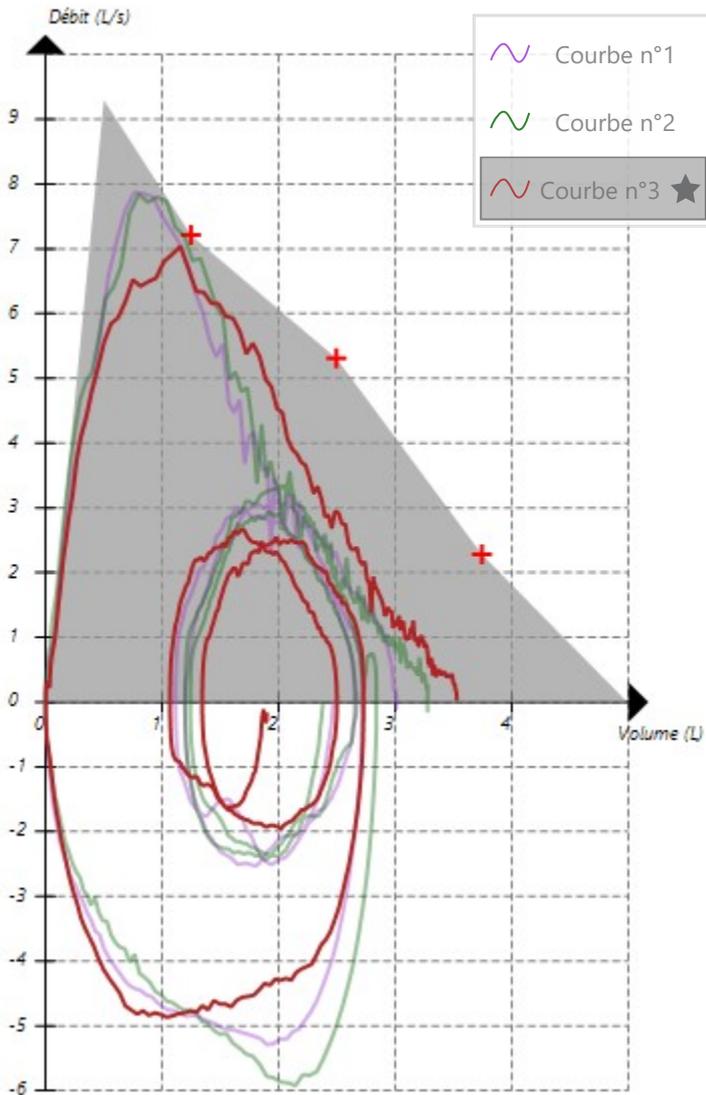

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,01 L	3,28 L	3,53 L	4,99 L	70,74 %
VEMS	3,00 L	3,10 L	3,29 L	4,20 L	78,33 %
DEP	7,93 L/s	7,89 L/s	7,38 L/s	9,30 L/s	79,35 %
VEMS/ CVF	99,67 %	94,51 %	93,20 %	84,08 %	110,85 %
Durée d'expiration	1,24 s	1,55 s	1,88 s	-	
DEMM	4,70 L/s	4,41 L/s	4,64 L/s	4,53 L/s	102,43 %
DEMM/ CVF	1,56 s-1	1,34 s-1	1,31 s-1	0,91 s-1	143,96 %
DE75	7,88 L/s	7,85 L/s	6,47 L/s	7,21 L/s	89,74 %
DE50	5,78 L/s	5,44 L/s	5,58 L/s	5,31 L/s	105,08 %
DE25	2,70 L/s	2,08 L/s	2,19 L/s	2,28 L/s	96,05 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: