

<b>Nom</b> FOFANA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> AICHA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1992	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 640	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 52 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 30,8 °C  
 Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Humidité : 49 %

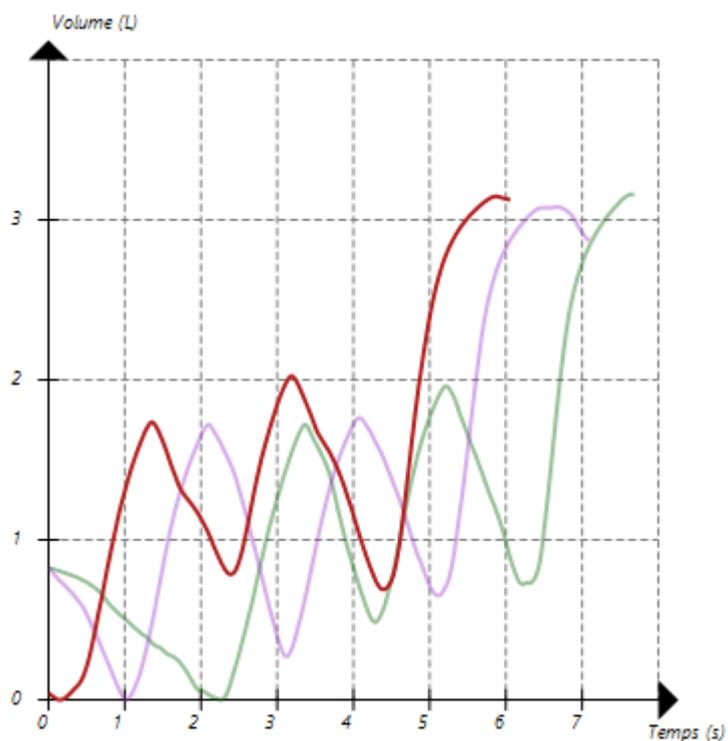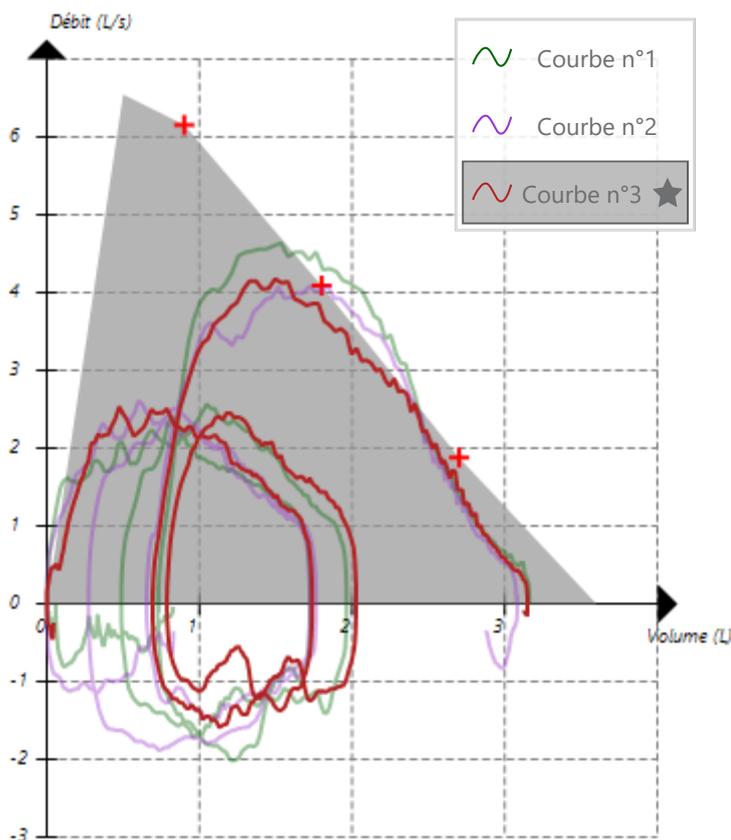

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,43 L	2,43 L	2,46 L	3,60 L	68,33 %
VEMS	2,35 L	2,36 L	2,34 L	3,05 L	76,72 %
DÉP	4,67 L/s	4,15 L/s	4,25 L/s	6,55 L/s	64,89 %
VEMS/ CVF	96,71 %	97,12 %	95,12 %	85,07 %	111,81 %
Durée d'expiration	1,39 s	1,55 s	1,48 s	-	
DEMM	3,73 L/s	3,61 L/s	3,33 L/s	3,55 L/s	93,80 %
DEMM/ CVF	1,53 s <sup>-1</sup>	1,49 s <sup>-1</sup>	1,35 s <sup>-1</sup>	0,99 s <sup>-1</sup>	136,36 %
DE75	4,56 L/s	3,43 L/s	4,09 L/s	6,16 L/s	66,40 %
DE50	4,18 L/s	3,92 L/s	3,53 L/s	4,09 L/s	86,31 %
DE25	1,91 L/s	2,01 L/s	1,90 L/s	1,88 L/s	101,06 %