



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SIDIKI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 12/02/1987	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 6056	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 92 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,2 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 55 %

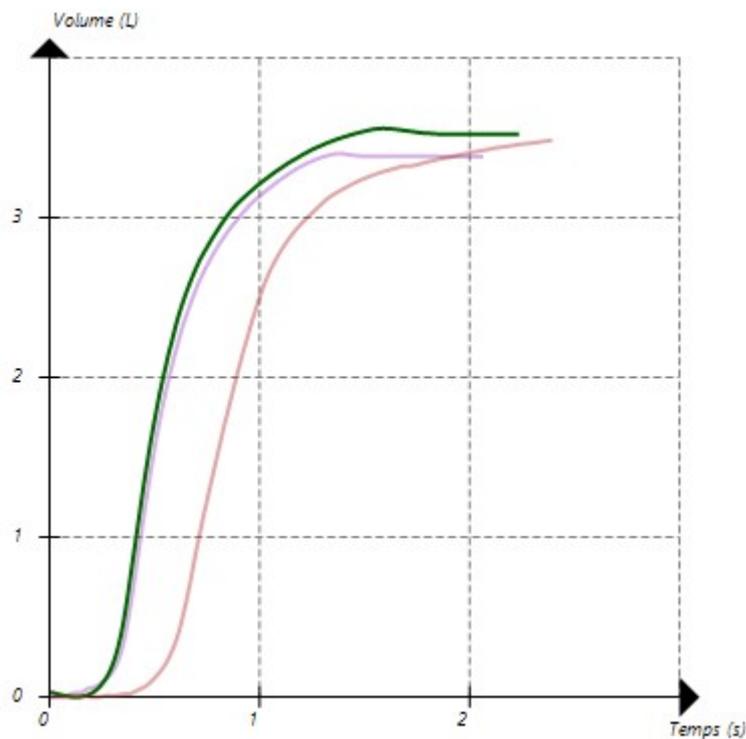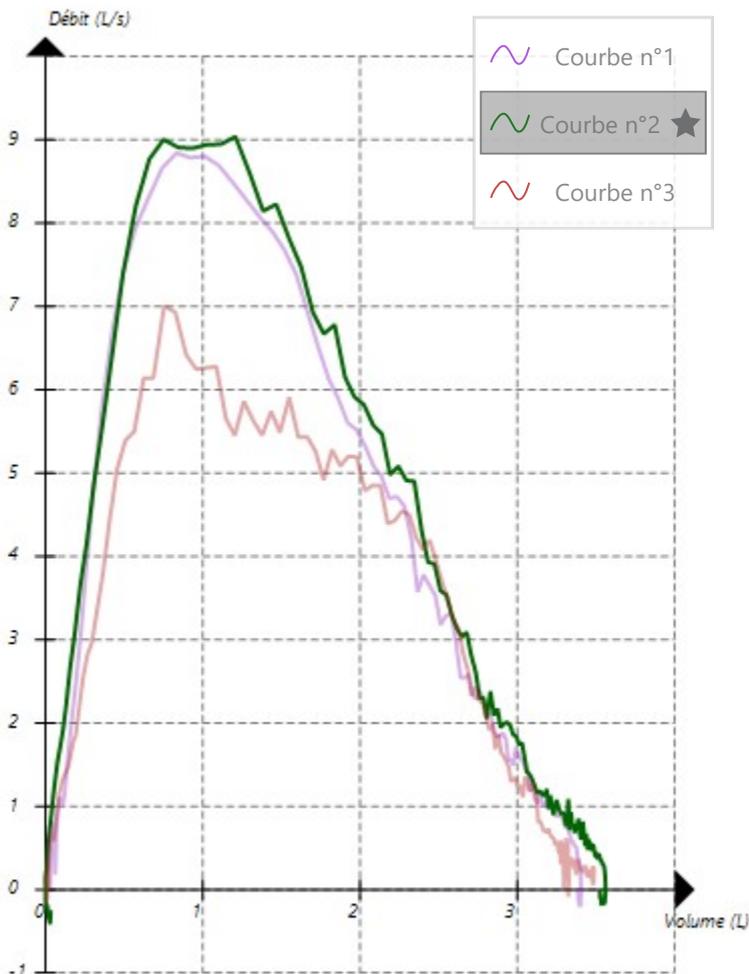

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,40 L	3,56 L	3,48 L	3,80 L	93,68 %
VEMS	3,38 L	3,45 L	3,27 L	3,14 L	109,87 %
DEP	8,94 L/s	9,35 L/s	7,15 L/s	8,30 L/s	112,65 %
VEMS/CVF	99,41 %	96,91 %	93,97 %	82,29 %	117,77 %
Durée d'expiration	1,32 s	1,46 s	2,10 s	-	
DEMM	6,07 L/s	6,07 L/s	5,12 L/s	3,45 L/s	175,94 %
DEMM/CVF	1,79 s-1	1,71 s-1	1,47 s-1	0,91 s-1	187,91 %
DE75	8,86 L/s	8,69 L/s	6,58 L/s	-	
DE50	6,70 L/s	6,75 L/s	4,52 L/s	-	
DE25	3,36 L/s	3,27 L/s	3,22 L/s	-	