

<b>Nom</b> DOUMBOUYA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1997	<b>Profession</b> BUS DRIVER
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> CE18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 8399	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 73 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 24,8 °C  
 Pression atmosphérique : 94,3 kPa  
 Humidité : 54 %

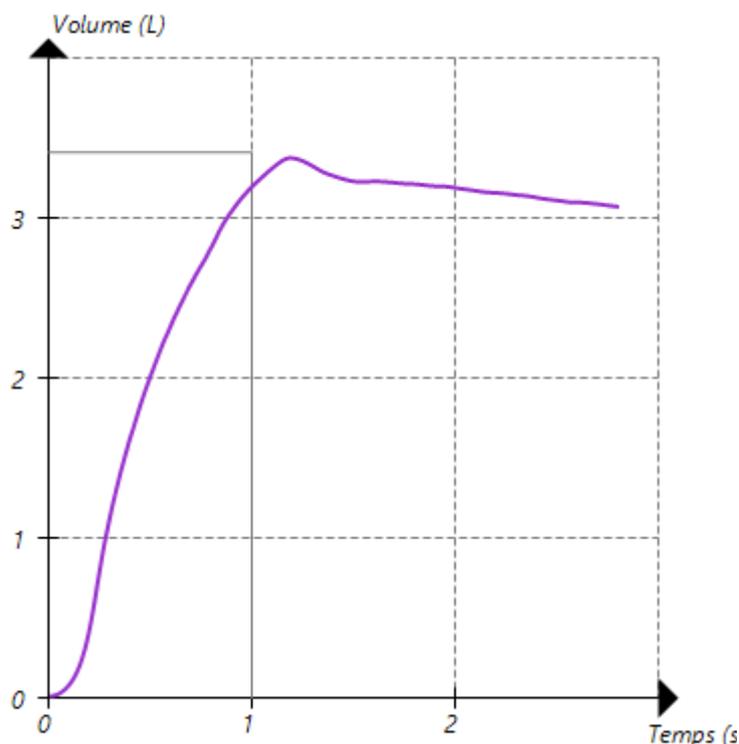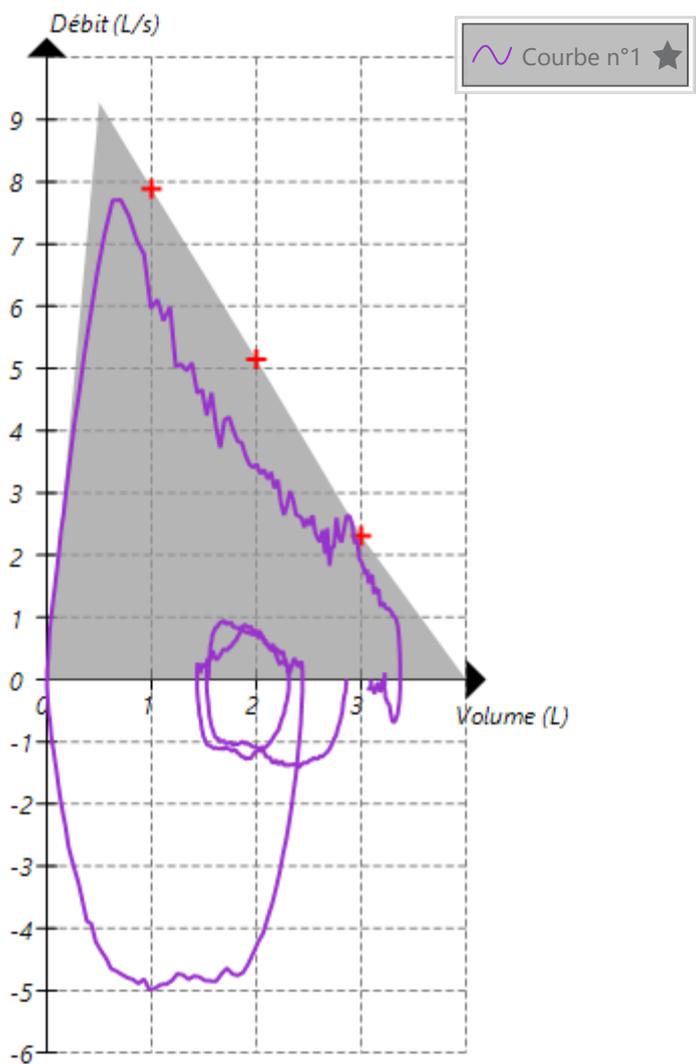

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,37 L	4,00 L	84,25 %
VEMS	3,35 L	3,41 L	98,24 %
DÉP	7,89 L/s	9,28 L/s	85,02 %
VEMS/CVF	99,41 %	82,20 %	120,94 %
Durée d'expiration	1,25 s	-	
DEMM	4,01 L/s	4,76 L/s	84,24 %
DEMM/CVF	1,19 s <sup>-1</sup>	1,03 s <sup>-1</sup>	115,53 %
DE75	7,14 L/s	7,89 L/s	90,49 %
DE50	4,08 L/s	5,15 L/s	79,22 %
DE25	2,86 L/s	2,31 L/s	123,81 %