



<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> VASSE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 15/07/1993	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 32 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 9299	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 57 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,8 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 60 %

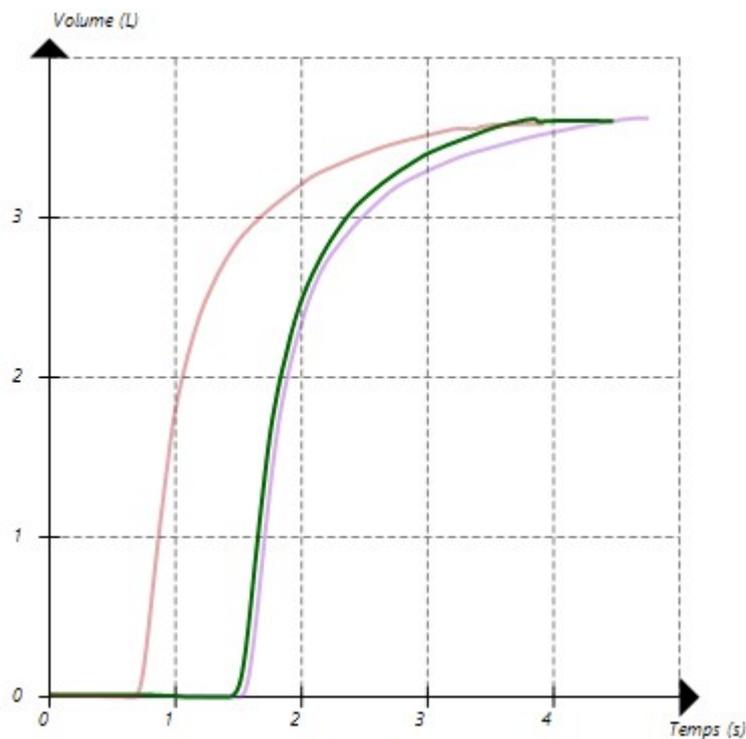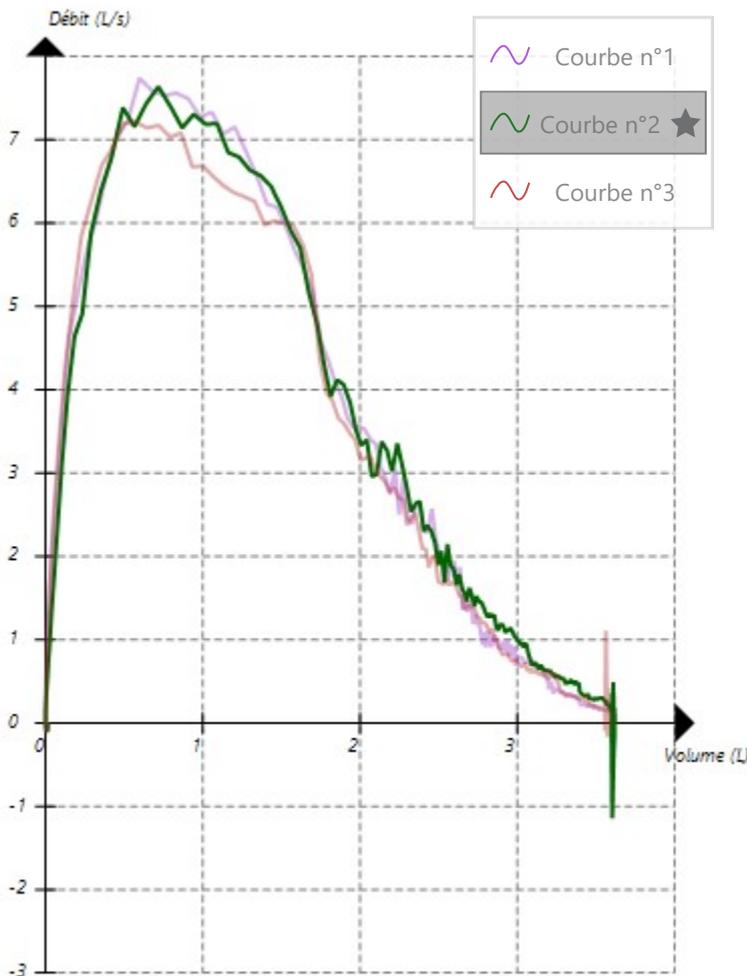

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,62 L	3,62 L	3,59 L	3,91 L	92,58 %
VEMS	3,07 L	3,14 L	3,04 L	3,28 L	95,73 %
DEP	7,86 L/s	7,95 L/s	7,36 L/s	8,54 L/s	93,09 %
VEMS/CVF	84,81 %	86,74 %	84,68 %	83,39 %	104,02 %
Durée d'expiration	3,46 s	2,48 s	3,10 s	-	
DEMM	3,64 L/s	3,71 L/s	3,48 L/s	3,71 L/s	100,00 %
DEMM/CVF	1,01 s-1	1,02 s-1	0,97 s-1	0,95 s-1	107,37 %
DE75	7,50 L/s	7,20 L/s	6,77 L/s	-	
DE50	4,14 L/s	3,88 L/s	3,81 L/s	-	
DE25	1,18 L/s	1,56 L/s	1,41 L/s	-	