

<b>Nom SYLLA</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom MAMADY</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 12/06/1990</b>	<b>Profession FLAGMAN</b>
<b>Age 34 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 3850</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 171 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 76 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites NHANES III</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,4 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 31 %

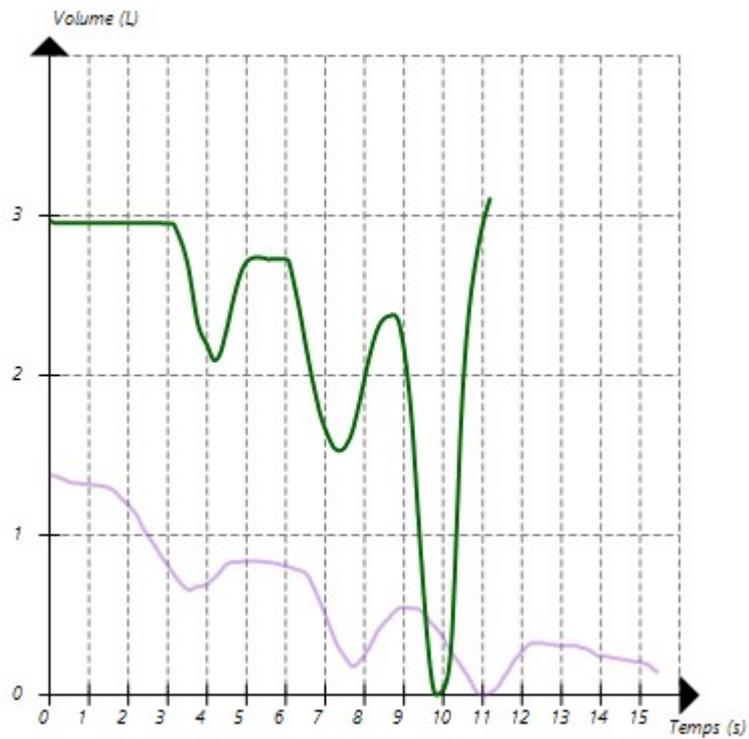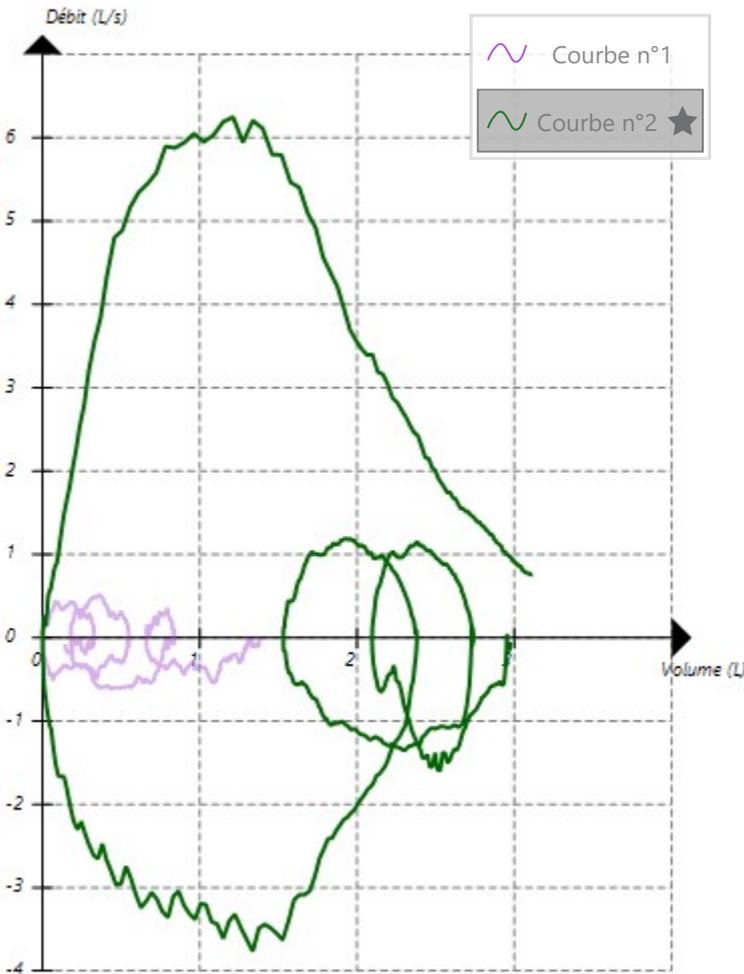

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	0,37 L	3,12 L	4,10 L	76,10 %
VEMS	0,36 L	3,09 L	3,41 L	90,62 %
DEP	0,53 L/s	6,36 L/s	8,83 L/s	72,03 %
VEMS/CVF	97,30 %	99,04 %	83,02 %	119,30 %
Durée d'expiration	1,24 s	1,39 s	-	
DEMM	0,40 L/s	4,70 L/s	3,77 L/s	124,67 %
DEMM/CVF	1,08 s-1	1,51 s-1	0,92 s-1	164,13 %
DE75	0,40 L/s	5,95 L/s	-	
DE50	0,51 L/s	5,48 L/s	-	
DE25	0,27 L/s	2,54 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: