

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY 1	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 03/04/1993	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 891	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,9 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 64 %

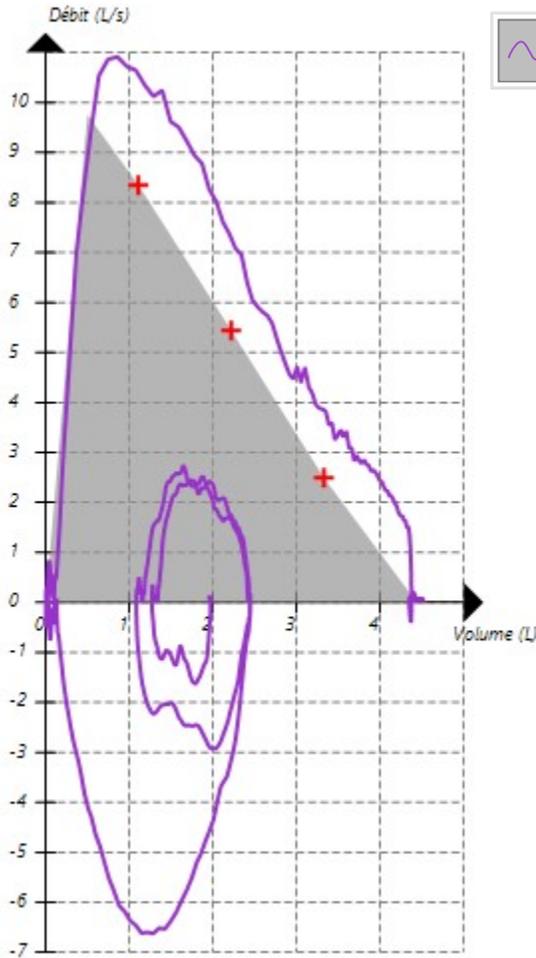

Courbe n°1 ★

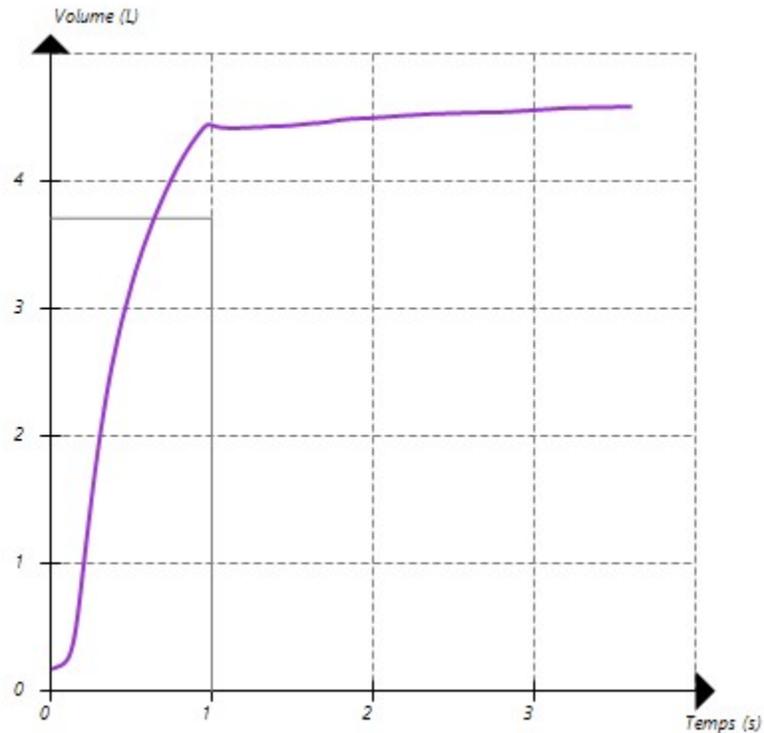

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,36 L	4,44 L	98,20 %
VEMS	4,36 L	3,71 L	117,52 %
DEP	10,99 L/s	9,76 L/s	112,60 %
VEMS/ CVF	100,00 %	81,66 %	122,46 %
Durée d'expiration	1,22 s	-	
DEMM	6,79 L/s	4,83 L/s	140,58 %
DEMM/ CVF	1,56 s-1	0,95 s-1	164,21 %
DE75	10,47 L/s	8,35 L/s	125,39 %
DE50	7,41 L/s	5,44 L/s	136,21 %
DE25	3,94 L/s	2,49 L/s	158,23 %