

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> YOUSOUF	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 30/06/1994	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1020	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 54 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 1
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 25,5 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 65 %

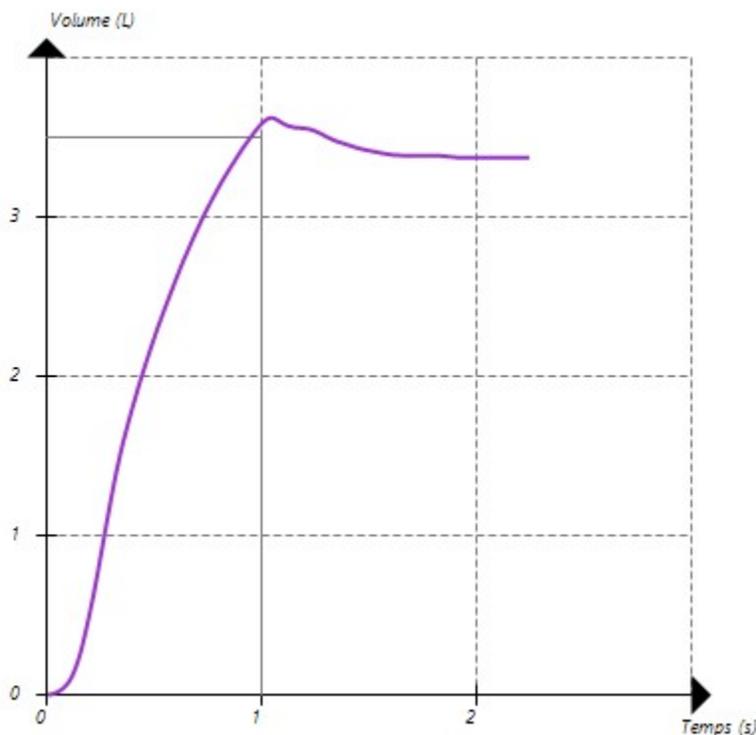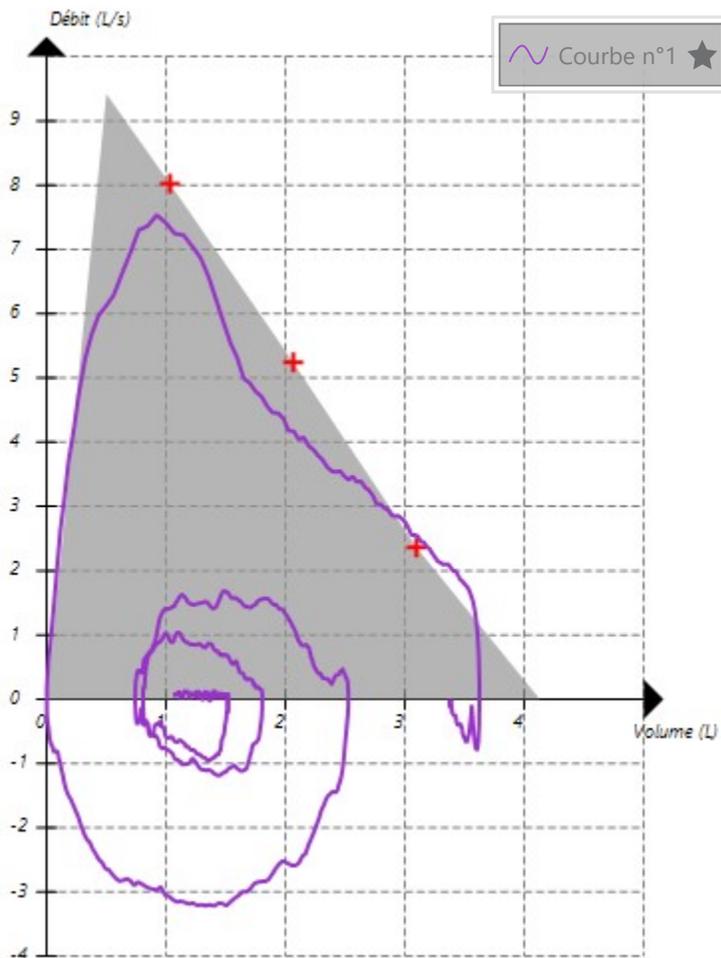

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,62 L	4,13 L	87,65 %
VEMS	3,62 L	3,50 L	103,43 %
DEP	7,58 L/s	9,42 L/s	80,47 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,02 %	121,92 %
Durée d'expiration	1,05 s	-	
DEMM	4,79 L/s	4,78 L/s	100,21 %
DEMM/ CVF	1,32 s-1	1,01 s-1	130,69 %
DE75	7,52 L/s	8,02 L/s	93,77 %
DE50	4,65 L/s	5,24 L/s	88,74 %
DE25	3,21 L/s	2,36 L/s	136,02 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: