

<b>Nom</b> YE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> JIELING	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/10/1997	<b>Profession</b> DEP INGENIEUR
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 790	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,8 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 62 %

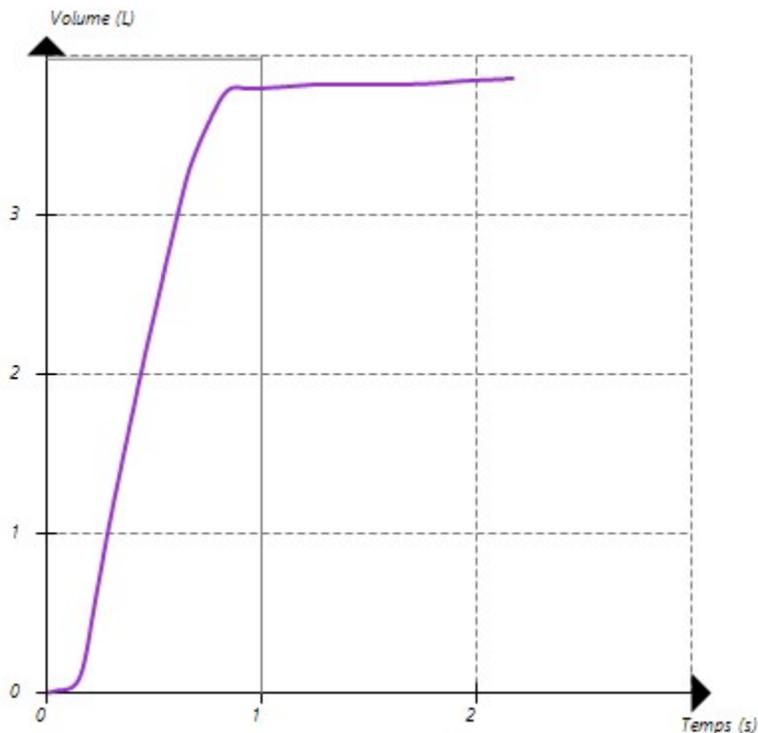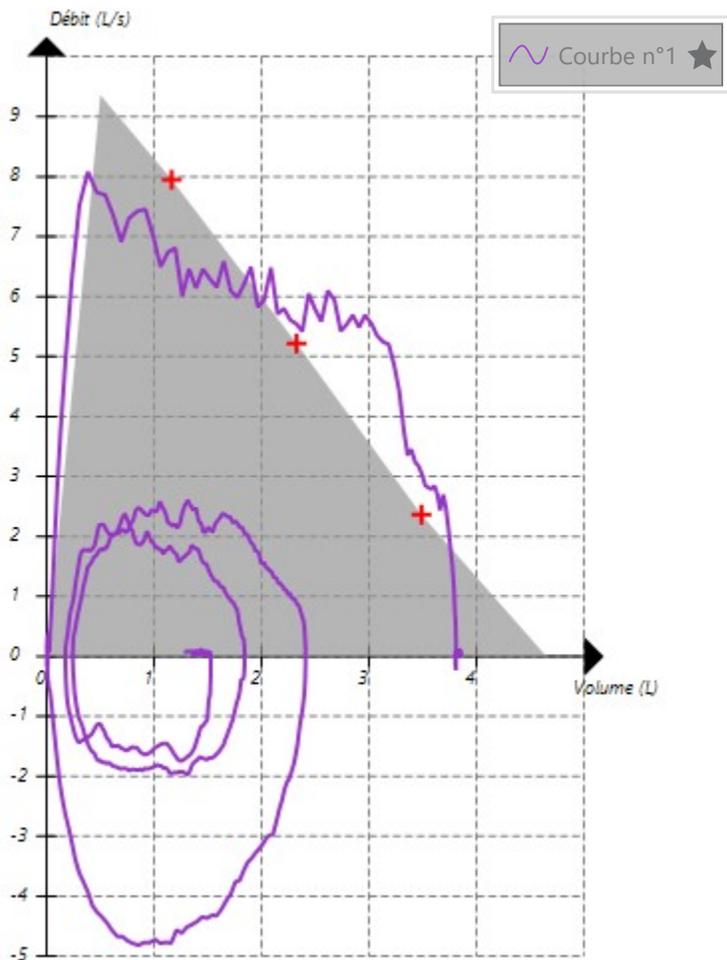

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,85 L	4,65 L	82,80 %
VEMS	3,81 L	3,98 L	95,73 %
DEP	8,22 L/s	9,36 L/s	87,82 %
VEMS/CVF	98,96 %	82,56 %	119,86 %
Durée d'expiration	2,14 s	-	
DEMM	6,19 L/s	4,85 L/s	127,63 %
DEMM/CVF	1,61 s-1	1,04 s-1	154,81 %
DE75	6,90 L/s	7,95 L/s	86,79 %
DE50	6,39 L/s	5,22 L/s	122,41 %
DE25	5,41 L/s	2,36 L/s	229,24 %