

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LONCENY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 25/10/1997	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1004	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,7 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 64 %

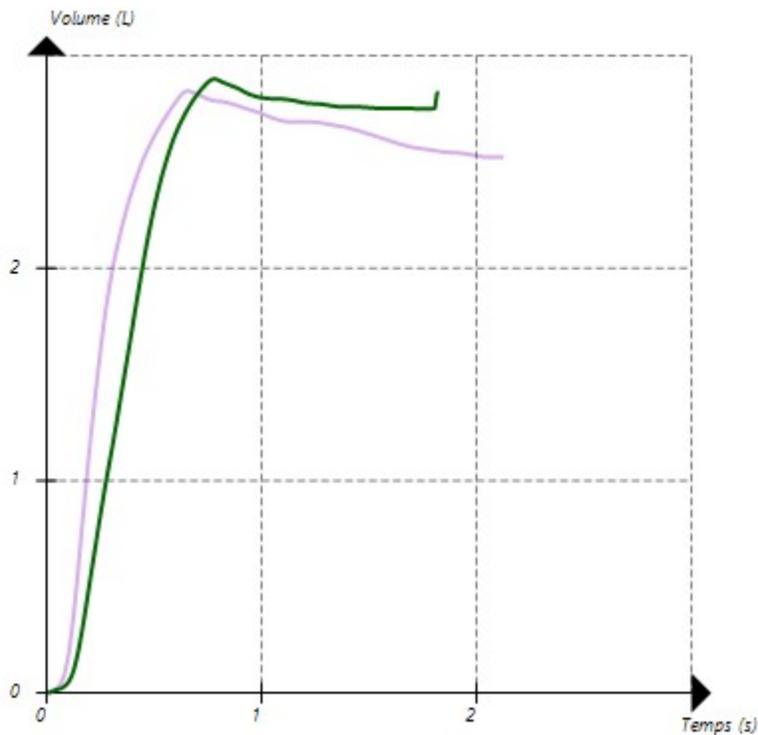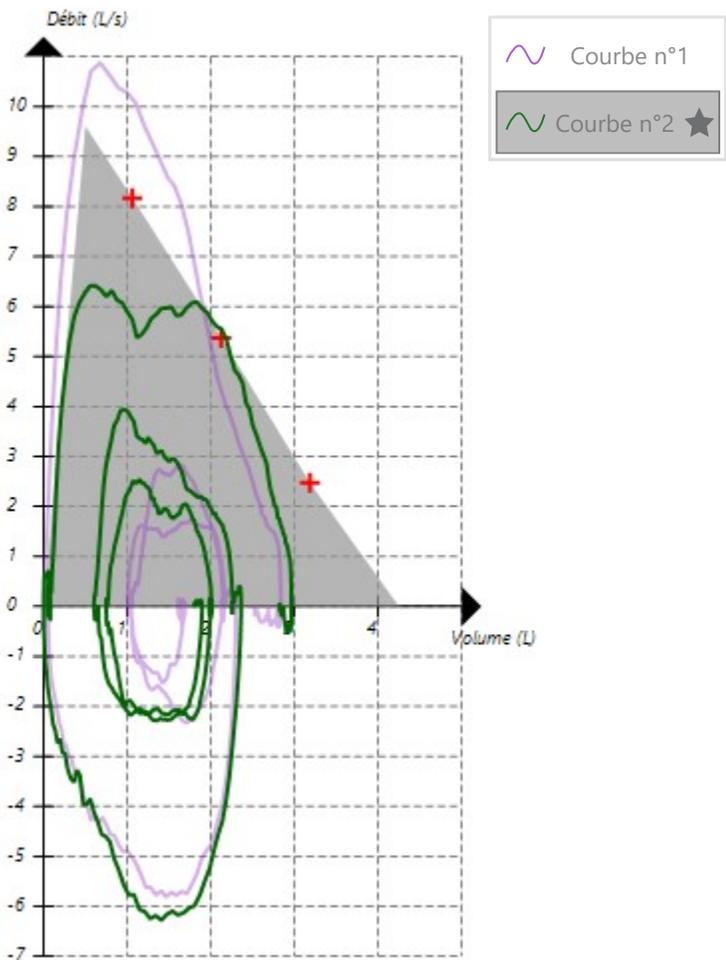

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,84 L	2,89 L	4,25 L	68,00 %
VEMS	2,84 L	2,89 L	3,61 L	80,06 %
DEP	10,95 L/s	6,46 L/s	9,61 L/s	67,22 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	82,56 %	121,12 %
Durée d'expiration	0,66 s	0,78 s	-	
DEMM	8,05 L/s	5,93 L/s	4,92 L/s	120,53 %
DEMM/ CVF	2,83 s-1	2,05 s-1	1,01 s-1	202,97 %
DE75	10,82 L/s	6,30 L/s	8,17 L/s	77,11 %
DE50	8,88 L/s	5,95 L/s	5,37 L/s	110,80 %
DE25	4,32 L/s	4,93 L/s	2,47 L/s	199,60 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: