

<b>Nom</b> KONE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KASSIMOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 04/03/1996	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1411	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 181 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 96 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> LY MAMOUDOU	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,2 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 50 %

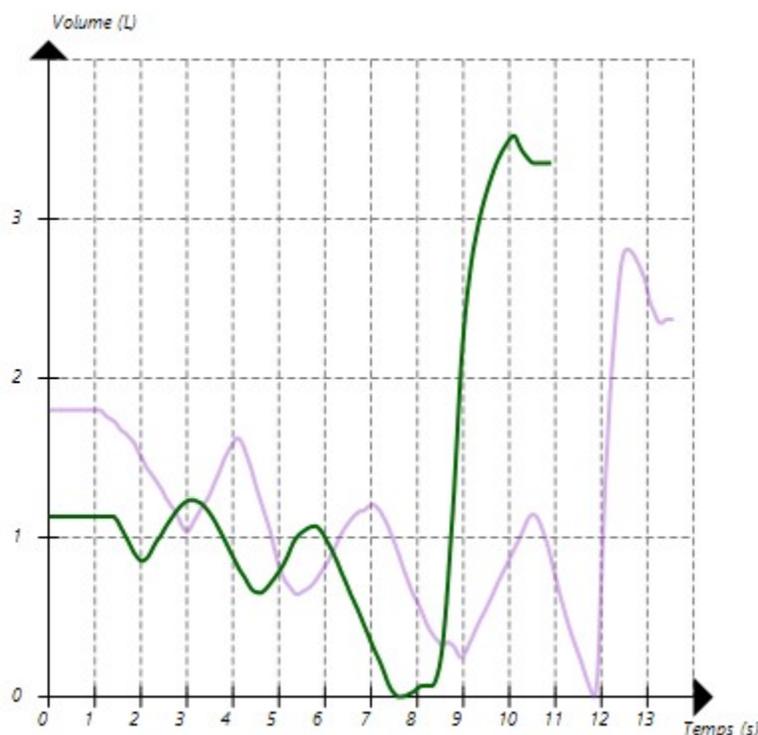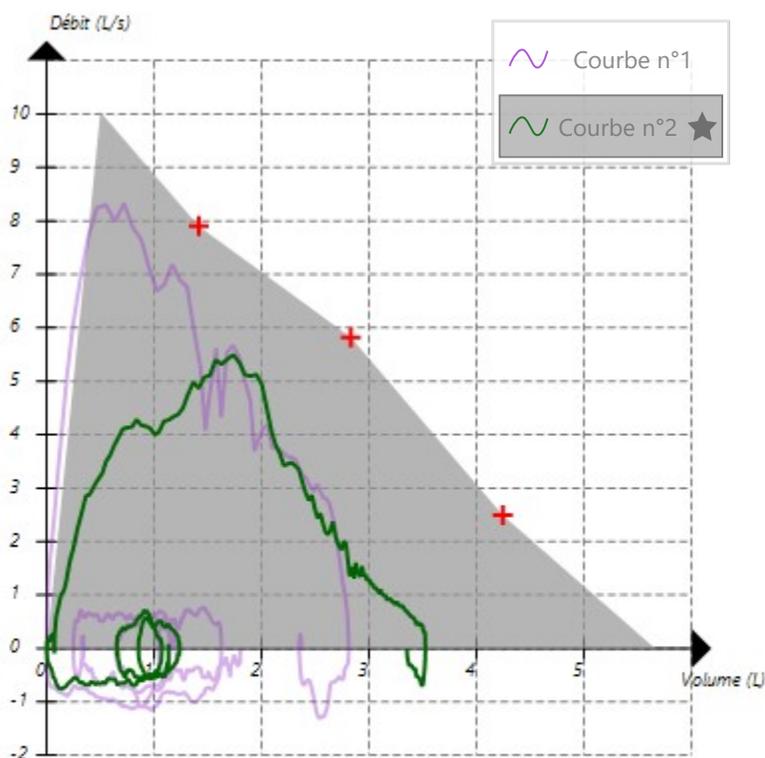

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,81 L	3,45 L	5,66 L	60,95 %
VEMS	2,81 L	3,15 L	4,71 L	66,88 %
DEP	8,48 L/s	5,61 L/s	10,04 L/s	55,88 %
VEMS/ CVF	100,00 %	91,30 %	83,76 %	109,00 %
Durée d'expiration	0,71 s	1,77 s	-	
DEMM	5,74 L/s	4,05 L/s	4,94 L/s	81,98 %
DEMM/ CVF	2,04 s-1	1,17 s-1	0,87 s-1	134,48 %
DE75	8,33 L/s	4,23 L/s	7,90 L/s	53,54 %
DE50	5,72 L/s	5,30 L/s	5,82 L/s	91,07 %
DE25	3,73 L/s	2,36 L/s	2,49 L/s	94,78 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: