



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1989	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 0337	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 31,5 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 698,3 mmHg  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 54 %

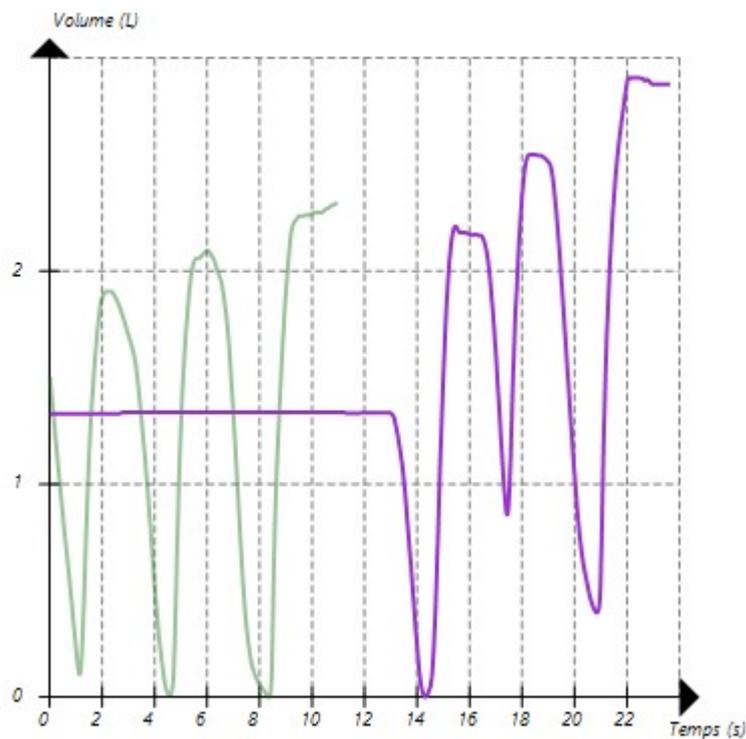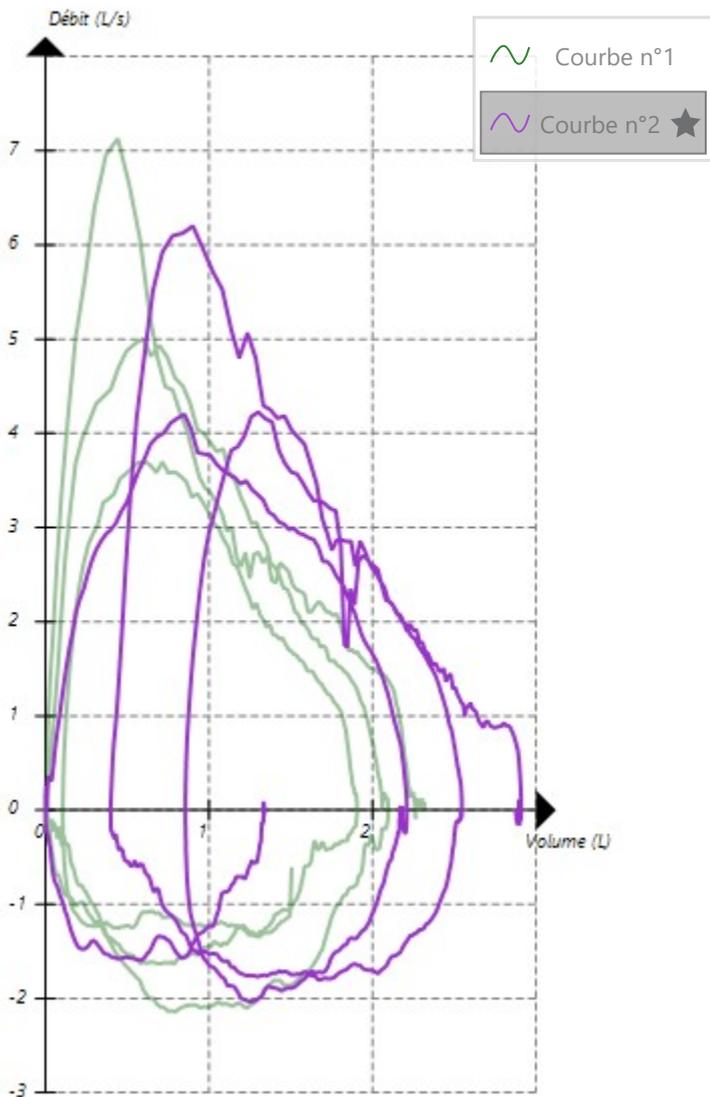

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,32 L	2,51 L	4,08 L	61,52 %
VEMS	2,25 L	2,47 L	3,39 L	72,86 %
DEP	7,29 L/s	6,24 L/s	8,79 L/s	70,99 %
VEMS/ CVF	96,98 %	98,41 %	82,84 %	118,80 %
Durée d'expiration	2,66 s	1,25 s	-	
DEMM	3,04 L/s	3,24 L/s	3,72 L/s	87,10 %
DEMM/ CVF	1,31 s-1	1,29 s-1	0,91 s-1	141,76 %
DE75	6,12 L/s	5,61 L/s	-	
DE50	2,82 L/s	3,49 L/s	-	
DE25	2,08 L/s	1,73 L/s	-	