

<b>Nom</b> TOURE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SIDIKI	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1998	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1093	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,7 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 77 %

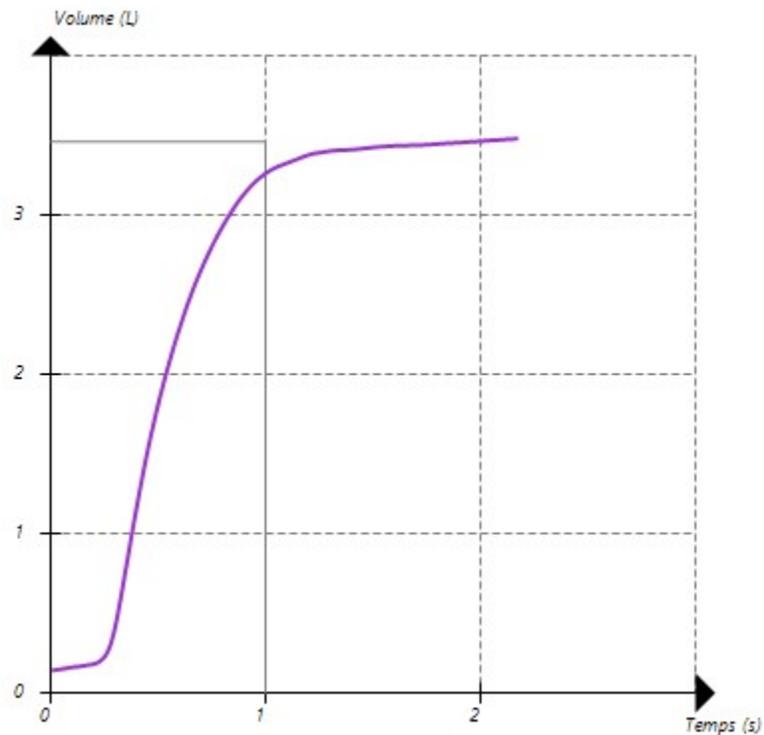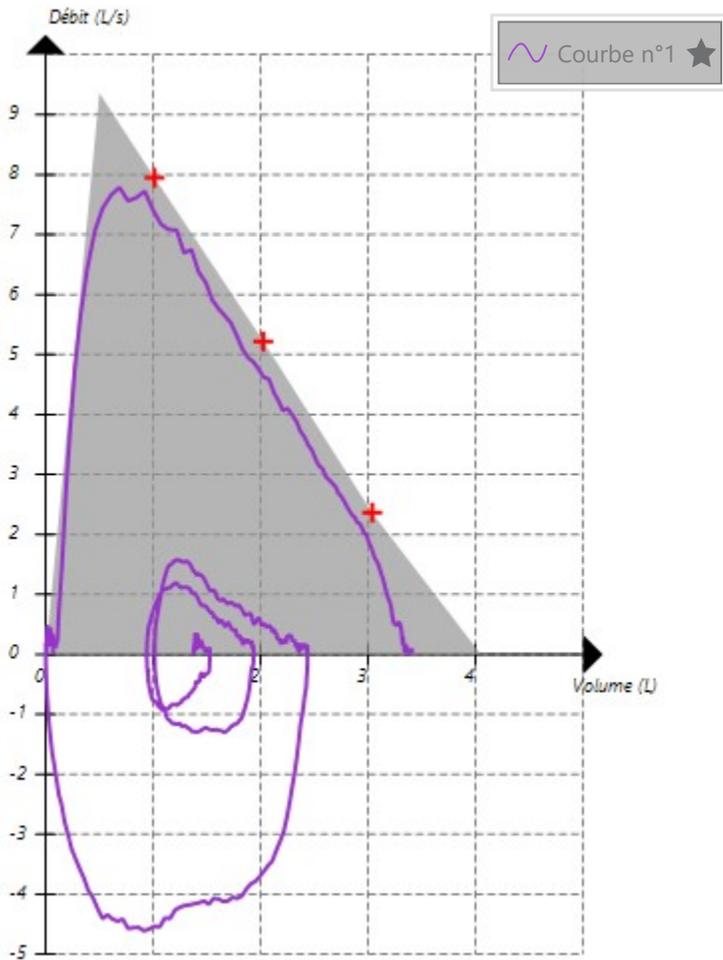

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,41 L	4,05 L	84,20 %
VEMS	3,32 L	3,46 L	95,95 %
DEP	7,88 L/s	9,36 L/s	84,19 %
VEMS/CVF	97,36 %	82,56 %	117,93 %
Durée d'expiration	2,50 s	-	
DEMM	5,28 L/s	4,85 L/s	108,87 %
DEMM/CVF	1,55 s-1	1,04 s-1	149,04 %
DE75	7,56 L/s	7,95 L/s	95,09 %
DE50	5,58 L/s	5,22 L/s	106,90 %
DE25	3,16 L/s	2,36 L/s	133,90 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: