

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> VASSE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1995	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1462	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 82 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> ITS (Crapo)	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Les prédicts sélectionnés ne permettent pas de réaliser ce type d'interprétation.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,1 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 51 %

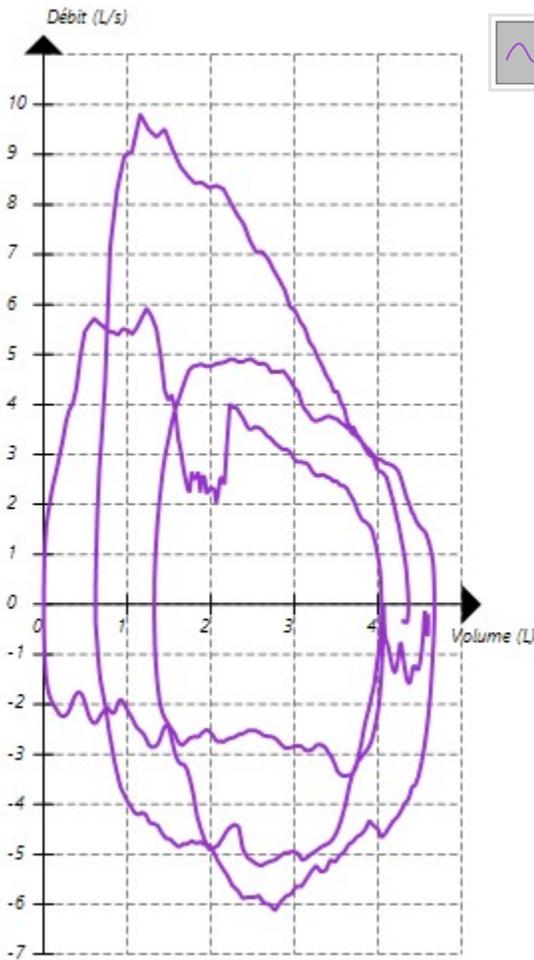

Courbe n°1 ★

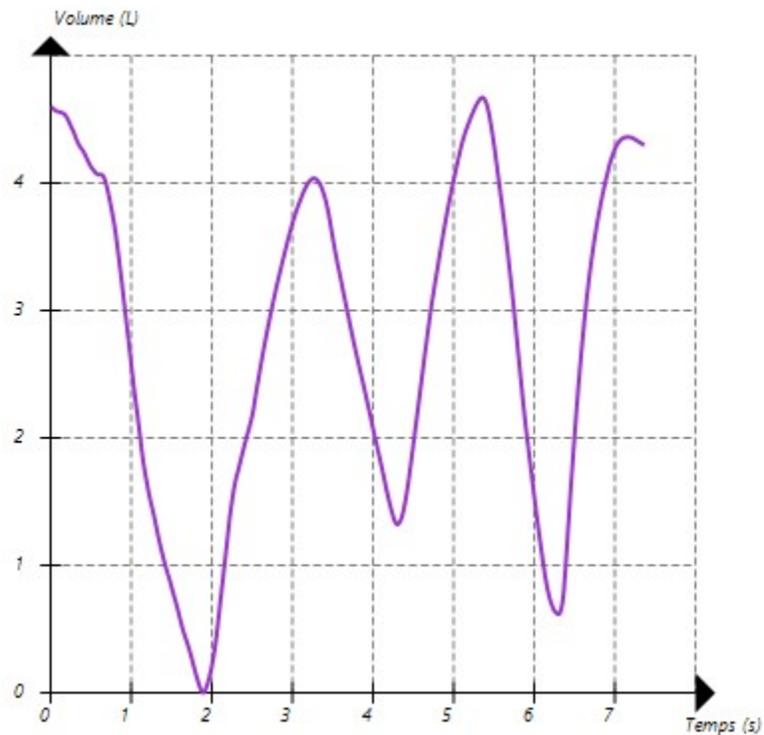

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,74 L	4,93 L	75,86 %
VEMS	3,74 L	4,14 L	90,34 %
DEP	10,04 L/s	-	
VEMS/ CVF	100,00 %	83,98 %	119,08 %
Durée d'expiration	0,85 s	-	
DEMM	6,96 L/s	4,50 L/s	154,67 %
DEMM/ CVF	1,86 s-1	0,91 s-1	204,40 %
DE75	9,11 L/s	-	
DE50	7,15 L/s	-	
DE25	4,51 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: