

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/04/1982	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 42 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 502	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,8 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 52 %

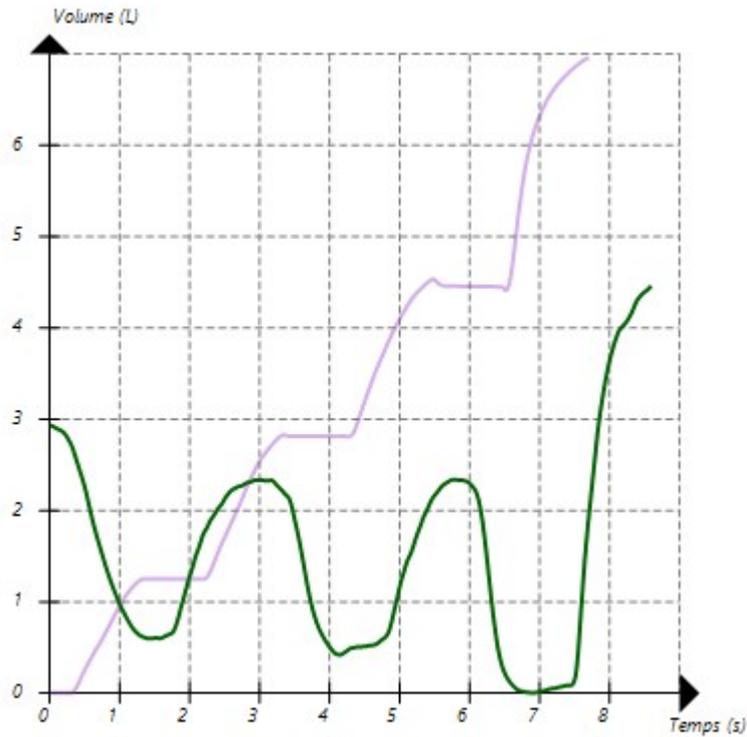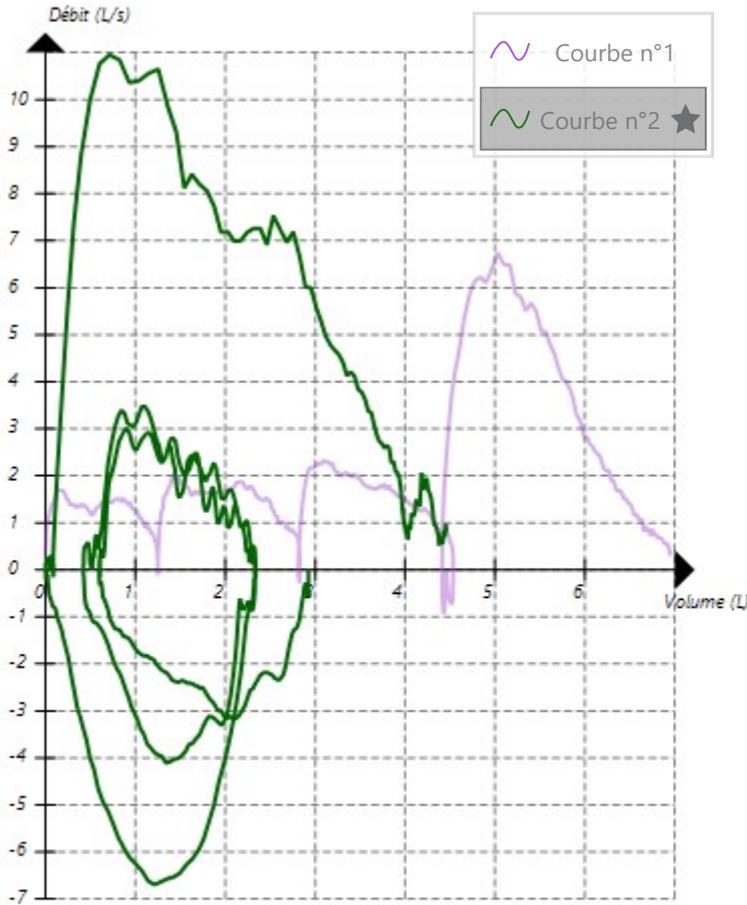

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,55 L	4,39 L	3,67 L	119,62 %
VEMS	2,49 L	4,32 L	3,01 L	143,52 %
DEP	7,02 L/s	11,00 L/s	8,04 L/s	136,82 %
VEMS/ CVF	97,65 %	98,41 %	81,56 %	120,66 %
Durée d'expiration	1,20 s	1,17 s	-	
DEMM	3,81 L/s	7,03 L/s	3,25 L/s	216,31 %
DEMM/ CVF	1,49 s-1	1,60 s-1	0,89 s-1	179,78 %
DE75	6,75 L/s	10,87 L/s	-	
DE50	4,38 L/s	6,82 L/s	-	
DE25	1,86 L/s	4,30 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: