

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> N'VALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1985	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1634	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire mixte.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,1 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,7 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 56 %

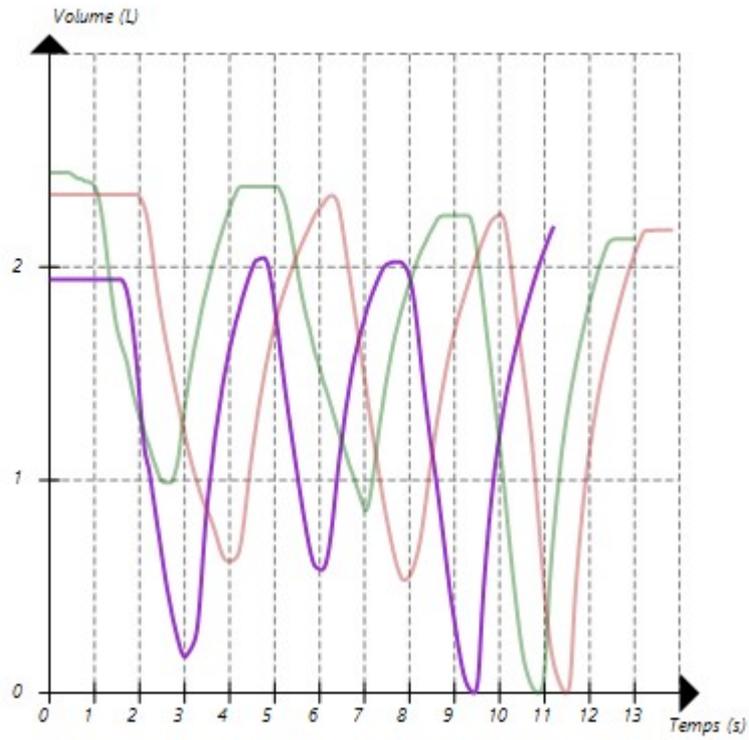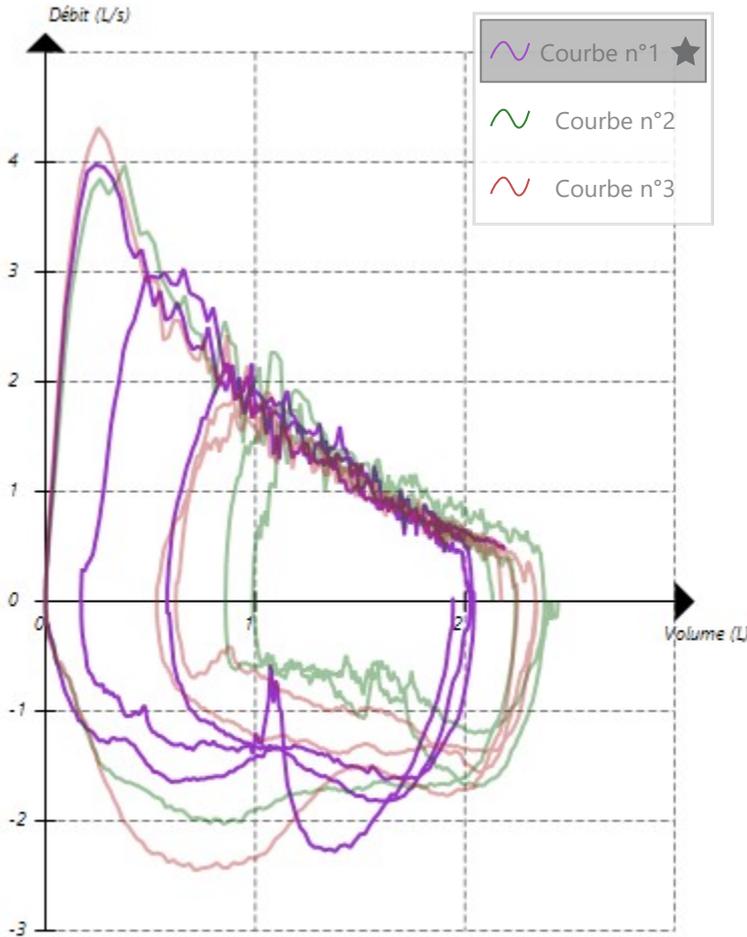

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,20 L	2,13 L	2,17 L	4,06 L	54,19 %
VEMS	1,74 L	1,82 L	1,75 L	3,34 L	52,10 %
DEP	4,03 L/s	4,17 L/s	4,43 L/s	8,72 L/s	46,22 %
VEMS/CVF	79,09 %	85,45 %	80,65 %	82,11 %	96,32 %
Durée d'expiration	1,79 s	1,72 s	2,11 s	-	
DEMM	1,51 L/s	1,69 L/s	1,51 L/s	3,59 L/s	42,06 %
DEMM/CVF	0,69 s-1	0,79 s-1	0,70 s-1	0,88 s-1	78,41 %
DE75	2,90 L/s	3,20 L/s	2,69 L/s	-	
DE50	1,70 L/s	2,11 L/s	1,95 L/s	-	
DE25	0,97 L/s	1,02 L/s	0,87 L/s	-	