



<b>Nom</b> SOROPOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LAMBERT	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 16/03/1970	<b>Profession</b> WELDER
<b>Age</b> 53 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 55	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 59 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 33,8 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 54 %

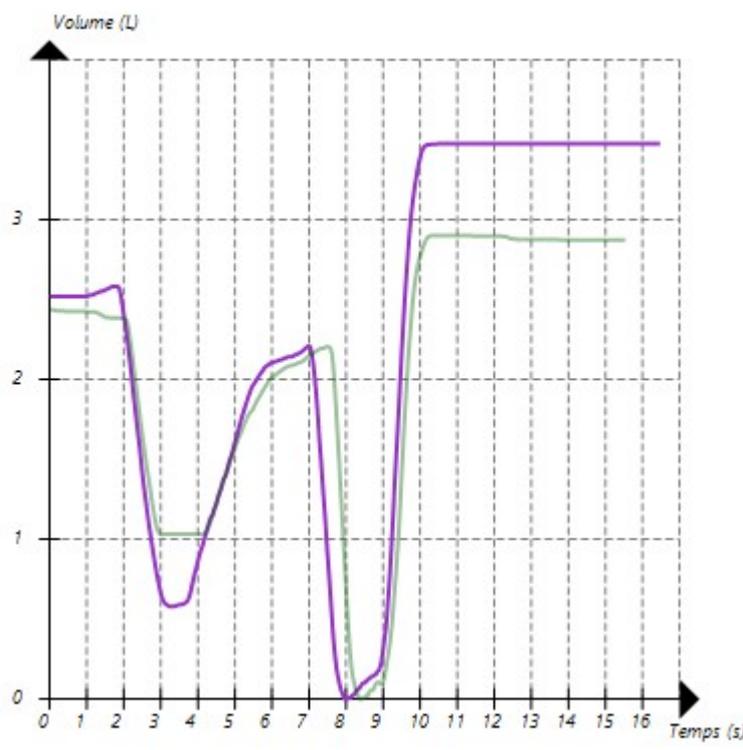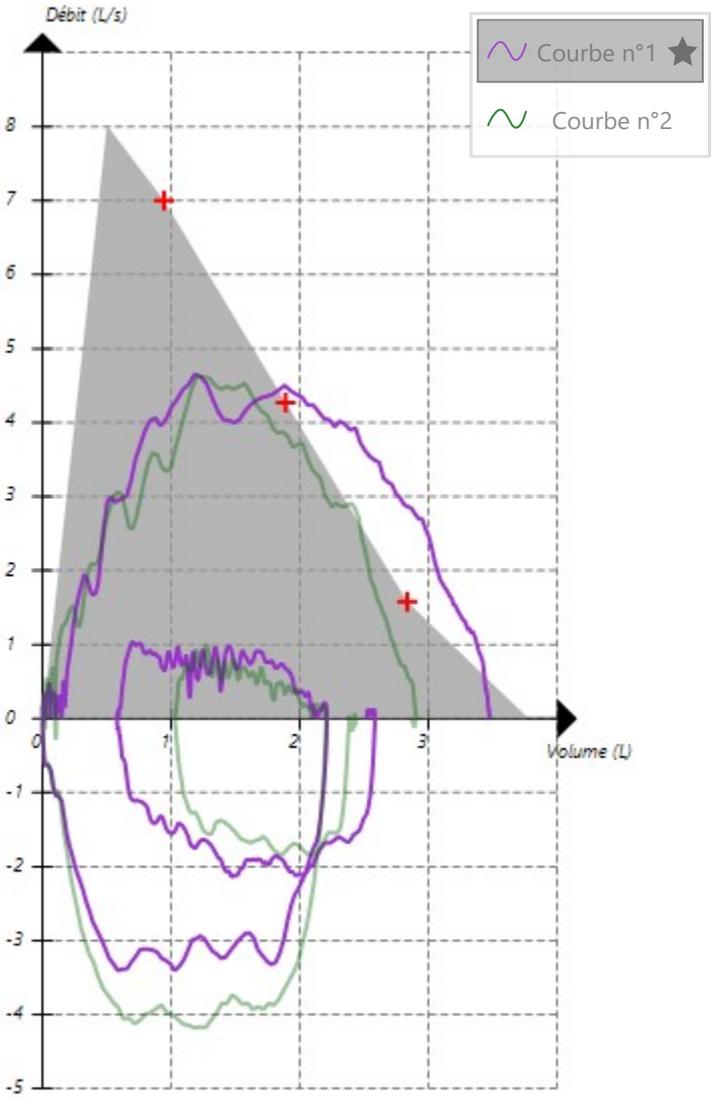

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,47 L	2,80 L	3,78 L	91,80 %
VEMS	3,40 L	2,79 L	3,07 L	110,75 %
DEP	4,73 L/s	4,68 L/s	8,02 L/s	58,98 %
VEMS/ CVF	97,98 %	99,64 %	77,72 %	126,07 %
Durée d'expiration	4,55 s	1,32 s	-	
DEMM	4,24 L/s	4,02 L/s	3,63 L/s	116,80 %
DEMM/ CVF	1,22 s-1	1,44 s-1	0,96 s-1	127,08 %
DE75	4,09 L/s	3,31 L/s	7,00 L/s	58,43 %
DE50	4,36 L/s	4,41 L/s	4,27 L/s	102,11 %
DE25	3,45 L/s	2,98 L/s	1,58 L/s	218,35 %