



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KEMO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/05/1990	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1617	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 53 %

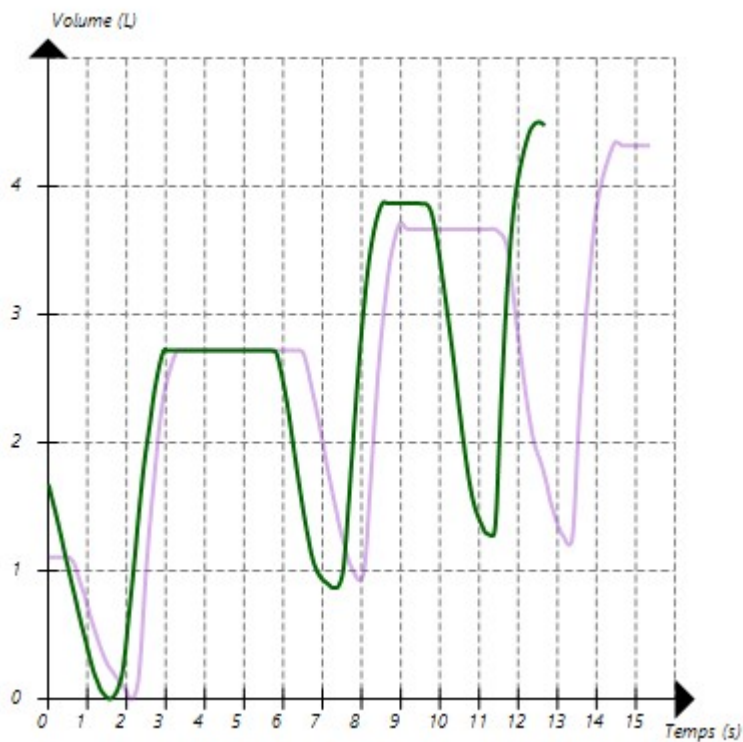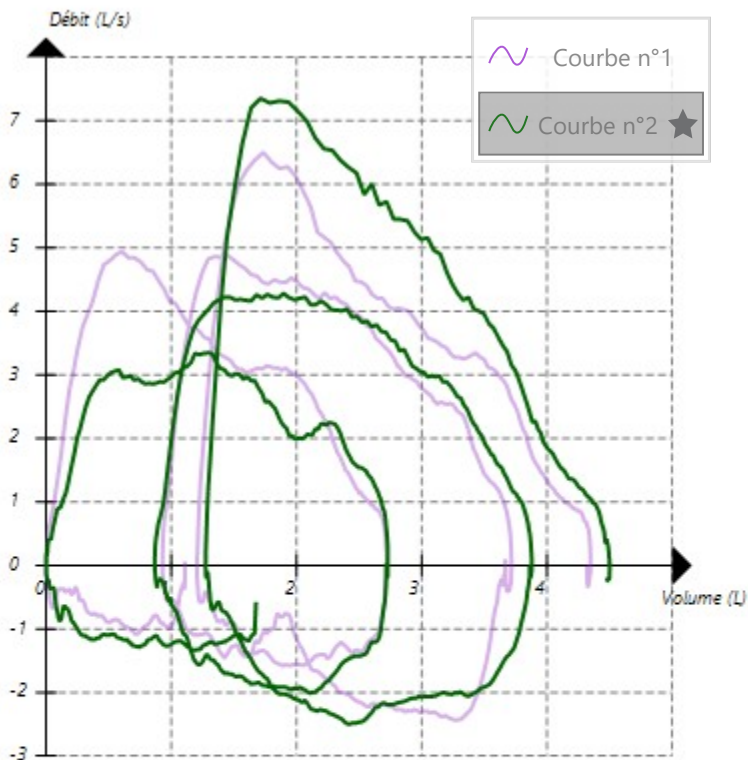

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,14 L	3,23 L	3,98 L	81,16 %
VEMS	3,09 L	3,21 L	3,32 L	96,69 %
DEP	6,60 L/s	7,51 L/s	8,64 L/s	86,92 %
VEMS/ CVF	98,41 %	99,38 %	83,02 %	119,71 %
Durée d'expiration	1,20 s	1,22 s	-	
DEMM	4,14 L/s	5,16 L/s	3,69 L/s	139,84 %
DEMM/ CVF	1,32 s-1	1,60 s-1	0,93 s-1	172,04 %
DE75	6,14 L/s	6,96 L/s	-	
DE50	4,03 L/s	5,42 L/s	-	
DE25	3,06 L/s	3,30 L/s	-	