



<b>Nom</b> BERETE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 22/02/1985	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 39 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1495	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,3 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 53 %

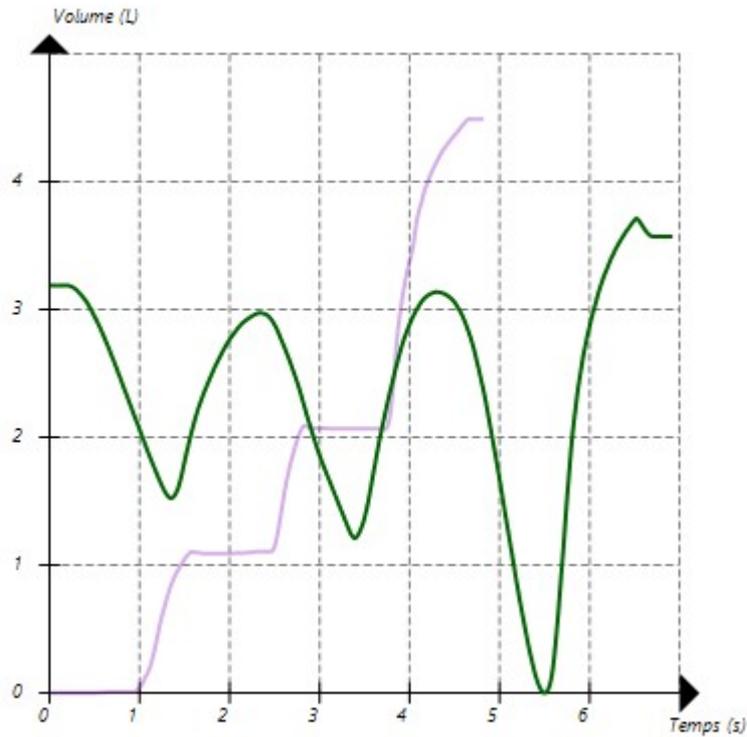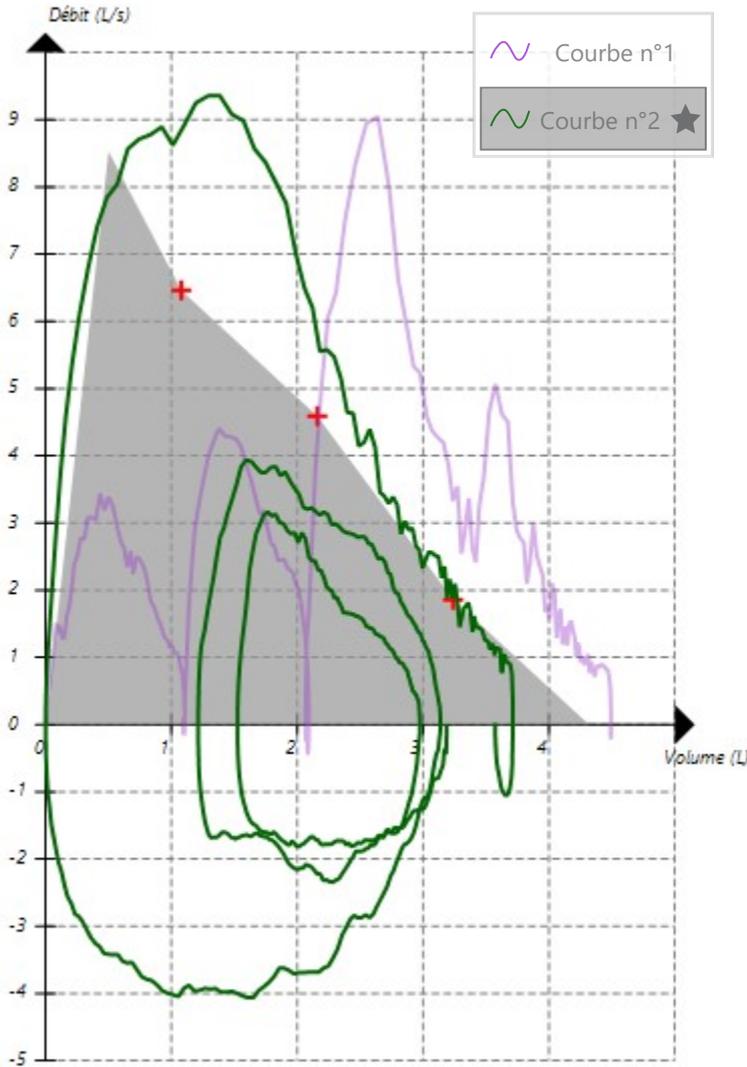

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,43 L	3,71 L	4,32 L	85,88 %
VEMS	2,43 L	3,71 L	3,59 L	103,34 %
DEP	9,61 L/s	9,50 L/s	8,53 L/s	111,37 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	82,60 %	121,07 %
Durée d'expiration	0,94 s	1,02 s	-	
DEMM	4,03 L/s	6,49 L/s	3,85 L/s	168,57 %
DEMM/CVF	1,66 s-1	1,75 s-1	0,89 s-1	196,63 %
DE75	9,61 L/s	8,82 L/s	6,46 L/s	136,53 %
DE50	3,72 L/s	8,07 L/s	4,59 L/s	175,82 %
DE25	2,81 L/s	3,27 L/s	1,86 L/s	175,81 %