



<b>Nom SOW</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom AMADOU OURY</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1996</b>	<b>Profession</b>
<b>Age 28 Ans</b>	<b>Entreprise</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 100</b>	<b>Fumeur Fumeur</b>
<b>Taille 163 cm</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids 64 kg</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	
<b>Opérateur admin admin</b>	

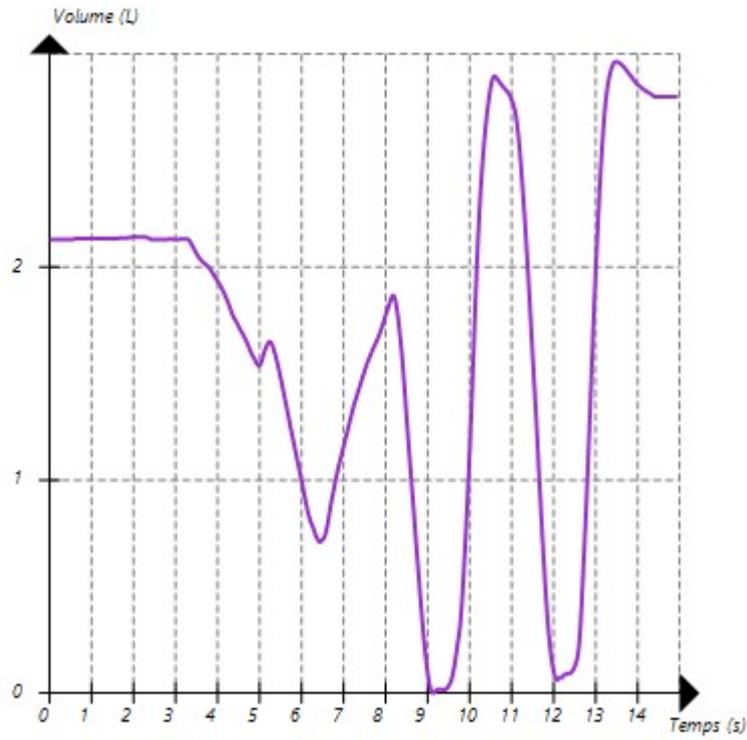

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,8 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 42 %

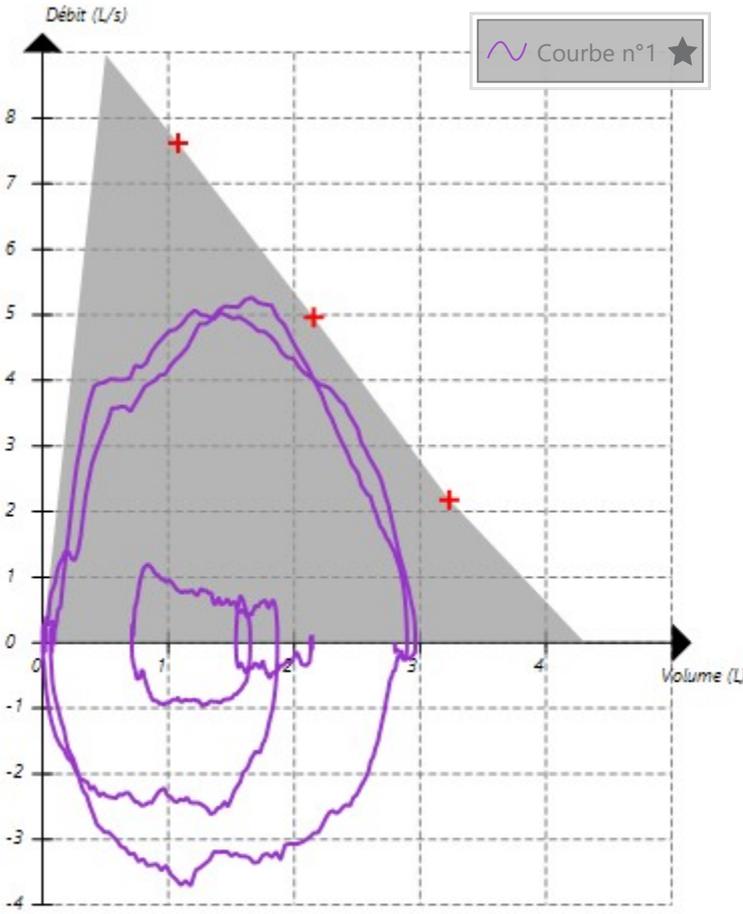

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,88 L	4,31 L	66,82 %
VEMS	2,88 L	3,71 L	77,63 %
DEP	5,30 L/s	8,97 L/s	59,09 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,20 %	121,65 %
Durée d'expiration	1,20 s	-	
DEMM	4,69 L/s	4,66 L/s	100,64 %
DEMM/ CVF	1,63 s-1	1,08 s-1	150,93 %
DE75	3,66 L/s	7,62 L/s	48,03 %
DE50	5,15 L/s	4,96 L/s	103,83 %
DE25	3,93 L/s	2,18 L/s	180,28 %

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: