

<b>Nom</b> SOUMAORO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/07/2000	<b>Profession</b> FLAGMAN
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 6057	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 68 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 28,4 °C  
 Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Humidité : 56 %

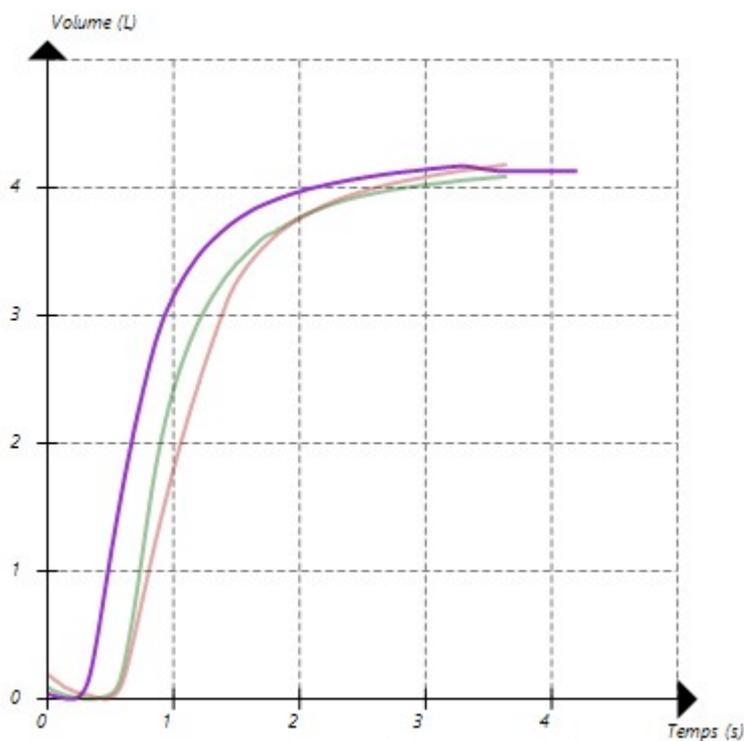

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	4,17 L	4,09 L	4,18 L	4,28 L	97,43 %
VEMS	3,60 L	3,49 L	3,37 L	3,64 L	98,90 %
DEP	6,42 L/s	6,86 L/s	4,48 L/s	9,24 L/s	69,48 %
VEMS/CVF	86,33 %	85,33 %	80,62 %	84,85 %	101,74 %
Durée d'expiration	3,07 s	3,30 s	3,20 s	-	
DEMM	4,17 L/s	3,90 L/s	3,36 L/s	4,19 L/s	99,52 %
DEMM/CVF	1,00 s-1	0,95 s-1	0,80 s-1	0,98 s-1	102,04 %
DE75	5,95 L/s	6,65 L/s	4,30 L/s	-	
DE50	4,38 L/s	4,60 L/s	3,35 L/s	-	
DE25	2,06 L/s	1,76 L/s	2,28 L/s	-	