



<b>Nom FAN</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom JIAAN</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 26/04/1989</b>	<b>Profession STORE KEEPER</b>
<b>Age 35 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 5046</b>	<b>Fumeur Fumeur</b>
<b>Taille 172 cm</b>	<b>Groupe ethnique Chinois de Hong Kong</b>
<b>Poids 58 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecce/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 5</b>
<b>Opérateur BAH OUMOU SALAMATA</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 34,7 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 95 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 54 %

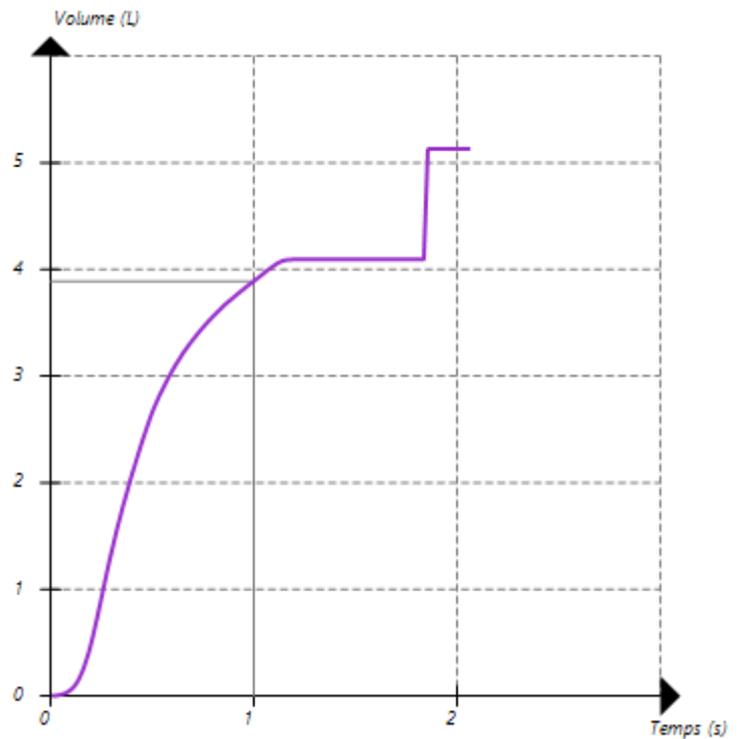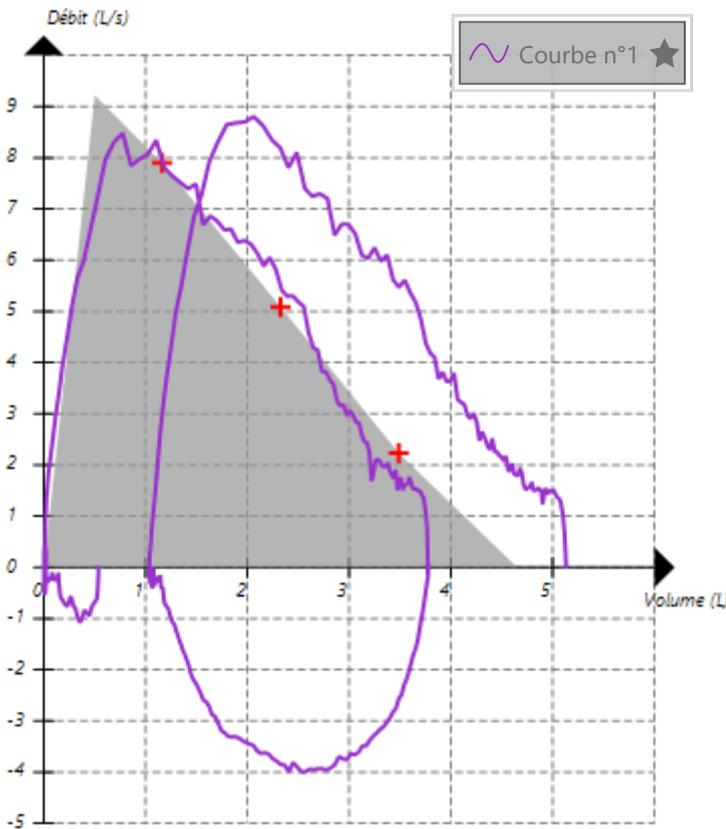

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,09 L	4,65 L	87,96 %
VEMS	4,08 L	3,89 L	104,88 %
DÉP	9,10 L/s	9,22 L/s	98,70 %
VEMS/CVF	99,76 %	80,94 %	123,25 %
Durée d'expiration	1,21 s	-	
DEMM	5,98 L/s	4,54 L/s	131,72 %
DEMM/CVF	1,46 s <sup>-1</sup>	0,98 s <sup>-1</sup>	148,98 %
DE75	8,90 L/s	7,90 L/s	112,66 %
DE50	6,29 L/s	5,09 L/s	123,58 %
DE25	3,17 L/s	2,23 L/s	142,15 %