

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BOYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 06/03/1997	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1059	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 55 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,8 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 60 %

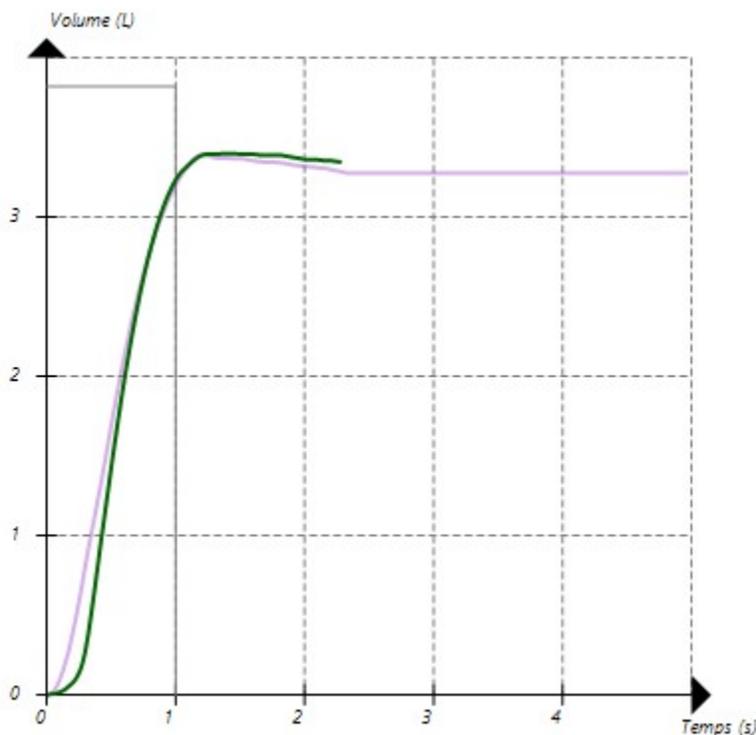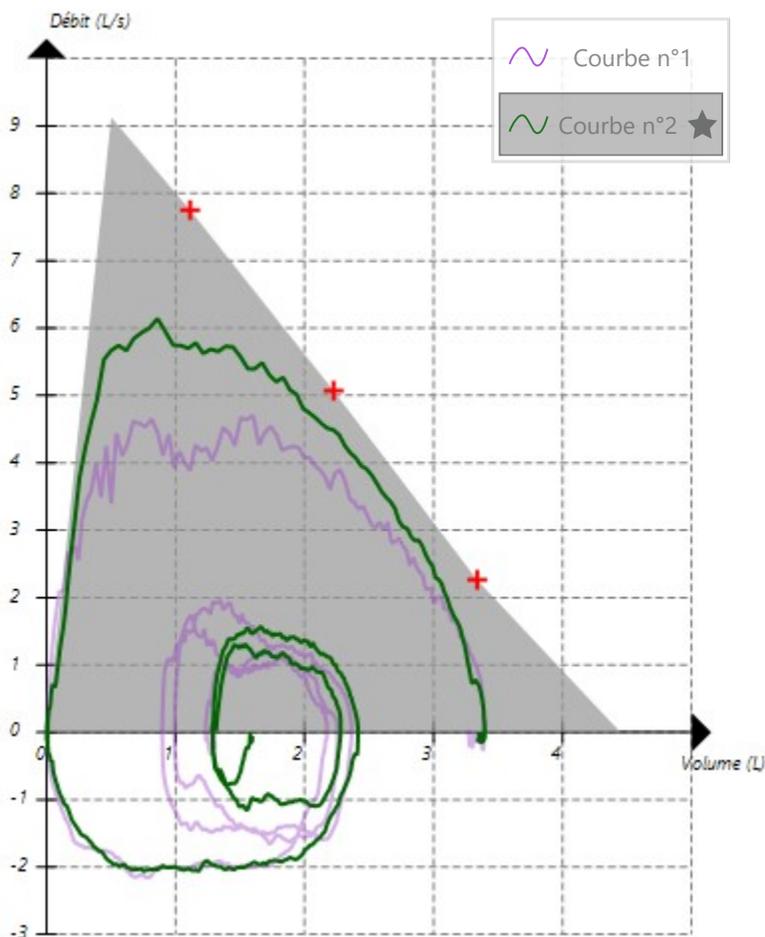

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,39 L	3,40 L	4,45 L	76,40 %
VEMS	3,35 L	3,40 L	3,82 L	89,01 %
DEP	4,83 L/s	6,19 L/s	9,13 L/s	67,80 %
VEMS/ CVF	98,82 %	100,00 %	82,38 %	121,39 %
Durée d'expiration	1,21 s	1,39 s	-	
DEMM	4,13 L/s	5,15 L/s	4,75 L/s	108,42 %
DEMM/ CVF	1,22 s-1	1,51 s-1	1,07 s-1	141,12 %
DE75	4,62 L/s	6,19 L/s	7,75 L/s	79,87 %
DE50	4,54 L/s	5,39 L/s	5,07 L/s	106,31 %
DE25	3,00 L/s	3,69 L/s	2,26 L/s	163,27 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: