

<b>Nom</b> BAMBA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BANGALY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1970	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 54 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1014	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 159 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire obstructif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,2 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 62 %

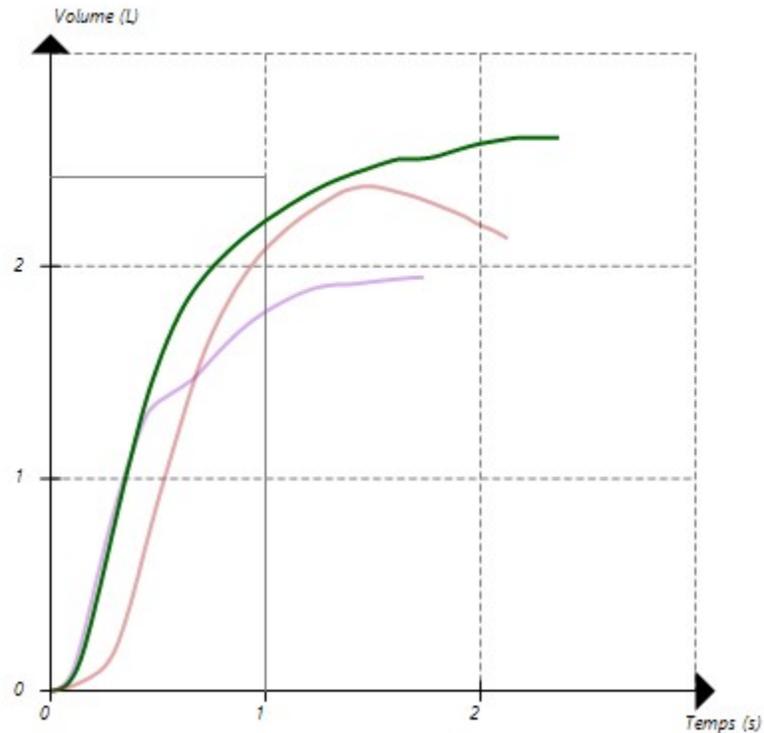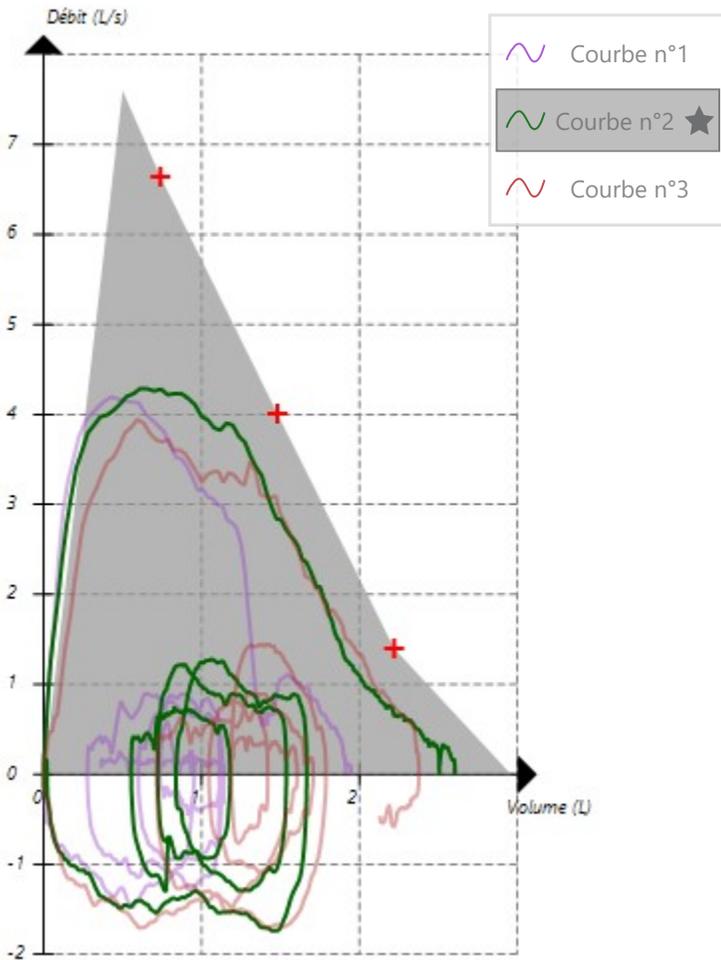

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	1,95 L	2,61 L	2,38 L	2,96 L	88,18 %
VEMS	1,84 L	2,29 L	2,30 L	2,42 L	94,63 %
DEP	4,25 L/s	4,39 L/s	3,97 L/s	7,60 L/s	57,76 %
VEMS/ CVF	94,36 %	87,74 %	96,64 %	77,54 %	113,15 %
Durée d'expiration	1,74 s	2,39 s	1,47 s	-	
DEMM	2,18 L/s	2,89 L/s	3,14 L/s	3,47 L/s	83,29 %
DEMM/ CVF	1,12 s-1	1,11 s-1	1,32 s-1	1,02 s-1	108,82 %
DE75	4,16 L/s	4,26 L/s	3,97 L/s	6,64 L/s	64,16 %
DE50	3,12 L/s	3,57 L/s	3,34 L/s	4,01 L/s	89,03 %
DE25	0,73 L/s	1,22 L/s	1,87 L/s	1,40 L/s	87,14 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: