



<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> AMARA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 24/04/1995	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 320	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 176 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 697,6 mmHg  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 49 %

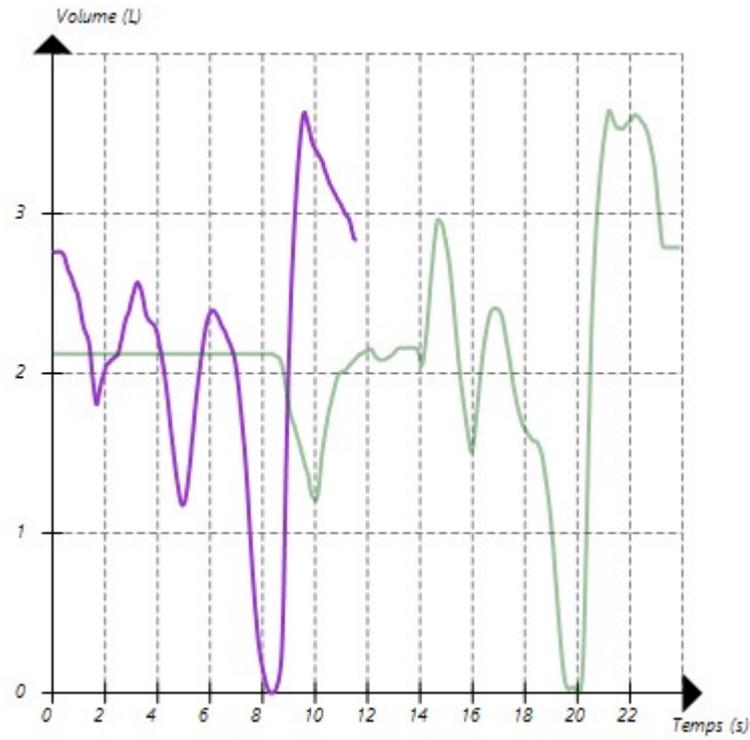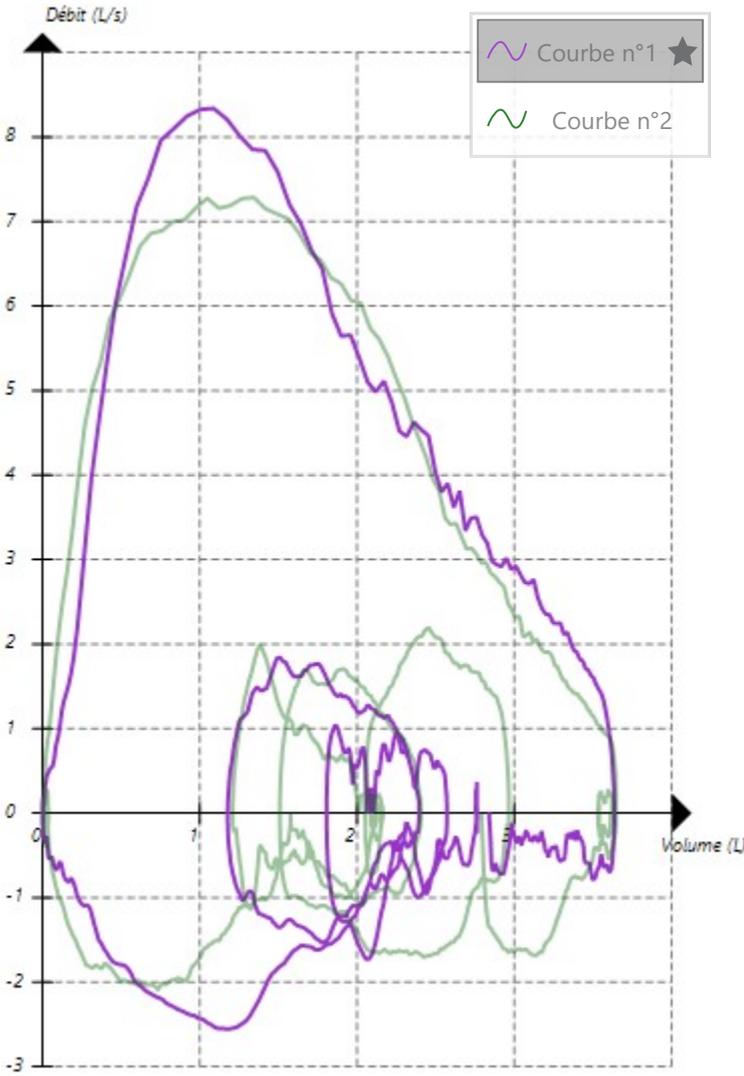

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,63 L	3,65 L	5,39 L	67,35 %
VEMS	3,63 L	3,65 L	4,42 L	82,13 %
DEP	8,42 L/s	7,42 L/s	10,08 L/s	83,53 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	82,28 %	121,54 %
Durée d'expiration	1,22 s	1,18 s	-	
DEMM	5,82 L/s	5,66 L/s	4,51 L/s	129,05 %
DEMM/CVF	1,60 s-1	1,55 s-1	0,84 s-1	190,48 %
DE75	8,29 L/s	7,06 L/s	-	
DE50	5,95 L/s	6,40 L/s	-	
DE25	3,42 L/s	3,21 L/s	-	