



<b>Nom SYLLA</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom IBRAHIMA</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 04/02/1996</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 28 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 1609</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 173 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 69 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites NHANES III</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,9 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 57 %

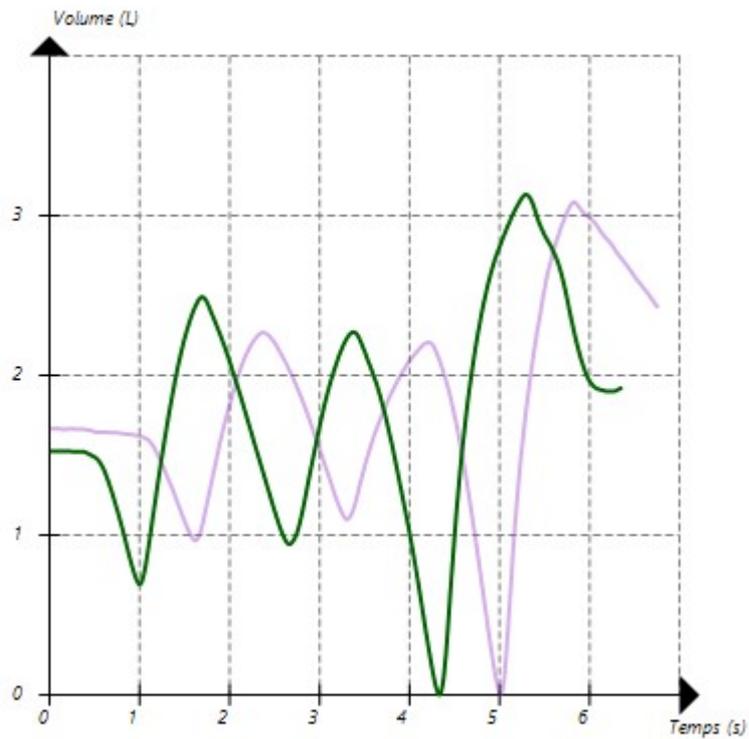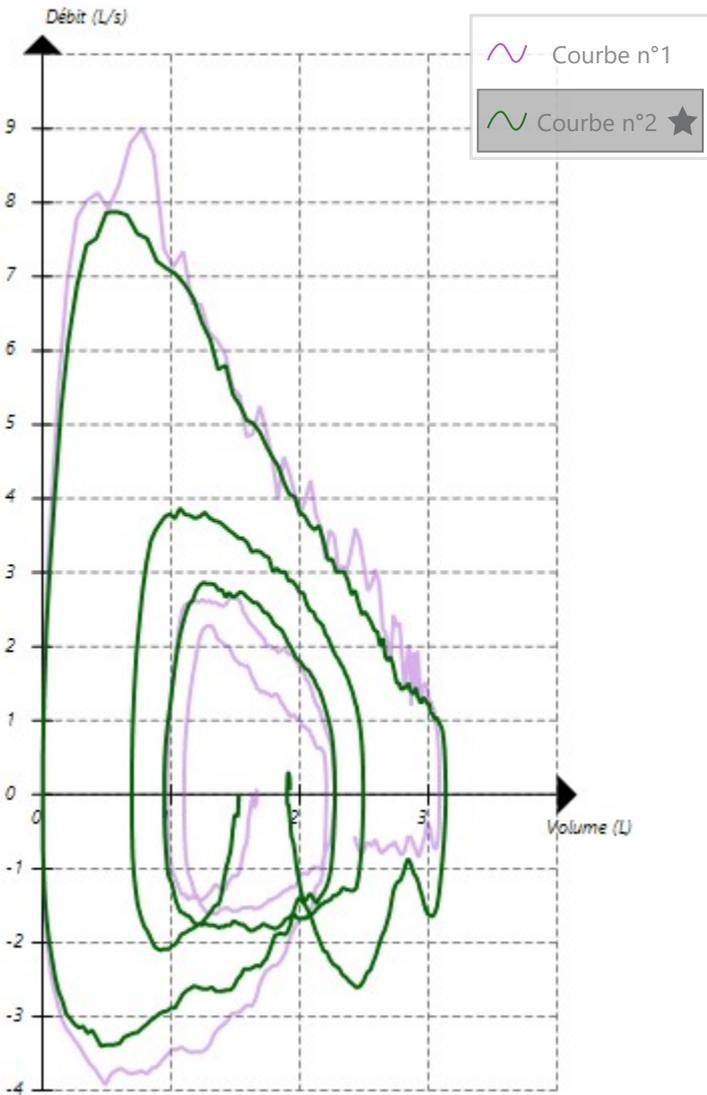

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,09 L	3,13 L	4,32 L	72,45 %
VEMS	3,09 L	3,13 L	3,64 L	85,99 %
DEP	9,24 L/s	7,94 L/s	9,26 L/s	85,75 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	84,12 %	118,88 %
Durée d'expiration	0,81 s	0,96 s	-	
DEMM	5,23 L/s	4,96 L/s	4,09 L/s	121,27 %
DEMM/ CVF	1,69 s-1	1,58 s-1	0,95 s-1	166,32 %
DE75	9,11 L/s	7,54 L/s	-	
DE50	5,33 L/s	5,10 L/s	-	
DE25	2,72 L/s	2,94 L/s	-	