

<b>Nom</b> GUO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> RUIBIN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/09/1974	<b>Profession</b> CHARPENTIER
<b>Age</b> 50 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 6974	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 69 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,1 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 64 %

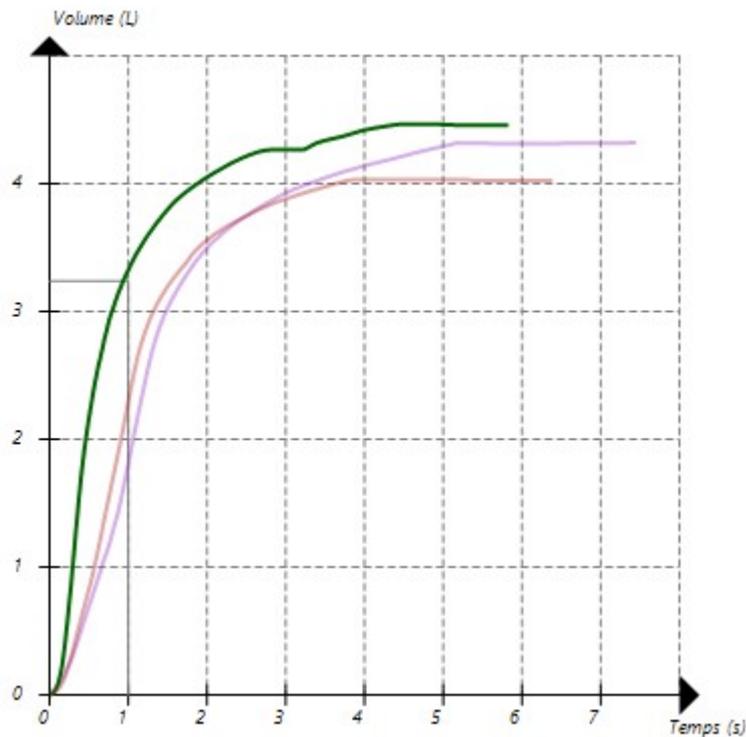

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	4,30 L	4,47 L	4,03 L	3,97 L	112,59 %
VEMS	2,90 L	3,50 L	2,97 L	3,24 L	108,02 %
DEP	3,19 L/s	7,44 L/s	3,52 L/s	8,27 L/s	89,96 %
VEMS/CVF	67,44 %	78,30 %	73,70 %	78,26 %	100,05 %
Durée d'expiration	10,03 s	4,61 s	4,81 s	-	
DEMM	2,19 L/s	3,15 L/s	2,63 L/s	3,80 L/s	82,89 %
DEMM/CVF	0,51 s-1	0,70 s-1	0,65 s-1	0,96 s-1	72,92 %
DE75	1,64 L/s	6,10 L/s	2,83 L/s	7,20 L/s	84,72 %
DE50	2,99 L/s	3,47 L/s	3,06 L/s	4,43 L/s	78,33 %
DE25	0,92 L/s	1,43 L/s	1,06 L/s	1,71 L/s	83,63 %