

<b>Nom</b> KOUROUMA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2000	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 531	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 25,6 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 53 %

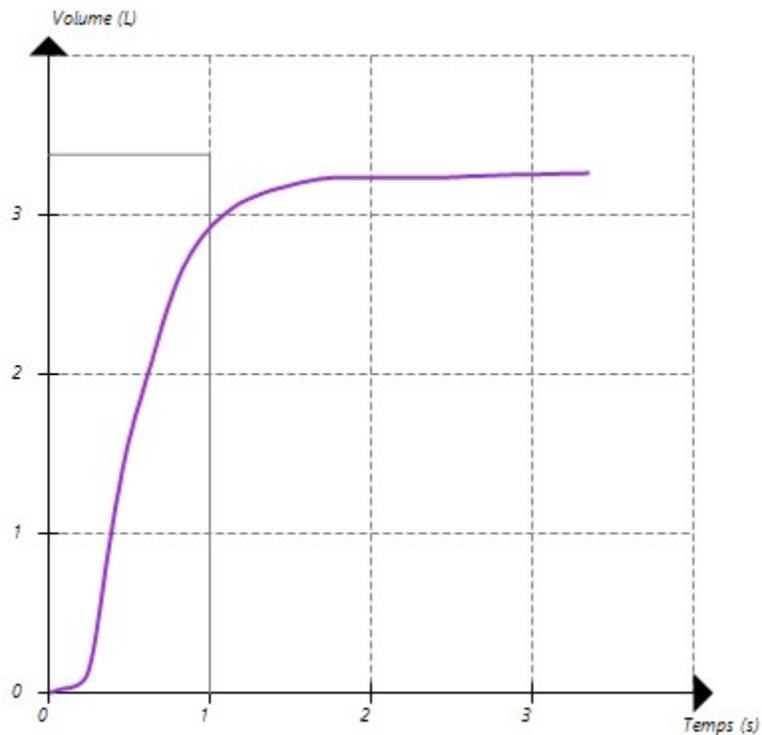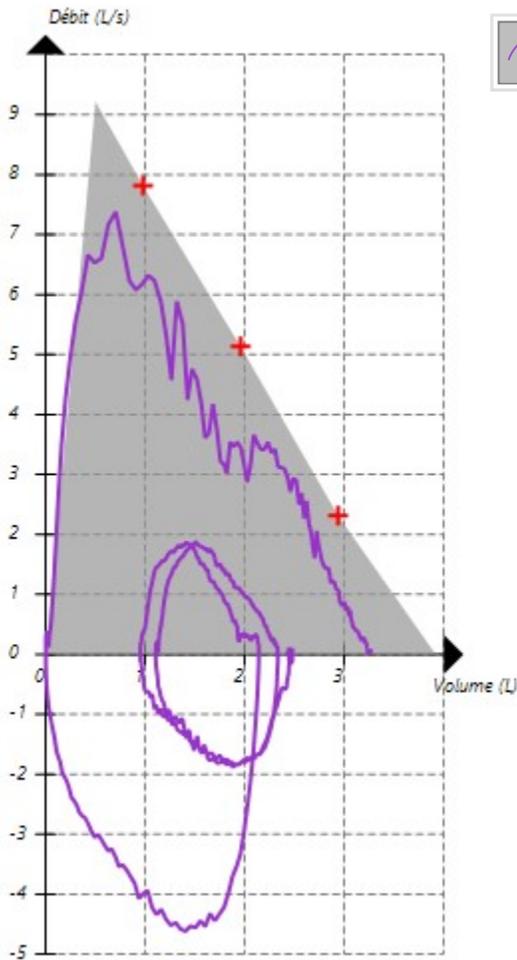

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,27 L	3,92 L	83,42 %
VEMS	3,10 L	3,38 L	91,72 %
DEP	7,48 L/s	9,22 L/s	81,13 %
VEMS/ CVF	94,80 %	82,74 %	114,58 %
Durée d'expiration	3,37 s	-	
DEMM	4,18 L/s	4,83 L/s	86,54 %
DEMM/ CVF	1,28 s-1	1,07 s-1	119,63 %
DE75	6,26 L/s	7,81 L/s	80,15 %
DE50	3,60 L/s	5,13 L/s	70,18 %
DE25	2,54 L/s	2,31 L/s	109,96 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: