

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> AMINATA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1989	<b>Profession</b> CLEANER
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 744	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 73 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,6 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 66 %

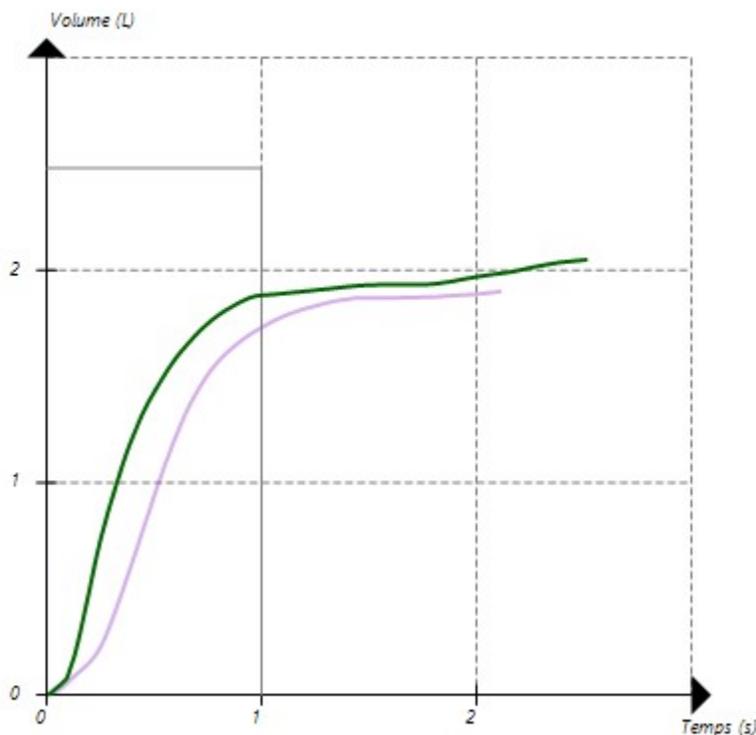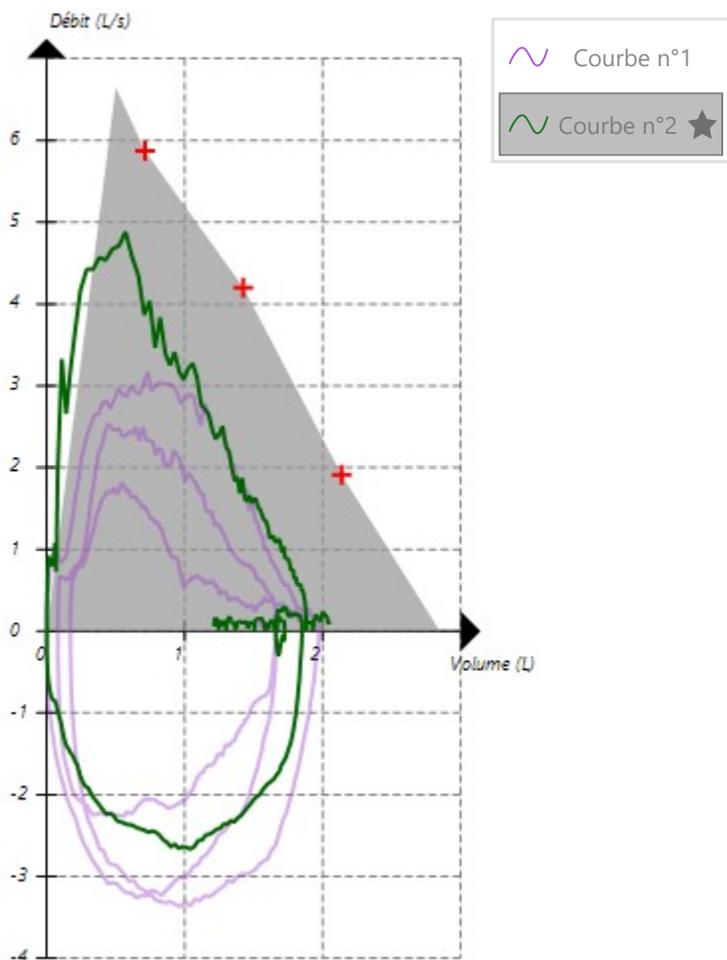

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,90 L	2,05 L	2,85 L	71,93 %
VEMS	1,82 L	1,89 L	2,48 L	76,21 %
DEP	3,19 L/s	4,96 L/s	6,65 L/s	74,59 %
VEMS/ CVF	95,79 %	92,20 %	82,38 %	111,92 %
Durée d'expiration	2,12 s	2,53 s	-	
DEMM	2,72 L/s	2,81 L/s	3,74 L/s	75,13 %
DEMM/ CVF	1,43 s-1	1,37 s-1	1,14 s-1	120,18 %
DE75	2,73 L/s	4,64 L/s	5,87 L/s	79,05 %
DE50	2,90 L/s	3,14 L/s	4,20 L/s	74,76 %
DE25	1,71 L/s	1,41 L/s	1,91 L/s	73,82 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: