

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> VASSE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 15/07/1993	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1133	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 54 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 30,1 °C  
 Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Humidité : 47 %

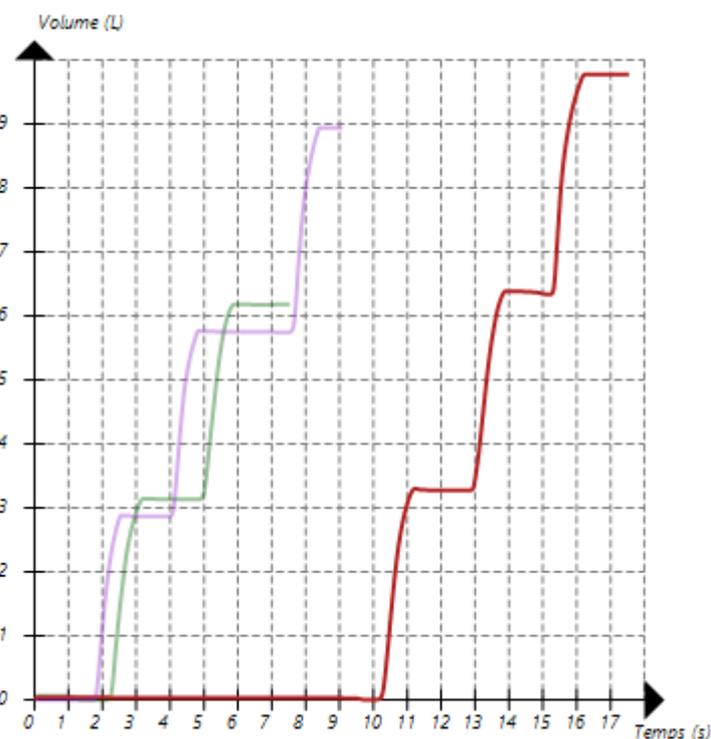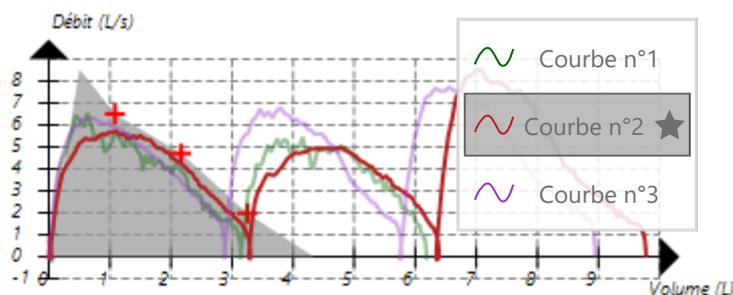

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,14 L	3,44 L	3,20 L	4,34 L	79,26 %
VEMS	3,14 L	3,44 L	3,20 L	3,65 L	94,25 %
DÉP	7,05 L/s	8,84 L/s	7,86 L/s	8,56 L/s	103,27 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,55 %	119,69 %
Durée d'expiration	1,16 s	1,24 s	1,27 s	-	
DEMM	4,54 L/s	5,32 L/s	5,48 L/s	4,00 L/s	133,00 %
DEMM/CVF	1,45 s-1	1,55 s-1	1,71 s-1	0,92 s-1	168,48 %
DE75	5,74 L/s	8,24 L/s	7,78 L/s	6,51 L/s	126,57 %
DE50	4,90 L/s	5,64 L/s	5,98 L/s	4,72 L/s	119,49 %
DE25	3,28 L/s	3,01 L/s	3,15 L/s	1,98 L/s	152,02 %