

<b>Nom</b> YANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ZHENGQIANG	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 18/05/1975	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 49 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 4279	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire mixte.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,1 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 42 %

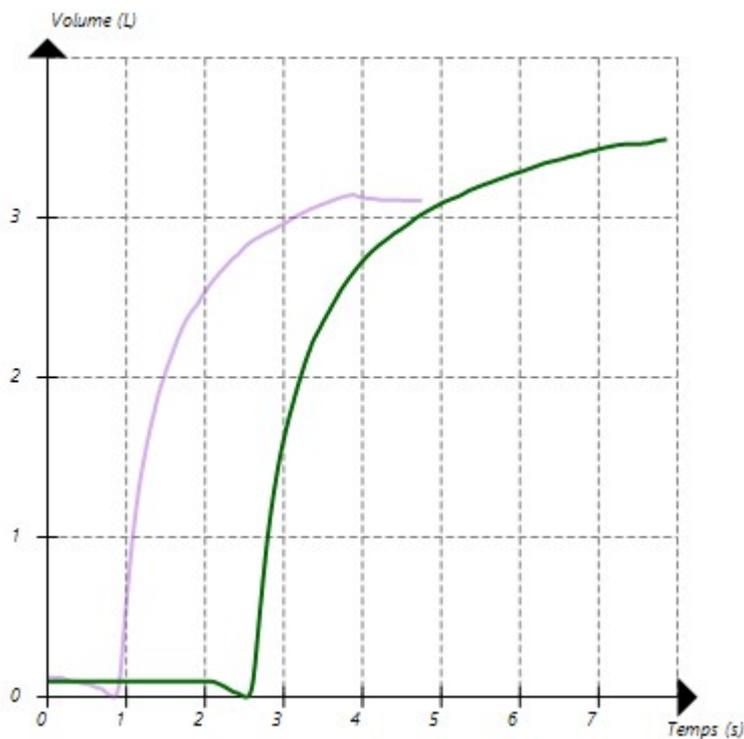

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,14 L	3,49 L	4,45 L	78,43 %
VEMS	2,45 L	2,43 L	3,48 L	69,83 %
DEP	6,51 L/s	5,63 L/s	9,03 L/s	62,35 %
VEMS/CVF	78,03 %	69,63 %	77,94 %	89,34 %
Durée d'expiration	3,04 s	5,35 s	-	
DEMM	2,18 L/s	1,65 L/s	3,17 L/s	52,05 %
DEMM/CVF	0,69 s-1	0,47 s-1	0,71 s-1	66,20 %
DE75	5,12 L/s	4,60 L/s	-	
DE50	2,16 L/s	2,14 L/s	-	
DE25	0,61 L/s	0,53 L/s	-	