

<b>Nom</b> LAMAH	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> RICHARD	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/08/1994	<b>Profession</b> ELECTRICIEN
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 9579	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 92 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 26,2 °C  
 Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Humidité : 61 %

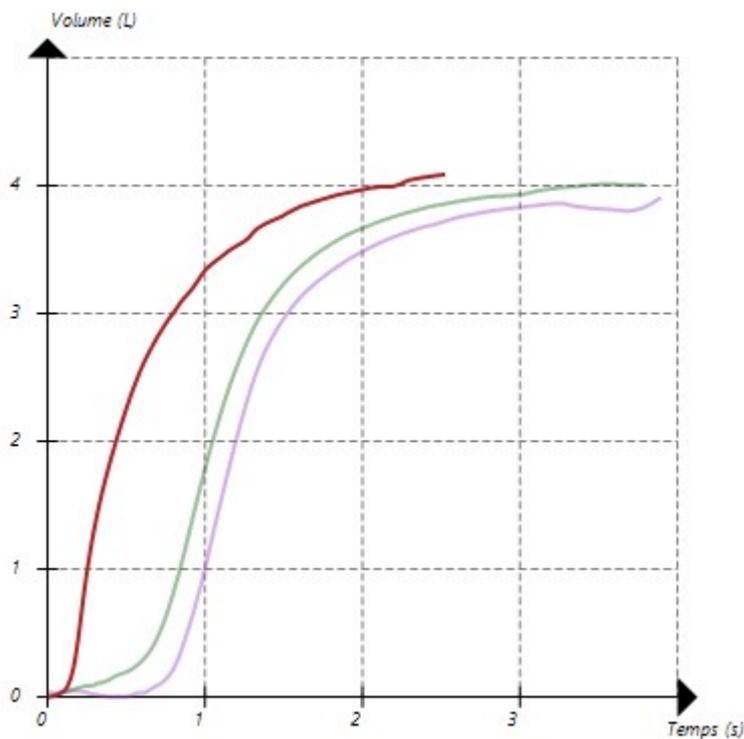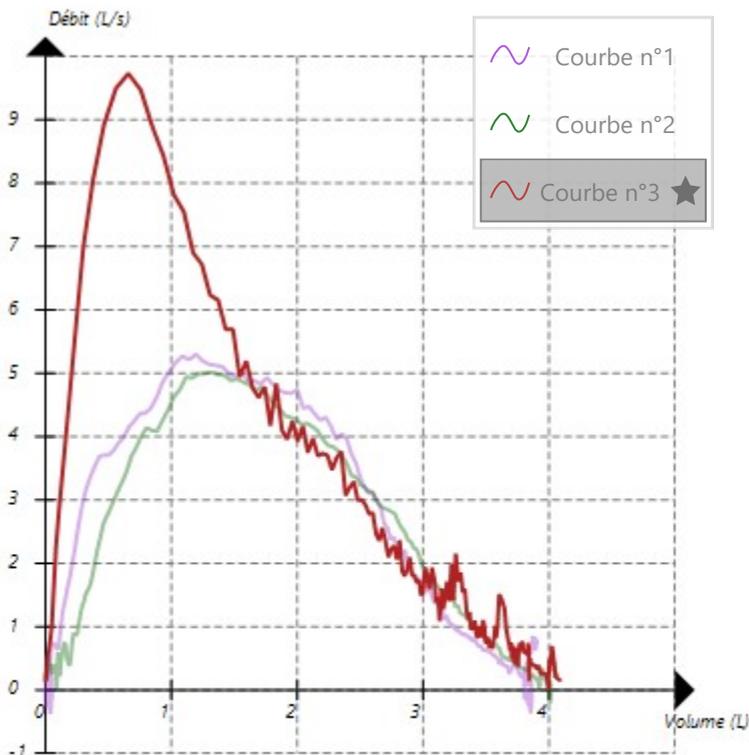

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,83 L	4,01 L	4,09 L	4,34 L	94,24 %
VEMS	3,32 L	3,41 L	3,48 L	3,64 L	95,60 %
DEP	5,36 L/s	5,09 L/s	9,77 L/s	9,28 L/s	105,28 %
VEMS/CVF	86,68 %	85,04 %	85,09 %	83,76 %	101,59 %
Durée d'expiration	2,65 s	3,57 s	2,53 s	-	
DEMM	4,05 L/s	3,84 L/s	3,54 L/s	4,04 L/s	87,62 %
DEMM/CVF	1,06 s-1	0,96 s-1	0,87 s-1	0,93 s-1	93,55 %
DE75	5,09 L/s	4,57 L/s	7,75 L/s	-	
DE50	4,71 L/s	4,25 L/s	4,44 L/s	-	
DE25	1,82 L/s	1,87 L/s	2,09 L/s	-	