

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUSMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2000	<b>Profession</b> FLAGMAN
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3838	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,5 °C


Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 30 %

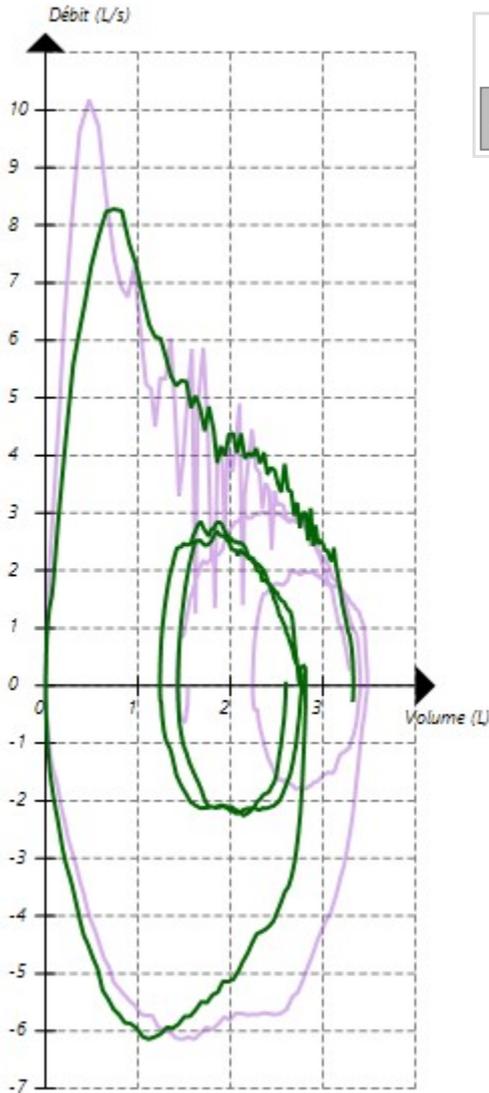

~ Courbe n°1  
~ Courbe n°2 ★

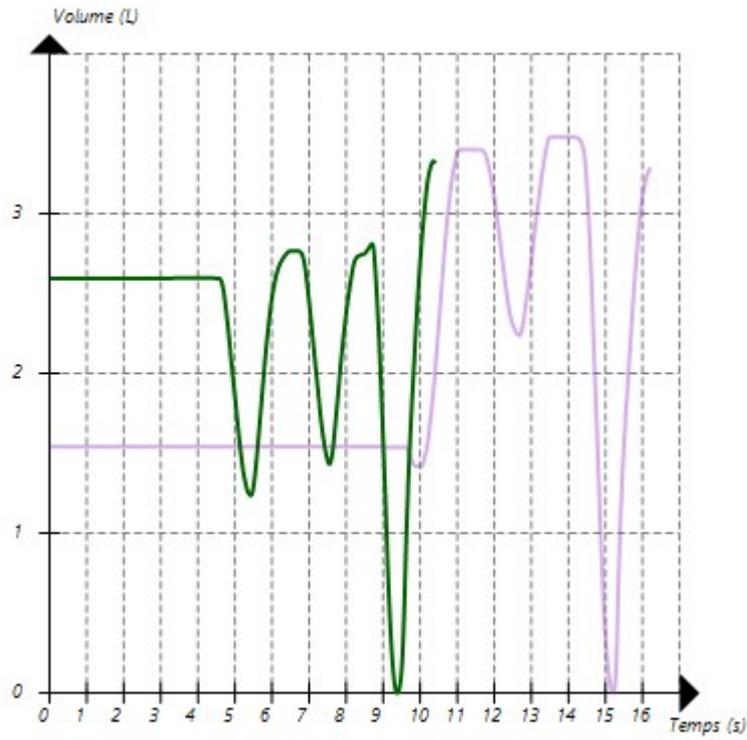

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,29 L	3,33 L	4,32 L	77,08 %
VEMS	3,29 L	3,33 L	3,67 L	90,74 %
DEP	10,39 L/s	8,51 L/s	9,29 L/s	91,60 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	84,67 %	118,11 %
Durée d'expiration	1,03 s	0,98 s	-	
DEMM	4,25 L/s	4,97 L/s	4,18 L/s	118,90 %
DEMM/ CVF	1,29 s-1	1,49 s-1	0,97 s-1	153,61 %
DE75	7,29 L/s	8,14 L/s	-	
DE50	5,90 L/s	4,79 L/s	-	
DE25	3,61 L/s	2,93 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: